

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 770 del 09 APR. 2020

Oggetto: Acquisto – ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – presso la soc. Favero Health Project s.p.a. di Montebelluna (TV) di n.1 barella per emergenza COVID-19, da destinare alla UOC Malattie Infettive. Importo complessivo pari ad € 1.761,55 (IVA esclusa).

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, L.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L.n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del procedimento:

Dott. Matteo Palmieri

Firma 

Data 03/04/2020

Il Dirigente:

Dott. Andrea Martellucci

Firma 

Data 03-04-2020

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto patrimoniale su cui imputare la spesa 101020501 - Avv. 60/2020

Data 05/04/2020

Firma 
Dott.ssa Antonella Rossetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l’Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l’organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. dell’12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che con delibera del Consiglio Dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per mesi 6, su tutto il territorio nazionale lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

PRESO ATTO che con nota del 04/03/2020 il Primario della UOSD Malattie Infettive ha manifestato l’urgenza di essere dotato di una barella da utilizzare esclusivamente per l’emergenza COVID-19 (All. 1);

RILEVATO che:

- con atto determinativo n.554 del 12/03/2020 sono stati acquistati, presso la soc. Favero Health Project s.p.a. di Montebelluna (TV), arredi sanitari vari da destinare alla struttura riabilitativa di Poggio Mirteto, con consegna entro la data del 28/03/2020;
- tra gli arredi sanitari sopra menzionati è presente una tipologia di barella (cod. 9BB1040), dotata di sponde abbattibili (cod. 9BB9008), materassino (cod. 9BB9017), asta flebo (cod. 9LD9030) e morsetto per asta (cod. 9LD9031) (All.2);

VISTA:

- la nota del 05/04/2020 con la quale è stata chiesto al Dr. Mauro Marchili, Direttore della UOSD Malattie Infettive, di comunicare l’eventuale rispondenza della suddetta barella accessoriata alle esigenze del reparto;
- la nota di riscontro, del 10/03/2020, con la quale il Dr. Mauro Marchili la rispondenza del prodotto offerto a quanto si necessita, nota che unita al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (All. 3);

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, accettare l’offerta della soc. Favero Health Project s.p.a. di Montebelluna (TV), relativa alla fornitura di n.1 barella (cod. 9BB1040), dotata di sponde abbattibili (cod. 9BB9008), materassino (cod. 9BB9017), asta flebo (cod. 9LD9030) e morsetto per asta (cod. 9LD9031) ad un prezzo complessivo pari ad € 1.761,55 (IVA esclusa);

VISTO l’art.63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

Oggetto: Acquisto – ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – presso la soc. Favero Health Project s.p.a. di Montebelluna (TV) di n.1 barella per emergenza COVID-19, da destinare alla UOC Malattie Infettive. Importo complessivo pari ad € 1.761,55 (IVA esclusa).

Pag. 3 di 4

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI PROCEDERE** all’affidamento – ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 – alla società Favero Health Project s.p.a. di Montebelluna (TV), della fornitura di n.1 barella (cod. 9BB1040), dotata di sponde abbattibili (cod. 9BB9008), materassino (cod. 9BB9017), asta flebo (cod. 9LD9030) e morsetto per asta (cod. 9LD9031) ad un prezzo complessivo pari ad € 1.761,55 (IVA esclusa) (All. 2);
2. **DI INCLUDERE** l’onere del presente provvedimento, mediante l’utilizzo aziendali, sul conto di costo 101020501 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”, per un importo pari ad € 2.149,09 (IVA 22% inclusa), esercizio 2020;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

IL Dirigente Responsabile
U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Dott. ANDREA MARTELLUCCI

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f.: Dott. Gennaro D'agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 09 APR. 2020


La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 09 APR. 2020

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 09 APR. 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 09 APR. 2020

IL FUNZIONARIO



All. 1 di 3
Pag. 1 di 1**I: Richiesta fornitura barella UOSD Malattie Infettive**

Abs <abs@asl.rieti.it>

mer 04/03/2020 17:31

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Cc: Andrea Martellucci <a.martellucci@asl.rieti.it>

Da: Alessandra Martellucci <alessandra.martellucci@asl.rieti.it>**Inviato:** mercoledì 4 marzo 2020 10:29**A:** Abs <abs@asl.rieti.it>; Andrea Martellucci <a.martellucci@asl.rieti.it>**Cc:** Casertano Luca <l.casertano@asl.rieti.it>; Mauro Marchili <m.marchili@asl.rieti.it>**Oggetto:** I: Richiesta fornitura barella UOSD Malattie Infettive

A integrazione della richiesta avanzata via mail di cui all'oggetto, come richiesto per le vie brevi da ABS, si specifica:

"D'ordine del Responsabile UOSD Malattie Infettive, Dr. Mauro Marchili".

Si tiene, comunque, a precisare che ogni richiesta effettuata finora, pur se esplicitamente non specificato, è stata inoltrata sempre e solo previa autorizzazione/disposizione del Responsabile UOSD.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Alessandra Martellucci

Coordinatrice UOSD Malattie Infettive

Da: Alessandra Martellucci <alessandra.martellucci@asl.rieti.it>**Inviato:** martedì 3 marzo 2020 13:12**A:** Abs; Andrea Martellucci**Cc:** Casertano Luca; Mauro Marchili**Oggetto:** Richiesta fornitura barella UOSD Malattie Infettive

Buonasera,

la presente per richiedere la fornitura urgente di una barella di cui dotare la UOSD Malattie Infettive da dedicare esclusivamente alla gestione di pazienti ricoverati per sospetta o accertata infezione da Sars CoV-2. Si chiede che i materiali e le singole parti di cui è costituita siano sanificabili con soluzione di ipoclorito allo 0.5%.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Alessandra Martellucci

Coordinatrice UOSD Malattie Infettive

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall'Asl di Rieti e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione.

Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If

All. 2 di 3
Pag. 1 di 3

Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20 - 31044 Montebelluna (Treviso) Italy
Tel. +39 0423 6125 Fax +39 0423 612680 info@favero.it www.favero.it

Offerta
390/2020


MODELLO: GLIDE

BARELLA H. VARIABILE OLEODIN. TREND. E CONTROTR.


VERSIONE: 98B1040

Dimensioni

- Larghezza: 1980 mm
- Profondità: 720 mm
- Altezza: 900 mm

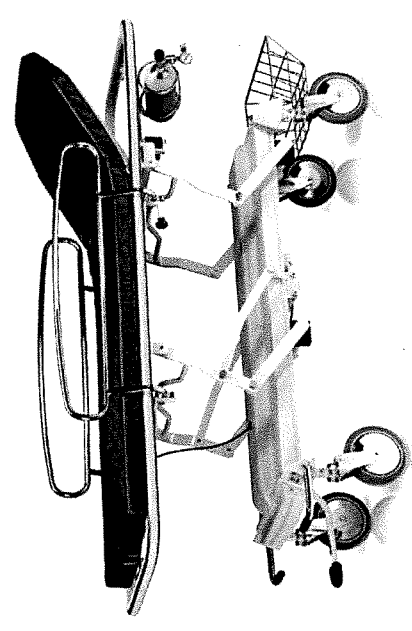

(Immagine indicativa)

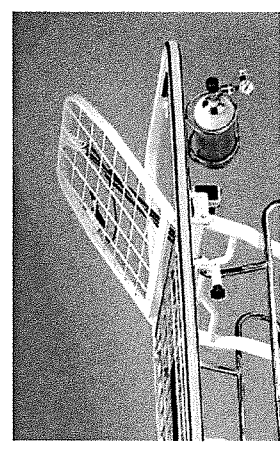

Dettaglio del piano rete in fondino di acciaio.

Barella a due sezioni con basamento sottosistite in profilo di acciaio a sezione triangolare e rettangolare verniciato a polveri epossidiche Carter di protezione in ABS termoplastico. Bracci di leva in profili di acciaio verniciato.

Sollevamento obodinamico mediante pedale posto al lato piedi; altezza minima e massima piano rete mm 540/900.

Telaio superiore a sezione ovale.

Piano rete in fondino di acciaio zincocromato e ad esclusione dello schienale, asportabile. Alzatesta regolabile mediante pompa a gas facilmente azionabile.

Predisposizione sul piano rete per il fissaggio del materassino. Predisposta per l'applicazione sponde abbattibili in profilo di acciaio cromato.

Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20 - 31044 Montebelluna (Treviso) Italy
Tel. +39 0423 6125 Fax +39 0423 612680 info@favero.it www.favero.it

Offerta
390/2020

MODELLO: GLIDE

BARELLA H. VARIABILE OLEODIN. TREND. E CONTROTR.

VERSIONE: 98B1040

Movimento di trendelenburg servoassistito e contro trendelenburg.

Alla base n. 4 ruote diam. mm 200 dotate di bloccaggio simultaneo a pedale, di cui una con direzionale con blocco.

Barella personalizzabile con diversi accessori.

Dispositivo medico in classe I

Classificazione CND: V0859 attrezzature di supporto all'attività sanitaria - altre

N° di repertorio: 100835/R

RUOTE DI SERIE

DATI TECNICI

Dimensioni utili piano rete: 1950 x 650 mm

Ingombro totale barella: 1980 x 720 mm

Altezza da terra piano rete: da 540 a 900 mm

Dimensioni utili per materasso: 1900 x 650 x 60h.

Peso della barella (senza accessori) 85 kg.

Carico di lavoro sicuro: 250 kg

Capacità di sollevamento: 300kg

Inclinazione sezione schienale: da 0 gr circa 90 gr

Movimento di trendelenburg servoassistito e contro trendelenburg +12 gradi/- 10 gradi.

Classificazione CND: V0859 attrezzature di supporto all'attività sanitaria - altre

N° di repertorio: 100835/R

Posizioni 7

All. 2 di 3
Pag 2 di 3



Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20 - 31044 Montebelluna (Treviso) Italy
Tel. +39 0423 6125 Fax +39 0423 612680 info@favero.it www.favero.it

Cliente
AZ. USL RIETI
RIETI

Offerta
3902020

COPPIA SPONDE ABBATTIBILI


9889008

Dimensioni

Larghezza: 1000 mm
Profondità: 90 mm
Altezza: 375 mm

Pesi

Peso Netto: 5 kg

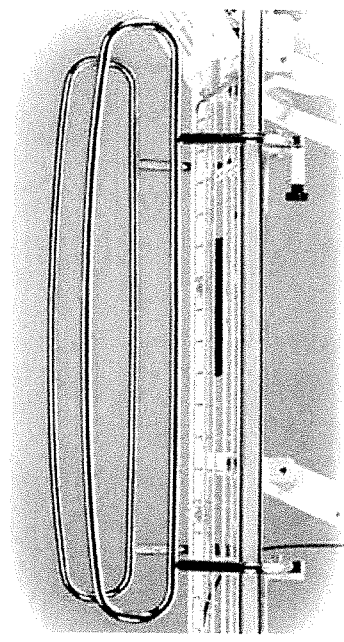

(Immagine indicativa)

Coppia sponde abbattibili in acciaio cromato agganciabili automaticamente; per barella H variabile.
Peso Kg. 5

DATI TECNICI
Dimensioni: 1000 x 375 x 90h mm

Posizioni 8



Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20 - 31044 Montebelluna (Treviso) Italy
Tel. +39 0423 6125 Fax +39 0423 612680 info@favero.it www.favero.it

Cliente
AZ. USL RIETI
RIETI


Offerta
3902020

MATERASSINO PER BARELLA

9889017

Dimensioni

Larghezza: 650 mm
Profondità: 1900 mm
Altezza: 60 mm

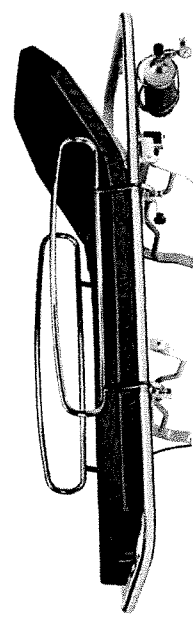

(Immagine indicativa)

Realizzato in poliuretano espanso densità 35 Kg/mc rivestito in materiale plastico lavabile.
Fissabile al piano rete con sistema a velcro e laccetti.
Materasso omologato in classe IIM.

DATI TECNICI
Dimensioni: 1900 x 650 x 60h mm

Posizioni 9

All. 2 di 3
Pag 3 di 3

Cliente
AZ. USL RIETI
RIETI


Offerta
390/2020

9LD9030

Favero Health Projects

Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20 - 31044 Montebelluna (Treviso) Italy
Tel. +39 0423 6125 Fax +39 0423.612680 info@favero.it www.favero.it

ASTA FLEBO 2 GANCI PLASTICA

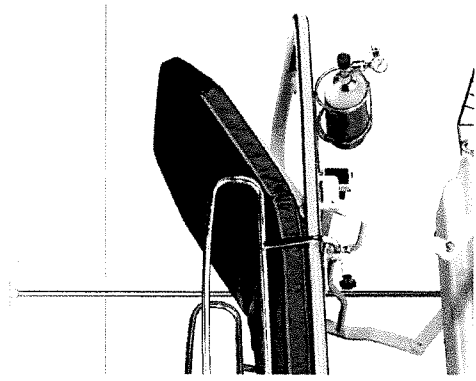

(Immagine indicativa)


Realizzata in acciaio inox con due ganci stampati in materiale plastico ad elevata resistenza agli urti.

Posizioni 10

Favero Health Projects

Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20 - 31044 Montebelluna (Treviso) Italy
Tel. +39 0423 6125 Fax +39 0423.612680 info@favero.it www.favero.it

MORSETTO PER ASTA FLEBO ART. 990/A

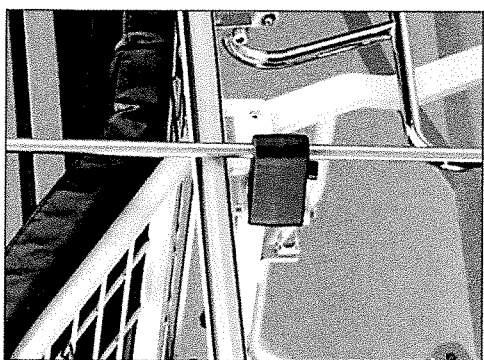

(Immagine indicativa)

Morsetto per asta flebo regolabile in altezza con dispositivo di bloccaggio. Costruzione completamente in nylon colore grigio.
Peso Kg. 0,6

Posizioni 11

All. 3 di 3
Pag 1 di 1

2/4/2020

Pasta - Matteo Palmieri - Outlook

R: Richiesta fornitura barella UOSD Malattie Infettive

Mauro Marchili <m.marchili@asl.rieti.it>

mar 16/03/2020 13:14

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>
Cc: Alessandra Martellucci <alessandra.martellucci@asl.rieti.it>
Si ritiene quanto proposto confacente agli usi previsti.
Grazie,
Mauro Marchili

Da: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Inviato: giovedì 5 marzo 2020 13:53

A: Mauro Marchili <m.marchili@asl.rieti.it>; Alessandra Martellucci <alessandra.martellucci@asl.rieti.it>
Cc: Abs <abs@asl.rieti.it>; Andrea Martellucci <a.martellucci@asl.rieti.it>

Oggetto: I: Richiesta fornitura barella UOSD Malattie Infettive

Buongiorno,

si allega alla presente la scheda la tecnica del barella accessorata, in consegna entro il 28/03/2020 presso la struttura riabilitativa di Poggio Mirieto, al fine di permettervi di valutarla se la stessa risponda e quanto si necessita.

Si resta in attesa di un celere riscontro in merito

Cordiali saluti

Dr. Matteo Palmieri
U.O. di Ecografia e Logistica di Beni e Servizi
Azienda Sanitaria Locale Rieti
Tel. 0746-279530
Fax. 0746-278730

Da: Abs <abs@asl.rieti.it>

Inviato: mercoledì 4 marzo 2020 17:30

A: Matteo Palmieri

2/4/2020

Pasta - Matteo Palmieri - Outlook

Cc: Andrea Martellucci
Oggetto: I: Richiesta fornitura barella UOSD Malattie Infettive

Da: Alessandra Martellucci <alessandra.martellucci@asl.rieti.it>

Inviato: mercoledì 4 marzo 2020 10:29

A: Abs <abs@asl.rieti.it>; Andrea Martellucci <a.martellucci@asl.rieti.it>

Cc: Casertano Luca <l.casertano@asl.rieti.it>; Mauro Marchili <m.marchili@asl.rieti.it>

Oggetto: I: Richiesta fornitura barella UOSD Malattie Infettive

A integrazione della richiesta avanzata via mail di cui all'oggetto, come richiesto per le vie brevi da ABS, si specifica:

"D'ordine del Responsabile UOSD Malattie Infettive, Dr. Mauro Marchili".

Si tiene, comunque, a precisare che ogni richiesta effettuata finora, pur se esplicitamente non specificato, è stata inoltrata sempre e solo previa autorizzazione/disposizione del Responsabile UOSD.

Cordiali saluti.

Dot.ssa Alessandra Martellucci

Coordinatrice UOSD Malattie Infettive

Da: Alessandra Martellucci <alessandra.martellucci@asl.rieti.it>

Inviato: martedì 3 marzo 2020 13:12

A: Abs; Andrea Martellucci

Cc: Casertano Luca; Mauro Marchili

Oggetto: Richiesta fornitura barella UOSD Malattie Infettive

Buonasera,

la presente per richiedere la fornitura urgente di una barella di cui dotare la UOSD Malattie Infettive da dedicare esclusivamente alla gestione di pazienti ricoverati per sospetta o accertata infezione da Sars Cov-2. Si chiede che i materiali e le singole parti di cui è costituita siano sanificabili con soluzione di ipoclorito allo 0,5%.

Cordiali saluti.

Dot.ssa Alessandra Martellucci

Coordinatrice UOSD Malattie Infettive