

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781- PEC: asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 535 del 25 MAG. 2020

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Oggetto: Accettazione della donazione di n. 200 mascherine chirurgiche, n. 20 mascherine KN95 omologate FFP2 e n. 2 termometri infrarossi mod. IR988 da parte delle società ARCA società cooperativa sociale di Piedimonte San Germano (FR) e LIFE CURE srl di Monza, da destinare alla UOC Oncologia Medica dell’Ospedale San Camillo De’ Lellis di Rieti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, legata alla diffusione del COVID-19. Valore complessivo pari ad € 456,40.

L’estensore : Dott.ssa Eleonora Franceschini

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile dell’istruttoria: Dott. ssa Eleonora Franceschini

Data 19/05/2020

Firma Eleonora Franceschini

Il Dirigente: Dott. Andrea Martellucci

Data 19/05/2020

Firma Andrea Martellucci

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 25.05.2020

Firma Anna Petti

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dott. Gennaro D’Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 17.05.2020

Firma Gennaro D’Agostino

Oggetto: Accettazione della donazione di n. 200 mascherine chirurgiche, n. 20 mascherine KN95 omologate FFP2 e n. 2 termometri infrarossi mod. IR988 da parte delle società ARCA società cooperativa sociale di Piedimonte San Germano (FR) e LIFE CURE srl di Monza, da destinare alla UOC Oncologia Medica dell'Ospedale San Camillo De' Lellis di Rieti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, legata alla diffusione del COVID-19. Valore complessivo pari ad € 456,40.
Pag. 2 di 4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che con comunicazione del 05/05/2020, le società ARCA società cooperativa sociale di Piedimonte San Germano (FR) e LIFE CURE srl di Monza, hanno manifestato all'Azienda Sanitaria Locale di Rieti la volontà di donare n. 200 mascherine chirurgiche, n. 20 mascherine KN95 omologate FFP2 e n. 2 termometri infrarossi mod. IR988, da destinare alla UOC Oncologia Medica dell'Ospedale San Camillo De' Lellis di Rieti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, legata alla diffusione del COVID-19 (all. 1);

DATO ATTO CHE il valore complessivo dei beni oggetto della presente donazione ammonta ad € 456,40;

TENUTO CONTO dei pareri positivi espressi dalla Responsabile della Servizio Prevenzione e Protezione e dal Dirigente della UOC Oncologia Medica dell'Ospedale San Camillo De' Lellis di Rieti, ognuno per le parti di propria competenza, acquisiti agli atti;

VISTO il regolamento aziendale in tema di donazioni approvato con deliberazione n. 1225 del 27 ottobre 2016 e modificato, da ultimo con atto deliberativo n. 596/DG del 03/07/2019;

PRESO ATTO della procedura in urgenza, comunicata con mail del 20/03/2020, agli atti, relativa all'accettazione di beni sanitari durante l'emergenza legata alla diffusione del COVID-19

TENUTO CONTO che la proposta formulata dalle società contiene tutte le informazioni necessarie per poter procedere all'accettazione della donazione;

DATO ATTO che la donazione non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda nei confronti del donante;

RITENUTO, pertanto, di poter accettare la donazione sopracitata nell'interesse dell'Azienda, per fronteggiare l'emergenza in corso, legata al COVID-19;

ATTESTATO CHE il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Oggetto: Accettazione della donazione di n. 200 mascherine chirurgiche, n. 20 mascherine KN95 omologate FFP2 e n. 2 termometri infrarossi mod. IR988 da parte delle società ARCA società cooperativa sociale di Piedimonte San Germano (FR) e LIFE CURE srl di Monza, da destinare alla UOC Oncologia Medica dell'Ospedale San Camillo De' Lellis di Rieti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, legata alla diffusione del COVID-19. Valore complessivo pari ad € 456,40.
Pag. 3di 4

PROPONE

1. **DI ACCETTARE** per le motivazioni espresse in premessa, la donazione di n. 200 mascherine chirurgiche, n. 20 mascherine KN95 omologate FFP2 e n. 2 termometri infrarossi mod. IR988, del valore complessivo di € 456,40, da parte delle società ARCA società cooperativa sociale di Piedimonte San Germano (FR) e LIFE CURE srl di Monza;
2. **DI DESTINARE** i beni oggetto della presente donazione alle esigenze UOC Oncologia Medica dell'Ospedale San Camillo De' Lellis di Rieti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, legata alla diffusione del COVID-19;
3. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 25 MAG. 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 25 MAG. 2020

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 25 MAG. 2020

Rieti li 25 MAG. 2020

IL FUNZIONARIO

Pete Tarko



Arca Cooperativa

Spett.le
ASL di RIETI
Via del Terminillo 42
02100 Rieti

C.A. Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

C.A. Farmacia Ospedaliera
P.O. San Camillo De Lellis
Via J. F. Kennedy, snc
02100 Rieti

Rieti, 30 Aprile 2020

**OGGETTO: PROPOSTA DI DONAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ALL'UOC
ONCOLOGICA MEDICA**

Gent.ma Dott.ssa D'Innocenzo,

la società **ARCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**, con sede legale in via Carlo D'Aguanno 11/13, 03030 Piedimonte San Germano (FR), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone n. 163696, Codice Fiscale & Partita IVA 02597940606, in persona del proprio Legale Rappresentante pro tempore Dott. Mario Nardoiani, munito degli occorrenti poteri;

e

la società **LIFE CURE S.R.L.**, con sede legale in Monza, Via Silvio Pellico 48, 20900 Monza, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 01140460294, iscritta dal 13.07.14 – P.I. 01140460294 in persona del proprio Legale Rappresentante pro tempore Dott. Michele Piovella, munito degli occorrenti poteri;

DICHIARANO

di voler effettuare specifica donazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (mascherine chirurgiche, KN95 e termometri digitali) a codesta all'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, da destinare al reparto di Oncologia Medica del Presidio Ospedaliero "Camillo De Lellis", a norma di quanto stabilito e regolamentato dalla legislazione regionale vigente, al fine di poter contribuire a fronteggiare l'emergenza nazionale legata alla pandemia da COVID-19.



La donazione dei beni non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti nei confronti delle società proponenti la donazione. L'eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene è comunemente reperibile sul mercato a livello concorrenziale. Unitamente ai beni oggetto di donazione saranno consegnati tutti i manuali operativi necessari per l'uso ed i manuali di service necessari per l'esecuzione della manutenzione correttiva e preventiva.

ELENCO DISPOSITIVI OGGETTO DI DONAZIONE

Tipo: Mascherina Chirurgica, munita di apposito certificato
Quantità: 200 unità

Tipo: Mascherina KN95 omologata FFP2, munita di apposito certificato
Quantità: 20 unità

Tipo: Termometro Infrarossi, mod. IR988, munita di apposito certificato
Quantità: 2 unità

Valore complessivo dei dispositivi sopra elencati: € 456,40

DATI DELL'UNITA' OPERATIVA DI DESTINAZIONE

Sede: Presidio Ospedaliero "Camillo De Lellis"
Via: Via J.F. Kennedy, snc
U.O.: Oncologia Medica


Si allega DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA del bene, sottoscritta dal Produttore, alle competenti norme di sicurezza ed alle leggi vigenti in materia.

Restiamo in attesa di Vostro cortese riscontro in merito.

In Fede


Mario Nardaianni
Dott. Mario Nardaianni
Amministratore Delegato
Arca Società Cooperativa Sociale


Michele Riovella
Dott. Michele Riovella
Amministratore Delegato
Life Cure Srl

MASCHERA monouso pieghevole KN195 senza filtro Art. KN95


Ref: 70005

Mundschutzmasken Typ IR, mit Gummiband
3-lage, Innenseite weiß, Aussenseite blau
Masque de protection Typ IR avec ruban élastique
3-couche, intérieur blanc, extérieur bleu
Mascheri di protezione tipo IR con bande elastiche
3-strati, interno bianco, esterno blu
Face masks Typ IR with elastic ear loop
3-layer, inside white, outside blu
Schachtel/boite/scatola/carton à 50 Stk/pcs

For Customer name: *Kronamer's company name*

 Dongguan Risen Medical Products Co., Ltd. CN-Dongguan City
Made in China

Nome articolo:	KN95 MASK
Descrizione del materiale:	tessuto non tessuto, filtro soffiato a fusione
Peso / unità:	0,005 / G
Imballaggio di trasporto:	10 pezzi / pacco, 800 pezzi / CTN
Dimensioni della scatola:	59 * 34 * 33 cm
Peso CTN:	5 kg
Norma applicabile:	GB2626-2006
Certificato applicabile:	produzione secondo la garanzia di qualità del produttore EN146



Compliance Report

Applicant: Dongguan City Risen Medical Products Co., Ltd.
 Address: No. 7 Changye Industrial Park, Jiangshanzhou, Wenshan, D.,
 Dongguan, Guangdong, P.R. China.

Product: See annex for details
 Type: See annex for details

Product Classification: Class I


The submitted technical files including test report of the above products have been reviewed against the self-declaration requirements of conformity for CE marking according to Annex I & VII of the 93/42/EEC Medical Device Directive (including 2007/14/EC).

The review result of the technical files and test report support the self-declaration for the devices listed above. The test report and the technical files are the subject of this report and should be used together.

Where the manufacturer affixes the CE marking to the product(s) they must ensure that all the requirements of the appropriate EU directives have and continue to be met.

This report is not a certificate of conformity.

No. 03083
 Initial Issue Date: 22 Nov 2019



 Signatary

This report is the property of NQA and should be returned to NQA upon request.





SATCOM srl

Sede Legale Viale San Marco nr 58/A - 34074 MONFALCONE (GO) - ITALIA
Uffici e Magazzino Via san Giorgio nr 94 - 34079 STARANZANO (GO)
Telefono +39 0481 1995500 / +39 0481.486065 Fax +39 0481 1990440

P IVA 01084800315 e mail info@sat-com.eu pec sat-com@pec.it home page www.sat-com.eu



Annex to Report (No. 03083)

Dongguan City Risen Medical Products Co., Ltd.

Product Name	Type
High elastic bandage	5*450CM 7.5*450cm 10*450cm
crepe bandage	5*450CM 7.5*450cm 10*450cm
First aid bandage	6*8CM*4M 8*10CM*4M
Self-adhesive bandage	5*450CM 7.5*450cm 10*450cm
elastic bandage	4 inches 6 inch
Triangle bandage	96*96*136cm
medical tape	1.5*450CM 2.5*450cm
seamless tape	6*100mm
Tourniquet	2.5*45CM
cast splint/wound splint	11*46CM 11*45CM
alcohol prep pad	
antiseptic cleansing wipe	6*8CM
PVC gloves	L
plastic footwear	10.5CM 13CM
Metal tweezers(tweezers)	10.5CM 13CM

Special specifications according to customer requirements.
This annex is only valid if attached to the report mentioned above.

This report is the property of NQA and should be returned to NQA upon request.

NATO CAGE code AM055
UNGM Number 241981



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 2008 Reg No 11368-A
Codice Univoco Fattura Elettronica KRRH6B9
Codice Univoco Ordini Elettronici KHNLG6PIM


Annex to Report (No. 03083)

Dongguan City Risen Medical Products Co., Ltd.

Product Name	Type
blunt scissors	15CM 18CM
CPR mask	20*20cm
Disposable mask	18*10CM
cooling fever	14*6.5CM
thermometer	12*2CM
ice bag	180G
cotton swab	7.5CM
Cotton ball	10PCS/package
rolling splint	10*15cm
magnetic depressor	15*1.8*0.1cm
emergency blanket	130*210CM
Military Tourniquet	2.5*40cm
reflective vest	L
Survival Kit	17*10.5*5CM
Car emergency kit	36*18*15CM
Baby care kit	16.5*10*8CM
salinon	42*42*42cm
warning triangle	40*40*40cm
medical orthopedic	5*11*10.5CM
	5*5CM
gauze swab	7.5*7.5CM 10*10CM
	5*5CM
nonwoven swab	7.5*7.5CM 10*10CM
eye pad	6*8CM
First aid kit / first aid bag / first aid box	23*15*7.5CM

Special specifications according to customer requirements.
This annex is only valid if attached to the report mentioned above.

This report is the property of NQA and should be returned to NQA upon request.






MASCHERNE
CHIRURGISCHE

Certificate

No. Q6 051736 0013 Rev. 00

Holder of Certificate: Unimax Medical Products Co., Ltd.

Special No. 1 Liansai Road
Changshangkou Town
433024 Xiantao City, Hubei Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:



Scope of Certificate:

Production and Distribution of Medical Gauze Products, Medical Bandages, Medical Non-woven Products, Disposable Medical Plastic Products, Medical Cotton Products, Zinc Oxide Plaster, Adhesive Dressing Tapes, ABD Pad, Surgical Drapes, Surgical Gowns, First-aid-kit, Surgical Gloves, Examination Gloves, Sterile Hemostatic Adhesive Dressing (Wound Plaster/Liquid Transfusion Plaster/Adhesive Wound Dressing), Medical Eye Pads, Urethral Catheters, Tracheal Tubes, Suction Catheters, Nelaton Catheters, Feeding Tubes, Stomach Tubes, Tracheostomy Tubes, Urine Bags, Umbilical Cord Clamps for Single Use, Disposable Medical Device of Infusion and Transfusion, Intravascular Catheters, Disposable Surgical Blades, Sterile Scalpel with Plastic Handle, Surgical Instruments, Wheelchairs, Blood Bags, Wooden Tongue Depressors, Alcohol Pads, Non-woven Face Masks

The Certification Body of TUV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system (excluding subclause 7.3), which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.


Report No.: SH1812016
Valid from: 2019-05-06
Valid until: 2021-06-30

Date, 2019-05-06

Stefan Preiß



TUV SÜD CERTIFICATION



出口认证 CE ROHS

(FDA正在办理, 预计3月20日拿到)

ITC

CERTIFICATE OF EMC COMPLIANCE
According to Directive: 2014/53/EU
Ref No: 2017C020327


Applicant Address	Floor 3, Building D, No.113, Xikang Industrial Zone, Zhong Kai High-Tech Zone, Huzhou City
Manufacturer Address	Huzhou Xiaocou Technology Co., Ltd. Floor 3, Building D, No.113, Xikang Industrial Zone, Zhong Kai High-Tech Zone, Huzhou City
Product	Non-contact infrared thermometer
Brand Name	N/A
Model No.	IFR88

The test sample of product has been passed the test according to requirements of the following standards:

Standard(s)	EN 60950-1-2:2007
	EN 61000-3-2:2006+A1:2009
	EN 61000-3-3:2013

Based on the reference assessment of the product sample and technical file we confirm that the above-mentioned product meets the requirements of the CE directive. The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer of the importer, after completion of an EC declaration of conformity with the relevant EC directives.

CE Approved by Date: Mar. 11, 2020

 Department: Mar. 11, 2020

Shenzhen ITC Product Testing Co., Ltd.
2nd Floor, Building A7, Xixun Xingyuan Industrial Area, Fubin Road, Fubin District, Shenzhen, China
Tel: (86) 755-23115888 Fax: (86) 755-23115883 Email: i@itc.com.cn

ITC

CERTIFICATE OF COMPLIANCE
2015/863/EU Restriction of Hazardous Substance
Ref No: 2017C020328


Applicant Address	Floor 3, Building D, No.113, Xikang Industrial Zone, Zhong Kai High-Tech Zone, Huzhou City
Manufacturer Address	Huzhou Xiaocou Technology Co., Ltd. Floor 3, Building D, No.113, Xikang Industrial Zone, Zhong Kai High-Tech Zone, Huzhou City
Product	Non-contact infrared thermometer
Brand Name	N/A
Model No.	IFR88

The test sample of product has been passed the test according to requirements of the following standards:

Standard(s)	IEC 62321-3-1:2013
	IEC 62321-4:2013+A1:2017
	IEC 62321-5:2013
	IEC 62321-2:2013
	IEC 62321-4:2017

The Certificate of compliance is based on a test procedure or an evaluation of the above mentioned product. This is to verify that the above-mentioned product is in compliance with the EU RoHS Directive 2015/863/EU and its amendment Directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the European parliament.

ROHS Approved by Date: Mar. 19, 2020

 Department: Mar. 19, 2020

Shenzhen ITC Product Testing Co., Ltd.
2nd Floor, Building A7, Xixun Xingyuan Industrial Area, Fubin Road, Fubin District, Shenzhen, China
Tel: (86) 755-23115888 Fax: (86) 755-23115883 Email: i@itc.com.cn





出口认证 FCC



Shenzhen ITC Product Testing Co., Ltd.

Report No.: 20JTC0302328F

FCC TEST REPORT

Client Information:

Applicant: Floor 3, Building D, No. 113, Xikeng Industrial Zone, Zhong Kai High-tech Zone, Huizhou City
 Applicant addi:
 Brand Name N/A




Product Information:

Product Name: Non-contact infrared thermometer
 Model No.: IR888
 Derivative model No.: N/A

Test Date: Mar. 08, 2020 to Mar. 13, 2020 Issue Date: Mar. 13, 2020

Test Standard: FCC Part 16, Subpart B: 2016
ANSI C83.4-2014


Test Result: PASS

Tested by	Amanda Chen	
Reviewed by	Apple Huang	
Approved by	John Liu	



This test report may be reproduced in full only





产品信息



Infrared Thermometer

PIVA

非接触式红外线测温仪

产品信息

了解产品结构和参数信息，操作使用更简单上手

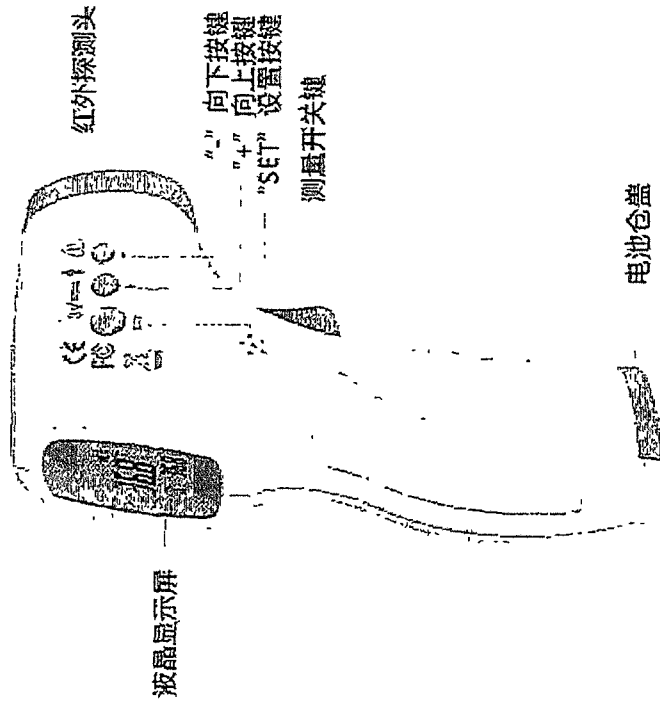

适用人群	不限	记忆功能	32组
测量方式	非接触式	电源	DC3V, 2节 (AA) 5号电池
测量部位	额头表面	尺寸	约150x96x44MM
测量距离	3~5CM	净重	约123g
测量范围	体温: 34.8°C~42.5°C 物温: 0°C~93°C (±1°C)	最大允许误差	35°C~42.0°C (±0.2°C) 其他范围 (±0.3°C)

产品图片

