

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con inversione procedimentale per la fornitura, con formula "chiavi in mano", di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" – CIG: B284EB128D - CUP: I12C23000820001.

VERBALE DI GARA n. 1 del 03.09.2024

Il giorno 03.09.2024 alle ore 10:30, la Commissione Giudicatrice si è riunita presso la sala riunioni della U.O.C Tecnico Patrimoniale della ASL di Rieti – Blocco n. 3 ex O.P.P. sita in Via del Terminillo n. 42, Rieti.

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 712/C.S. del 18.07.2024 è stata indetta una "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con inversione procedimentale per la fornitura, con formula "chiavi in mano", di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 4.151.432,44 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" - CUP: I12C23000820001", approvandone i relativi atti di gara;
- con il predetto provvedimento è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), con i compiti di cui all'art. 15 del Codice, l'Ing. Daniele Della Vedova;
- con atto deliberativo n. 791/C.S./2024 del 07.08.2024 è stato rettificato parzialmente il Disciplinare di Gara, inserendo all'art. 24 la seguente dicitura: "La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di una sola offerta";
- gli atti relativi alla procedura di gara, con Registro di Sistema n. PI133971-24, sono stati pubblicati sulla piattaforma di approvvigionamento S.TEL.LA della Regione Lazio e sul sito istituzionale di quest'Azienda, sezione "Amministrazione trasparente" in data 18.07.2024;
- il bando di gara è stato pubblicato su GUUE in data 22/07/2024 00:00 Numero: 438225-2024 e sulla PVL/ANAC in data 23.07.2024 09:00 Numero: 4bd6a696-1f1e-42bf-8de6-ed4306a28754 tramite la piattaforma digitale S.TEL.LA;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 23.08.2024 ore 18:00 e la data di apertura delle offerte in seduta pubblica virtuale il 02.09.2024 ore 10:30;
- con Avviso del 13.08.2024 è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle offerte fissato al 29.08.2024 ore 18:00 e della data per la prima seduta pubblica prevista per il 03.09.2024 ore 10:30;
- entro il suddetto termine sono state presentate, sulla piattaforma telematica di negoziazione "S.TEL.LA." della Regione Lazio, n. 3 offerte prodotte dai seguenti operatori economici:
 1. RTI Philips - GOWEN SRL - Gnode Service;
 2. RTI GE Medical Systems Italia S.p.A. - Morviducci Srl;
 3. RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - Technoproject s.r.l.
- con atto deliberativo n. 848/C.S. del 30.08.2024 sono stati nominati, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, i componenti della Commissione giudicatrice preposta all'espletamento delle operazioni di gara composta come di seguito specificato:



- Dott. Stefano Canitano, Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini della ASL Rieti in qualità di Presidente;
- Dott. Andrea Leonardi, Dirigente medico della U.O.C. Diagnostica per Immagini della ASL Rieti in qualità di componente;
- Dott. Marco Savi, T.S.R.M. in servizio presso la U.O.C. Diagnostica per Immagini della ASL Rieti in qualità di componente;
- Ing. Marco Risa, Collaboratore Tecnico in servizio presso la U.O.S.D. Ingegneria Clinica della ASL Rieti in qualità di componente;
- Ing. Francesco Prestanicola, Direttore f.f. della U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti Territorio della ASL Roma 2 in qualità di componente;
- Dott.ssa Laura Marroni, Collaboratore Amministrativo in servizio presso la U.O.C. Tecnico Patrimoniale – ASL Rieti (Segretario verbalizzante senza diritto di voto);
- con nota prot. n. 61215 del 02.09.2024, il RUP ha proceduto a convocare la Commissione Giudicatrice per il giorno 03.09.2024 ore 10:30;

Il Presidente della Commissione

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti, constatata la presenza di tutti i componenti, da inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione prende atto che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

1. RTI Philips - GOWEN SRL - Gnode Service;
2. RTI GE Medical Systems Italia S.p.A. - Morviducci Srl;
3. RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - Technoproject s.r.l.

I Componenti ed il segretario della Commissione

Preso atto dell'oggetto dell'appalto di cui trattasi e degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, hanno dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all'art. 35 bis D. Lgs 165/2001 e s.m.i. nonché l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del Codice degli appalti, dell'art. 6-bis Legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del quadro normativo correlato, come risulta dalle dichiarazioni rese all'atto dell'accettazione dell'incarico, che pur se non materialmente allegate al presente verbale ne formano parte integrante e sostanziale, restano depositate agli atti del RUP.

La Commissione di gara prende atto di tutta la documentazione di gara comprendente il Bando, il Disciplinare di Gara, il PFTE, i Capitolati Tecnici e relativi allegati, nonché dei chiarimenti forniti dal RUP agli operatori economici entro il termine di presentazione delle offerte.

Atteso quanto sopra, il Presidente della Commissione stabilisce di procedere, di concerto, ad analizzare i criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica e del relativo metodo di attribuzione dei punteggi di cui all'art. 18 del Disciplinare di Gara.

Preliminarmente, il RUP, procede allo sblocco della busta amministrativa virtuale, al solo fine di permettere alla piattaforma "S.TEL.LA" di attivare la fase di apertura delle offerte tecniche ed economiche, così come previsto nel Disciplinare di Gara, la c.d. "inversione procedimentale" ex art. 107, comma 3 del D. Lgs. 36/2023;

Il Presidente, alle ore 10:44, da inizio ai lavori in seduta pubblica virtuale per procedere all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica dei partecipanti ed al fine di verificare la presenza, all'interno delle stesse, della documentazione richiesta all'art. 16 del Disciplinare, nonché dell'assenza di riferimenti all'offerta economica.

Si procede alla verifica dell'integrità dell'offerta telematica presente sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Dalla successiva apertura risulta quanto di seguito riportato:

RTI PHILIPS - GOWEN SRL - GNODI SERVICE

La Commissione riscontra la presenza, all'interno della "Busta Tecnica", di n. 1 cartella .zip denominata "Documentazione Tecnica.zip.p7m" firmata digitalmente – con seriale n.: BB2F7BE7DABDC8951EAD043E78683A19F121D3F6A4AAFF27F104FB83335F661, contenente la documentazione richiesta all'art. 16 del Disciplinare di Gara. Terminata la verifica della documentazione prodotta, la Commissione, ammette l'operatore economico alle successive fasi di gara.

RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - MORVIDUCCI SRL

La Commissione riscontra la presenza, all'interno della "Busta Tecnica", di n. 1 cartella .zip denominata "Doc Tecnica.zip.p7m" firmata digitalmente – con seriale n.: E54710049FDC5C1CCE971CC04B2B77C3E0E5BA3DCEC2FE40A4654AB2AD16AF94, contenente la documentazione richiesta all'art. 16 del Disciplinare di Gara. Terminata la verifica della documentazione prodotta, la Commissione, ammette l'operatore economico alle successive fasi di gara.

RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - TECHNORJECT S.R.L.

La Commissione riscontra la presenza, all'interno della "Busta Tecnica", di n. 1 cartella .zip denominata "Documentazione tecnica.zip.p7m" firmata digitalmente – con seriale n.: 857964CD82FE94801301CAE15A94409CB1CC6A74E06146B7652A2B759DC31267, contenente la documentazione richiesta all'art. 16 del Disciplinare di Gara. Terminata la verifica della documentazione prodotta, la Commissione, ammette l'operatore economico alle successive fasi di gara.



Alle ore 11:20, il Presidente chiude i lavori in seduta pubblica e stabilisce, nel rispetto di quanto previsto all'art. 20 del Disciplinare di Gara, di proseguire, in seduta riservata, con i lavori inerenti l'esame e la valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto indicato all'art. 18 del Disciplinare, utilizzando la griglia di valutazione delle offerte tecniche (Allegato 1.2 agli atti di gara) che andrà a definire lo strumento riepilogativo per ogni concorrente.

In prosecuzione di seduta la Commissione procede con la disamina della parte relativa alla fornitura delle apparecchiature con particolare riferimento alla verifica delle caratteristiche minime previste dal Capitolato Tecnico.

Di seguito la commissione procede alla valutazione delle stesse sulla base dei criteri e sub-criteri individuati dagli atti di gara, annotando le proprie considerazioni sulle schede di valutazione di ciascun partecipante.

Alle ore 20:00, il Presidente sospende i lavori fissando la data per la successiva seduta riservata per il giorno 06.09.2024 ore 9:00.

Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto dalla Commissione giudicatrice e dal segretario come segue:

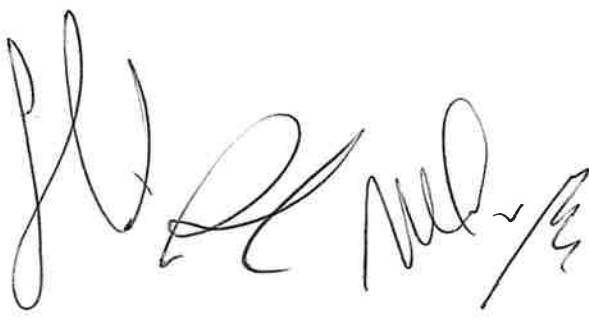 3  

Componente Dott. Andrea Leonardi

Componente Dott. Marco Savi

Componente Ing. Marco Risa

Componente Ing. Francesco Prestanicola

Segretario verbalizzante Dott.ssa Laura Marroni

 **REGIONE
LAZIO**







AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con inversione procedimentale per la fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 “Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025” – CIG: B284EB128D - CUP: I12C23000820001.

**VERBALE GARA n. 2 del 06.09.2024
SEDUTA RISERVATA**

Il giorno 06.09.2024 alle ore 9:00, la Commissione Giudicatrice si è riunita presso la sala riunioni della U.O.C Tecnico Patrimoniale della ASL di Rieti – Blocco n. 3 ex O.P.P. sita in Via del Terminillo n. 42, Rieti; l'Ing. Francesco Prestanicola partecipa in conference Call sulla piattaforma Teams.

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 712/C.S. del 18.07.2024 è stata indetta una “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con inversione procedimentale per la fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 4.151.432,44 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 “Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025” - CUP: I12C23000820001”, approvandone i relativi atti di gara;
- con il predetto provvedimento è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), con i compiti di cui all'art. 15 del Codice, l'Ing. Daniele Della Vedova;
- con atto deliberativo n. 791/C.S./2024 del 07.08.2024 è stato rettificato parzialmente il Disciplinare di Gara, inserendo all'art. 24 la seguente dicitura: “La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di una sola offerta”;
- gli atti relativi alla procedura di gara, con Registro di Sistema n. PI133971-24, sono stati pubblicati sulla piattaforma di approvvigionamento S.TEL.LA della Regione Lazio e sul sito istituzionale di quest'Azienda, sezione “Amministrazione trasparente” in data 18.07.2024;
- il bando di gara è stato pubblicato su GUUE in data 22/07/2024 00:00 Numero: 438225-2024 e sulla PVL/ANAC in data 23.07.2024 09:00 Numero: 4bd6a696-1f1e-42bf-8de6-ed4306a28754 tramite la piattaforma digitale S.TEL.LA;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 23.08.2024 ore 18:00 e la data di apertura delle offerte in seduta pubblica virtuale il 02.09.2024 ore 10:30;
- con Avviso del 13.08.2024 è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle offerte fissato al 29.08.2024 ore 18:00 e della data per la prima seduta pubblica prevista per il 03.09.2024 ore 10:30;
- entro il suddetto termine sono state presentate, sulla piattaforma telematica di negoziazione “S.TEL.LA.” della Regione Lazio, n. 3 offerte prodotte dai seguenti operatori economici:
 1. RTI Philips - GOWEN SRL - Gnode Service;
 2. RTI GE Medical Systems Italia S.p.A. - Morviducci Srl;
 3. RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - Technoproject s.r.l.

1


- con atto deliberativo n. 848/C.S. del 30.08.2024 sono stati nominati, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, i componenti della Commissione giudicatrice preposta all'espletamento delle operazioni di gara composta come di seguito specificato:
 - Dott. Stefano Canitano, Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini della ASL Rieti in qualità di Presidente;
 - Dott. Andrea Leonardi, Dirigente medico della U.O.C. Diagnostica per Immagini della ASL Rieti in qualità di componente;
 - Dott. Marco Savi, T.S.R.M. in servizio presso la U.O.C. Diagnostica per Immagini della ASL Rieti in qualità di componente;
 - Ing. Marco Risa, Collaboratore Tecnico in servizio presso la U.O.S.D. Ingegneria Clinica della ASL Rieti in qualità di componente;
 - Ing. Francesco Prestanicola, Direttore f.f. della U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti Territorio della ASL Roma 2 in qualità di componente;
 - Dott.ssa Laura Marroni, Collaboratore Amministrativo in servizio presso la U.O.C. Tecnico Patrimoniale – ASL Rieti (Segretario verbalizzante senza diritto di voto);
- con nota prot. n. 61215 del 02.09.2024, il RUP ha proceduto a convocare la Commissione Giudicatrice per il giorno 03.09.2024 ore 10:30;
- in data 03.09.2024, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica virtuale per l'apertura e la verifica del contenuto dell'offerta tecnica prodotta dagli operatori economici; in prosecuzione di seduta, la Commissione giudicatrice ha proceduto in seduta riservata alla disamina ed alla valutazione delle offerte di ciascun partecipante – giusto Verbale di Gara n. 1 del 03.09.2024;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti, la Commissione al completo da inizio ai lavori in seduta riservata per continuare con i lavori relativi alla valutazione tecnica delle offerte ed alla conseguente attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 18 del Disciplinare di Gara e redigendo contestualmente la scheda di valutazione dei concorrenti.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche risultano i seguenti punteggi totali:

ID	Ragione Sociale	RTI Philips	RTI GEMSI	RTI SIEMENS
1	Risonanza magnetica 3,0 T	28,9165	30,9756	32,4456
2	Tomografo computerizzato non inferiore a 256 strati	26,5222	27,3532	27,6129
3	RMN e TAC in noleggio / strutture mobile / box	7,20	9,00	9,00
4	Lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per immagini	5,60	4,20	7,00
Totale		68,2388	71,5287	76,0585

La Commissione prende atto che nell'art. 18.1 del Disciplinare di gara è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50/90 punti, pertanto procede, per ciascuna offerta, al calcolo della suddetta soglia con le risultanze di seguito riportate:

ID	Ragione Sociale	Pt	Sbarramento 50/90 Superamento soglia
1	RTI Philips - GOWEN SRL - Gnode Service	68,2388	SI
2	RTI GE Medical Systems Italia S.p.A. - Morviducci Srl	71,5287	SI
3	RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - Technoporject s.r.l.	76,0585	SI

Il Presidente, alle ore 14:00, chiude la seduta riservata e stabilisce di riconvocare la Commissione in data 11.09.2024 ore 10:00 in seduta riservata, per l'inserimento su piattaforma S.TEL.LA. delle

2




risultanze delle valutazioni tecniche compiute dalla Commissione e, di continuare, stesso giorno, in seduta pubblica virtuale per rendere noti i punteggi tecnici attribuiti e aprire le offerte economiche prodotte dai concorrenti.

Al presente verbale si allega la *Griglia di valutazione dei punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti* e relativo allegato che ne forma parte integrante e sostanziale.

Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto dalla Commissione giudicatrice e dal segretario come segue:

Presidente Dott. Stefano Canitano

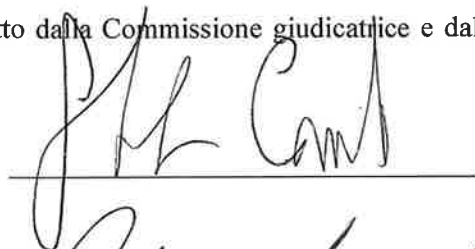

Componente Dott. Andrea Leonardi



Componente Dott. Marco Savi



Componente Ing. Marco Risa



Componente Ing. Francesco Prestanicola



Segretario verbalizzante Dott.ssa Laura Marroni



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	REQUISITO MINIMO	U. M.	PUNTI MAX	PUNTI T	PUNTI Q	PUNTI D	FORMULA	Valore RTI Philips	Valore RTI Siemens	Punteggio RTI Philips	Punteggio RTI Siemens
RISONANZA MAGNETICA 3.0 T												
1	Magnete											
1.1	Autoschermatura del magnete			1.0			1.0	relazione descrittiva	0.6	1	0.6	1
1.2	Omogeneità del campo magnetico statico su una sfera di 40 cm con metodo di misura VMRS		ppm	0.5		0.5	0.5	$Pi=(Vmin/Vi)*Pmax$	0.34	0.25	0.376	0.5000
1.3	Omogeneità del campo magnetico statico su una sfera di 30 cm con metodo di misura VMRS		ppm	0.5		0.5	0.5	$Pi=(Vmin/Vi)*Pmax$	0.05	0.06	0.07	0.5000
1.4	Omogeneità del campo magnetico statico su una sfera di 20 cm con metodo di misura VMRS		ppm	0.5		0.5	0.5	$Pi=(Vmin/Vi)*Pmax$	0.009	0.02	0.016	0.2250
1.5	Omogeneità del campo magnetico statico su una sfera di 10 cm con metodo di misura VMRS		ppm	0.5		0.5	0.5	$Pi=(Vmin/Vi)*Pmax$	0.001	0.005	0.002	0.5000
1.6	Stabilità temporale del campo magnetico	0,1	ppm/h	0.5		0.5	0.5	$Pi=(10-1-Vi)/(10-1-Vmin)*Pmax$	0.001	0.1	0.001	0.5
1.7	Sistemi di shielding passivo			0.5		0.5	0.5	relazione descrittiva	0.6	1	0.8	0.3
1.8	Sistemi di shielding del 1° ordine			0.5		0.5	0.5	relazione descrittiva	0.6	1	0.8	0.3
1.9	Sistemi di shielding del 1° ordine	70	cm	1.0		1.0	1.0	$Pi=(Vi-70)/(Vmax-70)*Pmax$	70	70	70	0
1.10	Dimensioni del gantry all'esterno											
1.11	Dimensioni di ingombro della parte di apparecchiatura da installare in sala magnetica, incluse le coperture, le svassature e il lettino portapaziente		cm	1.0		1.0	1.0	$Pi=(Vmin/Vi)*Pmax$	437	491.6	449	1
2. Tavolo portapaziente												
2.1	Escursione massima longitudinale motorizzata del lettino portapaziente		cm	0.5		0.5	0.5	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$	275	294	281.5	0.4677
2.2	Minima altezza da terra del tavolo portapaziente		cm	0.5		0.5	0.5	$Pi=(Vmin/Vi)*Pmax$	59	70	52	0.4407
2.3	Copertura di scansione longitudinale massima senza riposizionamento del paziente		cm	0.5		0.5	0.5	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$	215	205	205	0.5000
2.4	Altre caratteristiche del lettino portapaziente			0.5		0.5	0.5	relazione descrittiva	0.6	1	0.6	0.3000
2.5	Peso massimo consentito del paziente durante il movimento longitudinale e verticale	200		1.0		1.0	1.0	$Pi=(Vi-200)/(Vmax-200)*Pmax$	250	250	250	1.0000
3. Gradienti nelle 3 direzioni dello spazio 3x3												
3.1	Intensità massima dei gradienti nel massimo FOV disponibile	44	mT/m su massimo FOV in cm	1.0		1.0	1.0	$Pi=(Vi-44)/(Vmax-44)*Pmax$	45	78	78	0.0294
3.2	Slew Rate massimo	200	mT/m/ms	1.0		1.0	1.0	$Pi=(Vi-200)/(Vmax-200)*Pmax$	220	346	346	0.1370
3.3	Sistema di schermatura dei gradienti		%	0.5		0.5	0.5	relazione descrittiva	99.97	99.96	99.9	0.5
3.4	Linearità al massimo FOV			0.5		0.5	0.5	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$	0.8	0.8	0.8	0.4
4. Catena di radiofrequenza												
4.1	Sistema di digitalizzazione del segnale			0.5		0.5	0.5	relazione descrittiva	0.8	0.8	0.8	0.4
4.2	Sistema di multi-trasmissione dell'impulso di RF			0.5		0.5	0.5	relazione descrittiva	0.8	1	0.8	0.4
4.3	Numero di canali indipendenti e non multiplexati, utilizzabili simultaneamente in ricezione all'interno del FOV massimo disponibile		ti	0.5		0.5	0.5	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$	120	97	204	0.2941
4.4	Potenza dell'amplificatore di RF		Kw	0.5		0.5	0.5	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$	36	30	37.5	0.48
5. Sequenze e tecniche di acquisizione												
5.1	Campo di vista massimo (FOV)		cm	1.0		1.0	1.0	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$	55	50	55	1
5.2	Matrice massima di acquisizione non interpolata		NN	0.5		0.5	0.5	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$	2048	1024	1024	0.5
5.3	Spessore minimo dello strato in modalità 2D		mm	0.5		0.5	0.5	$Pi=(Vmin/Vi)*Pmax$	0.5	0.2	0.1	0.1
5.4	Spessore minimo dello strato in modalità 3D		mm	0.5		0.5	0.5	$Pi=(Vmin/Vi)*Pmax$	0.05	0.1	0.05	0.5
5.5	Tecniche di accelerazione 2D e 3D			0.5		0.5	0.5	relazione descrittiva	0.6	1	0.8	0.3
5.6	Metodi di imaging parallelo			0.5		0.5	0.5	relazione descrittiva	0.4	1	0.8	0.2
5.7	MRS (Magnetic Resonance Spectroscopy) del protone con modalità singolo voxel, multi voxel per applicazioni di neuroimaging			0.5		0.5	0.5	relazione descrittiva	1	1	0.8	0.5
5.8	Tecniche di correzione degli artefatti da movimento			0.5		0.5	0.5	relazione descrittiva	1	1	0.8	0.5
6. Consolle di acquisizione/comandi												
6.1	Sistema di rilevamento e di sincronizzazione dell'attività respiratoria e ECG con connessione wireless		si/no	0.5		0.5	0.5	SYNO: Se si=Pmax; no=0	SI	SI	SI	0.5
6.2	Visualizzazione in matrice 2048x2048		si/no	0.5		0.5	0.5	SYNO: Se si=Pmax; no=0	SI	SI	SI	0.5
7	Bolnice:											
7.1	Indicare la decisione di bolnice offerte e per ognuna di esse specificare: 1- numero di canali; 2- combinabili ed utilizzabili con altre bolnice, indicare quali; 3- copertura anatomica e massimo FOV utilizzabile; 4- compatibilità con tecniche di acquisizione parallele; 5- descrivere se adatta per studi avanzati: tensor, spettroscopia etc...			5.0			5.0	relazione descrittiva	0.8	0.8	1	4
9. QUALITÀ DELLE IMMAGINI												
9.1	MAMMELLA a.1			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	0.8	0.8	0.8	0.4
9.2	MAMMELLA a.2			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	0.8	0.8	0.8	0.4
9.3	PROSTATA b.1			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	0.8	0.8	0.8	0.4
9.4	PROSTATA b.2			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	0.8	0.8	0.8	0.4
9.5	PROSTATA b.3			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	0.8	1	0.8	0.4
9.6	CUORE c.1			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	1	0.8	0.8	0.5
9.7	CUORE c.2			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	1	0.8	0.8	0.5
9.8	CUORE c.3			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	1	0.8	0.8	0.5
9.9	CUORE c.4			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	1	1	0.8	0.5
9.10	ADDOME d.1			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	0.8	1	0.8	0.4
9.11	ADDOME d.2			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	0.8	1	0.8	0.4
9.12	ADDOME d.3			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	0.8	1	0.8	0.4
9.13	ADDOME d.4			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	0.8	0.8	0.8	0.4
9.14	ENCEFALO e.1			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	0.8	0.8	0.8	0.4
9.15	ENCEFALO e.2			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	0.8	0.8	0.8	0.4
9.16	ENCEFALO e.3			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	0.8	0.8	0.8	0.4
9.17	ENCEFALO e.4			0.5			0.5	le immagini devono essere calcolate in un apposito link	0.8	0.8	0.8	0.4
10. INTELLIGENZA ARTIFICIALE												
10.1	Descrizione del sistema adottato			3.0			3.0	relazione descrittiva	1	1	0.8	3
11. GARANZIA												
11.1	Garanzia "full risk" aggiuntiva rispetto ai 12 mesi richiesti nel capitolato	12	mesi	1.0		1.0	1.0	$Pi=(Vi-12)/(Vmax-12)*Pmax$	12	12	15	0
SUB TOTALE RMN				38.0	1.0	14.0	23.0				28.9165	30.9756
												32.4456

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con inversione procedimentale per la fornitura, con formula "chiavi in mano", di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" – CIG: B284EB128D - CUP: I12C23000820001.

**VERBALE GARA n. 3 del 11.09.2024
SEDUTA RISERVATA**

Il giorno 11.09.2024 alle ore 10:00, la Commissione Giudicatrice si è riunita presso la sala riunioni della U.O.C Tecnico Patrimoniale della ASL di Rieti – Blocco n. 3 ex O.P.P. sita in Via del Terminillo n. 42, Rieti.

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 712/C.S. del 18.07.2024 è stata indetta una *"Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con inversione procedimentale per la fornitura, con formula "chiavi in mano", di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 4.151.432,44 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" - CUP: I12C23000820001"*, approvandone i relativi atti di gara;
- con il predetto provvedimento è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), con i compiti di cui all'art. 15 del Codice, l'Ing. Daniele Della Vedova;
- con atto deliberativo n. 791/C.S./2024 del 07.08.2024 è stato rettificato parzialmente il Disciplinare di Gara, inserendo all'art. 24 la seguente dicitura: *"La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di una sola offerta"*;
- gli atti relativi alla procedura di gara, con Registro di Sistema n. PI133971-24, sono stati pubblicati sulla piattaforma di approvvigionamento S.TEL.LA della Regione Lazio e sul sito istituzionale di quest'Azienda, sezione *"Amministrazione trasparente"* in data 18.07.2024;
- il bando di gara è stato pubblicato su GUUE in data 22/07/2024 00:00 Numero: 438225-2024 e sulla PVL/ANAC in data 23.07.2024 09:00 Numero: 4bd6a696-1f1e-42bf-8de6-ed4306a28754 tramite la piattaforma digitale S.TEL.LA;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 23.08.2024 ore 18:00 e la data di apertura delle offerte in seduta pubblica virtuale il 02.09.2024 ore 10:30;
- con Avviso del 13.08.2024 è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle offerte fissato al 29.08.2024 ore 18:00 e della data per la prima seduta pubblica prevista per il 03.09.2024 ore 10:30;
- entro il suddetto termine sono state presentate, sulla piattaforma telematica di negoziazione *"S.TEL.LA."* della Regione Lazio, n. 3 offerte prodotte dai seguenti operatori economici:
 1. RTI Philips - GOWEN SRL - Gnode Service;
 2. RTI GE Medical Systems Italia S.p.A. - Morviducci Srl;
 3. RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - Technoproject s.r.l.

- con atto deliberativo n. 848/C.S. del 30.08.2024 sono stati nominati, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, i componenti della Commissione giudicatrice preposta all'espletamento delle operazioni di gara composta come di seguito specificato:
 - Dott. Stefano Canitano, Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini della ASL Rieti in qualità di Presidente;
 - Dott. Andrea Leonardi, Dirigente medico della U.O.C. Diagnostica per Immagini della ASL Rieti in qualità di componente;
 - Dott. Marco Savi, T.S.R.M. in servizio presso la U.O.C. Diagnostica per Immagini della ASL Rieti in qualità di componente;
 - Ing. Marco Risa, Collaboratore Tecnico in servizio presso la U.O.S.D. Ingegneria Clinica della ASL Rieti in qualità di componente;
 - Ing. Francesco Prestanicola, Direttore f.f. della U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti Territorio della ASL Roma 2 in qualità di componente;
 - Dott.ssa Laura Marroni, Collaboratore Amministrativo in servizio presso la U.O.C. Tecnico Patrimoniale – ASL Rieti (Segretario verbalizzante senza diritto di voto);
- con nota prot. n. 61215 del 02.09.2024, il RUP ha proceduto a convocare la Commissione Giudicatrice per il giorno 03.09.2024 ore 10:30;
- in data 03.09.2024, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica virtuale per l'apertura e la verifica del contenuto dell'offerta tecnica prodotta dagli operatori economici; in prosecuzione di seduta, la Commissione giudicatrice ha proceduto in seduta riservata alla disamina ed alla valutazione delle offerte di ciascun partecipante – giusto Verbale di Gara n. 1 del 03.09.2024;
- in data 06.09.2024, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per continuare con la disamina delle offerte e la valutazione di ciascun partecipante – giusto Verbale di Gara n. 2 del 06.09.2024;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti, la Commissione al completo da inizio ai lavori in seduta riservata per procedere con i lavori relativi alla valutazione tecnica dell'offerta ed alla conseguente attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 18 del Disciplinare di Gara e redigendo contestualmente la scheda di valutazione dei concorrenti.

Il Presidente della Commissione

procede all'inserimento, sulla piattaforma "S.TEL.LA.", dei punteggi tecnici attribuiti agli OO.EE. partecipanti.

Preso atto che nessuno degli operatori economici ha ottenuto un punteggio tecnico pari a quello massimo attribuibile (90 punti), la Commissione procede, tramite piattaforma, alla riparametrizzazione dei punteggi Pt* indicati nella seguente tabella:

ID	Ragione Sociale	Punteggio tecnico	Punteggio riparametrato
		Pt	Pt*
1	RTI Philips - GOWEN SRL - Gnode Service	68,2388	80,7469
2	RTI GE Medical Systems Italia S.p.A. - Morviducci Srl	71,5287	84,6399
3	RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - Technoporject s.r.l.	76,0585	90,0000


Terminata la fase tecnica ed inseriti i punteggi tecnici attribuiti a ciascun concorrente sulla piattaforma telematica S.TEL.LA., la Commissione, in seduta pubblica virtuale procederà

all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi a tale fase di gara ed alla successiva valutazione delle stesse.


Il Presidente chiude la seduta riservata alle ore 10:30.

Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto dalla Commissione giudicatrice e dal segretario come segue:


Presidente Dott. Stefano Canitano

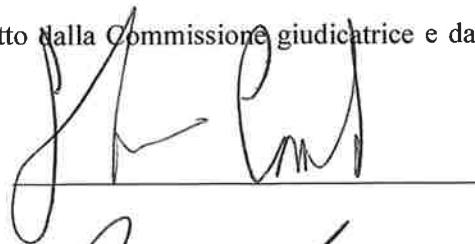


Componente Dott. Andrea Leonardi

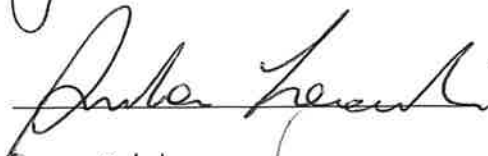


Componente Dott. Marco Savi

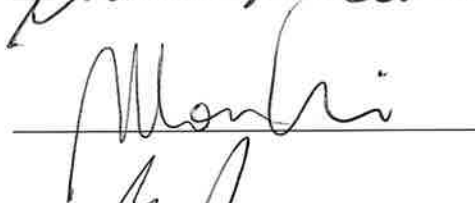

Componente Ing. Marco Risa

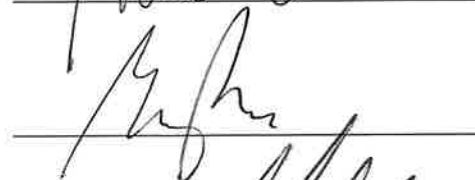

Componente Ing. Francesco Prestanicola

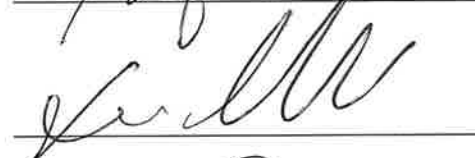

Segretario verbalizzante Dott.ssa Laura Marroni

