

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577**

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3, DEL CODICE, VOLTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE DESTINATI ALLA U.O.C CHIRURGIA VASCOLARE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI. Numero gara: 9354604

**VERBALE COMMISSIONE
(seduta riservata)**

Il giorno **04 luglio 2024 alle ore 14:00**, si riunisce, presso la UOC ALBS dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, in seduta riservata, la Commissione di gara per esaminare nuovamente la documentazione tecnica presentata dai concorrenti in gara per il lotto 30, a seguito delle note pervenute dal RUP (nota prot. n. 43706/2024 del 17/06/2024 e nota prot. 46762/2024 del 28/06/2024) e dell'istanza di annullamento in autotutela presentata in data 28/06/2024 dalla ditta GADA ITALIA S.P.A., risultata II classificata nel lotto in questione.


È presente la Dott.ssa Elena Cammarata, con i compiti di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, collegata da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams. Partecipa a distanza anche il Dott. Massimo Ruggeri, collegato sempre attraverso la medesima piattaforma Microsoft Teams.

La Commissione procede con la lettura dell'istanza di annullamento ove la ditta GADA ITALIA rileva che l'offerta presentata per il lotto 30 dall'aggiudicataria Tecnostim Srl sarebbe *“non congrua e/o non corrispondente alle richieste minime del Capitolato di Gara (All. 2.1)”*. In particolare, ad avviso di tale operatore economico, l'offerta della Tecnostim non risulterebbe totalmente aderente alle richieste di minima prescritte in gara in quanto i prodotti offerti dall'aggiudicataria non presenterebbero tutta la serie di misure richieste nell'allegato 2.1 del Capitolato speciale per le GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE di cui al suddetto lotto.

La Commissione di seguito riesamina le offerte tecniche presentate dai suddetti operatori per il lotto 30. Rispetto ai prodotti presentati dalla Tecnostim nel lotto in questione, rileva che, in effetti, come osservato dalla II aggiudicataria, gli stessi non rispondono del tutto alle caratteristiche di minima previste dalla *lex specialis* in quanto carenti rispetto ad una serie di requisiti legati, in particolare, alle misure richieste per i dispositivi medici di che trattasi.

In particolare, l'allegato 2.1 su citato, prescrive che le Guide idrofile richieste siano:

- nel sub lotto A. *«Angolate e dritte, tipo standard, 750 1500 60 45.000,00 90.000,00 diametri 0.018”, 0,025”, 0,032”, 0,035” e 0.038”, lunghezze 50, 80,120,150,180 cm punta flessibile da 1,3,5,8 cm»*, tuttavia, la Tecnostim non offre le guide di lunghezza 50 cm e 120 cm e con punta flessibile 1,5 e 8 cm;
- nel sub lotto E. *«Extra rigida in nitinol con rivestimento esterno prossimale spiralato in PTFE e porzione distale idrofilica di 25 cm. Diametri da 50 100 180 9.000,00 18.000,00 0.14 /0.018/0.035 lunghezze 180 ,260 e 300»*, ma nell'offerta non risultano presenti: la parte distale

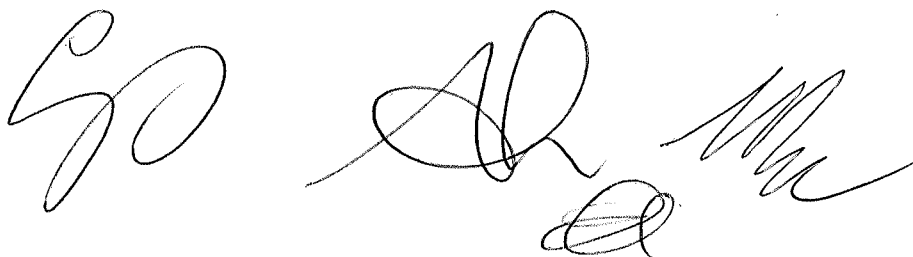

idrofilica da 25 cm, il diametro da 0014 e la lunghezza da 300 cm;

- nel sub lotto F. «Microguida con anima metallica super elastica in lega nikel /titanio con rivestimento poliuretano e trattamento esterno con polimero idrofilo; corpo unico senza saldature 50 100 430 21.500,00 43.000,00 marcatura interna con tungsteno; marker ad anello/spirale da 2 cm in oro incorporato nella punta; diametri da 0,010-0,012 e 0,016 in lunghezze da 200cm. Con punta flessibile, dritta o precurvata da 8,12 o 25 cm. Con angolazione da 45°/70°/90° e 90°+150°(doppio angolo», tuttavia, la guida offerta dalla Tecnostim non risulta in Nichel bensì in acciaio inox e dalla scheda tecnica risulta un materiale utilizzato per la saldatura quando invece viene chiesta una guida a corpo unico senza saldature.

Alla luce di quanto sopra, i prodotti offerti pertanto non risultano idonei in quanto non rispondenti alle caratteristiche di minima prescritte in gara. La Commissione, dunque, confermate per il resto le valutazioni espresse nelle precedenti sedute rispetto al lotto 30, ritiene necessario proporre al RUP l'esclusione della Tecnostim dal suddetto lotto, con revoca dell'aggiudicazione limitatamente a questo lotto, proponendo di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta GADA ITALIA S.P.A., II classificata.

L.C.S.

Il Presidente, Dott.ssa Giulia Pizzardi

Il Componente, Dott. Massimo Ruggeri

Il Componente, Dott. Andrea Cuoghi

Il segretario verbalizzante, Dott.ssa Elena Cammarata

