

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. AQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 144 del 28-02-2019

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Tecnosalus Elettromedicali SRL della fornitura e posa in opera di una lampada scialitica da destinare all' ambulatorio urologico del P.O. di Rieti. Importo complessivo pari ad € 2.964,60 IVA 22% inclusa. **CIG:** ZA82748FC5

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Estensore

Dott. Scossa Cristian

Firma

Data

29-02-2019

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma

Data

29-02-2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

PATRIMONIO

101020501 - AUT. 29.4/2019

PROVV. 77

Data

25/02/2019

Firma

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Tecnosalus Elettromedicali SRL della fornitura e posa in opera di una lampada scialitica da destinare all' ambulatorio urologico del P.O. di Rieti. Importo complessivo pari ad € 2.964,60 IVA 22% inclusa. **CIG:** ZA82748FC5

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- presso l' ambulatorio Urologico, sito al sesto piano del P.O. di Rieti e facente capo alla UOC Urologia della ASL di Rieti, era in uso lampada scialitica apollo codice inventario 50001 e matricola 4607 la quale è stata dismessa come da nota protocollo 1943 del 14.01.2019 (All. 1);
- il Dott. De Carli, in qualità di primario della U.O.C. di Urologia del P. O. San Camillo De Lellis di Rieti, ha inoltrata richiesta per una lampada scialitica in sostituzione di quella dismessa e, quindi, da destinare all' ambulatorio urologico di cui è direttore (All. n. 2);

TENUTO CONTO che con atto deliberativo n. 1537/D.G. del 22.12.2016 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di staff "Ingegneria Clinica" che comprende il ruolo di D.E.C dei contratti attivi ed da attivare relativi alla fornitura, la gestione e la manutenzione delle tecnologie biomediche aziendali, nonché di supporto alla UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ai fini dell'espletamento delle relative procedure di gara e stipula dei contratti;

VISTO che quest'Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature congiuntamente all' aggiornamento del proprio parco elettromedicale ai fini di un corretta risposta diagnostico – terapeutica nei confronti dell' utenza;

PRESO ATTO delle procedure di acquisto e riparazione riportate in delibera D.G. 339 del 24/04/2018;

VISTI:

- il preventivo (All. n 3) inviato dalla società Tecnosalus Elettromedicali SRL per la fornitura in oggetto che ammonta ad € 2.964,60 IVA 22% inclusa;
- il preventivo (All. n 4) inviato dalla società Getinge Italia SRL per la fornitura in oggetto che ammonta ad € 5.686,42 IVA 22% inclusa;
- il preventivo (All. n 5) inviato dalla società Althea Italia SPA per la fornitura in oggetto che ammonta ad € 3.965,00 IVA 22% inclusa;

VISTA la nota protocollo 7498 del 11/02/2019 (All. n 4) trasmessa dall' Ingegneria clinica alla UOC ALBS con la quale si trasmette la documentazione necessaria alla redazione degli atti amministrativi;



Oggetto: Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Tecnosalus Elettromedicali SRL della fornitura e posa in opera di una lampada scialitica da destinare all' ambulatorio urologico del P.O. di Rieti. Importo complessivo pari ad € 2.964,60 IVA 22% inclusa. **CIG:** ZA82748FC5

Pag. 3 di 4

PRESO ATTO che quest'Azienda al fine di garantire il normale svolgimento delle attività diagnostiche e terapeutiche, ha affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla società Tecnosalus Elettromedicali SRL della fornitura e posa in opera di una lampada scialitica da destinare all' ambulatorio urologico del P.O. di Rieti;

DATO ATTO che il RUP ha ritenuto economicamente vantaggioso il preventivo della società Tecnosalus Elettromedicali SRL;

DATO ATTO che l'acquisto di tali dispositivi e servizi, di cui alla presente determina, viene effettuato con risorse di parte corrente;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;


D E T E R M I N A

1. **DI PROCEDERE** all' affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Tecnosalus Elettromedicali SRL della fornitura e posa in opera di una lampada scialitica da destinare all' ambulatorio urologico del P.O. di Rieti. Importo complessivo pari ad € 2.964,60 IVA 22% inclusa.;
2. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari ad € 2.964,60 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 101020501 – attrezzature sanitarie e scientifiche – bilancio anno 2019;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Direttore della U.O.C.
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Dott. Luciano Quattrini

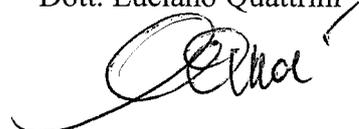

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 28 FEB. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 28 FEB. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 28 FEB. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 28 FEB. 2019

IL FUNZIONARIO





AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Servizio di Ingegneria Clinica

Prot. 1943

Rieti, 14/01/2019

ALLEGATO N. 1 DI 6
PAGINA N. 1 DI 1

UOC Tecnico Patrimoniale
P. I. Domenico Di Giuliani

e p/c Responsabile UOC Tecnico Patrimoniale
Ing. Roberto Campogiani

Oggetto: **dismissione apparecchiature fuori uso**

In riferimento all'oggetto, si comunica che lo scrivente Servizio ha dato seguito alla procedura di fuori uso dell'apparecchiatura elettromedicale sotto indicata, in giacenza presso il reparto di Urologia 6° piano dell'Ospedale di Rieti.

Prima del ritiro dell'apparecchiatura di cui trattasi, si prega di contattare il Caposala sig. Berardo al n. tel. 0746/278335.

CODICE INV.	MATRICOLA	MODELLO	DESCRIZIONE
50001	4607	STAR FIRE	LAMPADA SCIALITICA APOLLO

Distinti saluti.

Assistente al D.L.C. P. I. Giuseppe Chiani

Il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica
Ing. Erminio Pace

MODULO PER LA RICHIESTA DI ACQUISTO O SOSTITUZIONE DI UNA TECNOLOGIA O APPARECCHIATURA ELETTRONICA IN EMERGENZA

N° di Prot.

Data: 7/1/19

Il presente modulo va compilato dal Direttore/Dirigente della UO richiedente o dal Direttore di Dipartimento/P.O./Distretto

Struttura UOC UROLOGIA	Unità Operativa OSPLE RIETI
Richiedente De Carli	Telefono / Fax 0746 -

1. TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA/TECNOLOGIA RICHIESTA

1.1 Denominazione scientifica:

SCALITICA CON LAMPADINE REGOLABILI
PER PROCEDURE CHIRURGICHE AMBULATORIALI
LAMPADA IN DOTAZIONE FUORI-USO

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

2.1 Specifiche tecniche minime:

10'000 LUX

2.2 Specifiche tecniche delle attrezzature a supporto/completamento dell'apparecchiatura richiesta.
(Indicare in questo spazio le caratteristiche tecniche di eventuali accessori e/o di hardware/software.)

CARRELLO

2.3 Integrazione/collegamento con altra strumentazione o sistemi informatici.

(Specificare l'eventuale infungibilità dell'apparecchio rispetto a strumenti già installati e/o a sistemi esistenti.)

A.U.S.L. RIETI
Dott. Piero De Carli
44010/001/3/0605

De

ALLEGATO N. 2 DI 6
 PAGINA N. 2 DI 4

3. CARICO DI LAVORO (solo nel caso di sostituzione)

3.1 Storico delle prestazioni effettuate

Codice	Descrizione	Periodo (mm/aa)	Ore attività settimanali	N° prestaz. Interne rese in un anno	N° prestaz. Esterne rese in un anno

3.2 Prestazioni previste

Codice	Descrizione	Periodo (mm/aa)	Ore attività settimanali	N° prestaz. Interne rese in un anno	N° prestaz. Esterne rese in un anno

3.3 Lista d'attesa

N° giorni di attesa per prestazione: _____

3.4 Eventuale riutilizzo in azienda dell'apparecchiatura guasta o obsoleta

No Si Nuova Destinazione: _____

A.U.S.L. RIETI
 P.zza Dr. Carli
 01100/005

4. MOTIVAZIONI DELLA

4.1 Sostituzione 4.2 Integrazione/Completamento 4.3 Nuova

4.4 Specificare e descrivere le motivazioni dell'urgenza della richiesta:

FUORI USO VECCHIA LAMPADA SCIALITICA

5. MODALITÀ PROPOSTA PER L'ACQUISIZIONE

5.1 Acquisto 5.2 Service/Comodato 5.3 Noleggio/Locazione/Leasing

5.4 Sperimentazione, ricerca, didattica 5.5 Donazione

5.6 Altro (specificare) _____

6. DATI APPARECCHIO DA SOSTITUIRE (Compilare solo in caso di sostituzione)

6.1 Marca APOLLO 6.2 Modello STAR FIRE

6.3 Numero di serie 4607 6.4 Numero di inventario 50002

6.5 Motivazione (allegare eventuale richiesta di fuori uso): Fuori uso

7. MIGLIORAMENTI TECNICO/FUNZIONALI OTTENIBILI CON L'APPARECCHIATURA RICHIESTA

7.1 Benefici all'utenza

7.2 Benefici per gli utilizzatori

7.3 Benefici per l'Azienda

A. U. S. I. PIETI
Dott. Filippo De Carli
Tel. 049801200805

ALLEGATO N. 2 DI 6
 PAGINA N. 4 DI 4

8. SPECIFICHE PER LA MESSA IN FUNZIONE DELL'APPARECCHIATURA RICHIESTA

8.1 Ubicazione dell'apparecchiatura

AMBULATORIO UROLOGICO 6° PIANO

8.2 Sono necessari lavori di adeguamento/ristrutturazione dei locali? SI NO

NO

8.3 Sono previsti collegamenti con altre UU.OO. per l'utilizzo della nuova apparecchiatura? SI NO

NO

In caso affermativo, specificare quali UU.OO. : _____

- quali collegamenti: _____

- le professionalità coinvolte: _____

Il Direttore UO richiedente

Data: 14/1/19

Nome e Cognome: PIERO DE CARLI
 in stampatello

Firma: *Piero De Carli*


Autorizzazione della Direzione Generale

Data: ___/___/___

Nome e Cognome: _____
 in stampatello

Si autorizza
 Timbro e Firma: _____

[Handwritten signature]



TECNOSALUS ELETTROMEDICALI

ALLEGATO N. 3 DI 6
PAGINA N. 1 DI 2

Spett.le

AZIENDA USL RIETI
VIA DEL TERMINILLO, 42
02100 RIETI (RI)

RIFERIMENTO: RICHIESTA EMAIL ING. RISA

Preventivo

Protocollo N° P P00027/19 del 22/01/2019
Commessa N° COM2081 del 22/01/2019

Di seguito il nostro preventivo per:

Codice	Descrizione Articolo	Q.ta	Importo	Subtotale	Iva
PENTALED 12	LAMPADA SCIALITICA PENTALED 12 - PIANTANA N 100.000 LUX	1,0	2.430,00	2.430,00	22

TOTALE PREVENTIVO €: 2.430,00
(iva esclusa)

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Pagamento: NEI TERMINI DI LEGGE
Validità: 28/02/2019
IVA: Vs. carico
Tempi di Consegna: 30 gg.
Trasporto: incluso
Montaggio: incluso
Garanzia: 12 mesi
Collaudo: incluso
Training del Personale:
Altre condizioni:

Cordiali saluti.

TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL
ing. Federico Velluto

PentaLED 12



ALLEGATO N. 3 DI 6
 PAGINA N. 2 DI 2

PENTALED 12 100.000 Lux @ 1 m

PENTALED 12 impiega il principio fisico della riflessione e della luce indiretta.

Dodici riflettori ellittici riflettono i raggi luminosi emessi dai Leds sull'area da illuminare, ottenendo così un'intensità luminosa di oltre 100.000 Lux ad 1 metro di distanza.

La luce indiretta ha i vantaggi di:

- non abbagliare
- non affaticare la vista favorendo la concentrazione
- sopprimere le ombre


Are di applicazione

	28	12
Sala preparatoria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terapia intensiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ambulatori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dermatologia	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Chirurgia plastica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pronto soccorso	<input checked="" type="checkbox"/>	-

consigliata alternativa

Prestazioni

	28	12
Intensità luminosa a 1 m di distanza (Ec)	120.000 Lux	100.000 Lux
Temperatura di colore	4500/5000 °K	4500 °K
Indice di resa cromatica (CRI)	94	96
Diametro campo luminoso	110-330 mm	160 mm
Profondità di illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60%	88 cm	77 cm
Profondità di illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 20%	155cm	150cm
Rapporto fra l'energia irradiata Ee e l'illuminazione Ec	1,60 mW/m ² ·lx	3,66 mW/m ² ·lx
Energia totale irradiata Ee quando l'illuminazione raggiunge livello massimo	231 W/m ²	366 W/m ²
Assorbimento elettrico	57 VA	35 VA
Durata leds	> 60.000 ore	> 60.000 ore
Controllo intensità luminosa	20-100%	50-100%

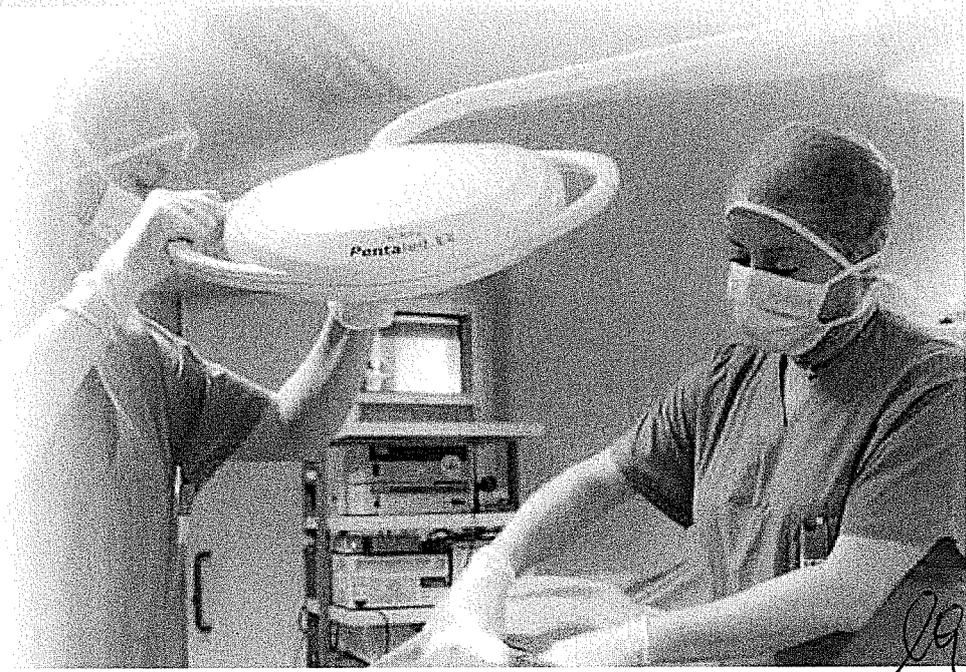

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Via del Terminillo, 42
02100 RIETI

ALLEGATO N. 4 DI 6
PAGINA N. 1 DI 3

Oggetto : PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA DI DUE GRUPPI DI LAMPADE SCIALITICHE

La società Getinge Italia S.r.l. società con socio unico con sede in Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), capitale sociale euro 1.020.000 interamente versato, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano 03992220966, in persona del sottoscritto suo rappresentante propone la seguente fornitura:

N. 1 LAMPADE SCIALITICHE

Lampada scialitica Modello Lucea 100 Mobile codice: LCA 100 Mobile

Prezzo Unitario € 4.661,00

Il prezzo complessivo offerto comprende gli oneri della sicurezza relativi all'attività d'impresa della Scrivente Getinge Italia S.r.l. nella misura del 1% (pari a € 46,61)

Società a socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di GETINGE AB. Capitale sociale: Euro 1.020.000
Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 03992220966.

Getinge Italia S.r.l.
Via Gozzano, 14
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 611135.1
Fax +39 02 611135.260

Tel. +39 02 611135.220
stefania.magni@getinge.com

www.getinge.com



Page 1 of 3

ALLEGATO N. 4 DI 6
PAGINA N. 1 DI 3

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA:

- **RESA:** franco destino.
- **IMBALLO e TRASPORTO:** compresi.
- **SMONTAGGIO, MONTAGGIO E COLLAUDO:** compresi.
 - L'installazione consiste nell'allaccio ai punti di consegna impiantistici già predisposti dalla Committente; restano quindi a carico del Committente le eventuali opere accessorie necessarie al montaggio delle apparecchiature proposte:
 - la verifica delle portate dei soffitti/pareti ed eventuali opere di rinforzo degli stessi ove necessari
 - fissaggio dei sistemi di ancoraggio a soffitto
 - predisposizione delle linee elettriche necessarie e relative canaline dal quadro elettrico alle singole utenze, come da Norma C.E.I. 64-8
 - predisposizione delle tubazioni gas medicali all'attacco delle flange di ancoraggio, come da Norma UNI 9507 e saldature delle tubazioni stesse;
 - la fornitura dei quadri elettrici di alimentazione delle apparecchiature.
- **PAGAMENTO:** 60 giorni dalla data di ricezione della fattura. La fattura verrà emessa al collaudo.
- **INTERESSI DI MORA:** sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi così come previsto dal D.L.vo 231/2002, senza che per questo il Committente possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.
- **GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO "FULL RISK":** il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data del collaudo con esclusione del materiale di consumo e delle parti soggette in genere ad usura.
- **CONSEGNA:** 45 giorni data ricevimento ordine
- **I.V.A.:** tutti i prezzi esposti sono da considerarsi al netto dell'IVA, come per legge a carico del




ALLEGATO N.4..... DI6.....
PAGINA N.....3..... DI3.....

committente, ad oggi nella misura del 22%

- **VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA:** 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la sua presentazione

Distinti saluti

Cinisello Balsamo, 30.01.2019

Getinge Italia S.r.l.
Paolo Mario Malcerini
Procuratore 





ALTHEA

INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

ALLEGATO N. 5 DI 6
PAGINA N. 1 DI 1

Spett.le
AZIENDA USL RIETI
VIA DEL TERMINILLO,42
02100, RIETI (RI)

Protocollo: **PRV/2019/041213**

Data Offerta: 01/02/2019

Scadenza: 31/03/2019

Oggetto: Offerta per la fornitura di n° 1 Lampada Scialitica Portatile

In riferimento alla vostra gradita richiesta, siamo con la presente a rimmettervi la nostra miglior offerta economica per la fornitura di seguito descritta:

OFFERTE

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario (IVA esclusa)
Fornitura Lampada Scialitica Portatile LED 100.000Lux	1	€ 3250,00

TOTALE: € 3250,00

IVA: secondo la normativa vigente (esclusa da precedente offerta)

Garanzia: 12 mesi

Esecuzione lavori: 40 gg dalla data di ricevimento ordine

Cordiali saluti

Althea Italia S.p.A.

Responsabile di commessa:

Ing. Alessandro Fortuna

Sede Legale ed
Uffici Amministrativi
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
T +39 06 66100411
F +39 06 66100449

Sede Operativa MILANO
Via Papa Giovanni XXIII, 43
Località Millepini
20090 Rodano (MI)
T +39 02 976791
F +39 02 97679249

Sede Operativa TORINO
Corso Turati, 23
10128 Torino
T +39 011 595046
F +39 011 5096406



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Servizio di Ingegneria Clinica

CRISTIAN
DB

Prot. 7498

Rieti, 11/02/2019

ALLEGATO N. 6 DI 6
PAGINA N. 1 DI 1

Dirigente UOC A.B.S.

Dott. Luciano Quattrini

e p/c Responsabile UOC Urologia

Dott. Piero De Carli

Oggetto: acquisto lampada scialitica da destinare alla UOC Urologia del PO di Rieti a seguito di fuori uso - URGENTE

Facendo seguito alla richiesta del Dott. De Carli per l'acquisto di quanto riportato in oggetto, in allegato alla presente si trasmette:

1. copia della richiesta di fuori uso della lampada scialitica, utilizzata presso gli ambulatori della UOC Urologia;
2. copia della richiesta del Dott. De Carli;
3. copia del preventivo inviato dalla Società Tecnosalus;
4. copia del preventivo inviato dalla Società Althea;
5. copia del preventivo inviato dalla Società Getinge - Maquet.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica
Ing. Erminio Pasetti

Coll. Tecnico Ing. Marco Risa

DB