

Milano, 30.01.2024

Ns. rif. SO 5240024714 MS/sm

Spett.le

POLIEDRA  
VIA DEL TRITONE, 102  
00187 ROMA


**C/O PO RIETI**

**OGGETTO: Riparazione Video Gastroscopio Pentax mod. EG16-K10 matr. N120207**  
(Vs Rif N.106 del 15/12/23)

La presente per informarVi che, dopo un'attenta analisi presso il nostro laboratorio sullo strumento in oggetto abbiamo riscontrato quanto segue:

- **Schiacciatura Tubo Inserzione**
- **Fascio Fibre Luce compromesso**
- **Immagine assente**



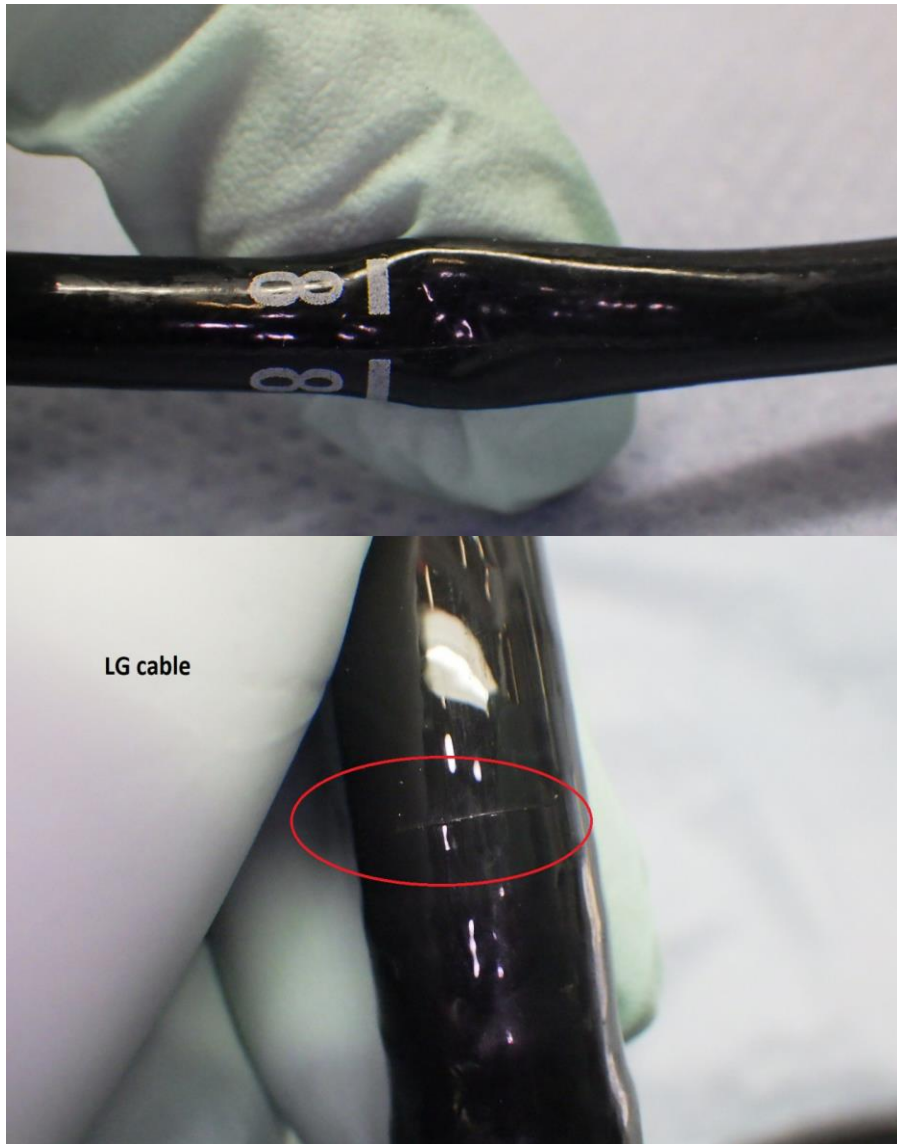

Vi informiamo che lo strumento sopra riportato necessita non un normale ripristino, ma di una rigenerazione completa, che non ne garantirebbe la corretta funzionalità in futuro.

Visto quanto sopra vi suggeriamo di avviare le pratiche per il **fuori uso**.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più distinti saluti.

PENTAX Italia S.r.l.  
Con Unico Socio  
Massimiliano Sangregorio  
Service Sales Manager