

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it**  
**C.F. e P.I. 00821180577**

Procedura negoziata a mezzo RDO sul MELA (STELLA) - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2023 - per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia urologica da destinare alla U.O.C. Urologia del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 212.235,90 al netto dell'IVA. Numero gara 9398089.

**VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE n. 1**

Il giorno 13 febbraio 2024, alle ore 12:08 presso l'U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti

**PREMESSO CHE**

- con atto determinativo n. 1318 del 21/11/2023 è stata indetta – ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2023 – una “Procedura negoziata a mezzo RDO sul MELA (STELLA) per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia urologica da destinare alla U.O.C. Urologia del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 212.235,90 al netto dell'IVA. Numero gara 9398089”, approvandone i relativi atti di gara;
- gli atti relativi alla procedura sono stati pubblicati sul MELA (RDO registro di sistema n. PI152290-23);
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 29/12/2023 ore 12:00;
- entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta n. 5 Operatori Economici, agli atti del Fasciolo telematico del STELLA., come da seguente prospetto:

| Ragione Sociale      | Partita IVA   | Lotti Offeriti                   | Registro di Sistema | Data ricezione         |
|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| OLYMPUS ITALIA SRL   | IT10994940152 | 8,9,12,13,14,22                  | PI165815-23         | 18/12/2023<br>12:43:43 |
| TELEFLEX MEDICAL SRL | IT02804530968 | 1,2,3,4,5,8,9,12,13,17           | PI168034-23         | 20/12/2023<br>12:41:46 |
| SP MED SRL           | IT05626031008 | 1,2                              | PI168301-23         | 20/12/2023<br>16:54:41 |
| Coloplast            | IT00691781207 | 1,2,3,4,8,9,10,12,13,14,17,18,19 | PI170073-23         | 27/12/2023<br>13:35:53 |
| ESSEDUE GROUP        | IT10135671005 | 4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20 | PI170530-23         | 28/12/2023<br>18:51:35 |

- con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 17/01/2024 è stato nominato il Seggio di Gara per l'esame della documentazione amministrativa come di seguito riportato:

- Dott. Matteo Palmieri Collaboratore amministrativo ASL Rieti Presidente/RUP
- Sig. Luca Persico, Assistente Amministrativo ASL Rieti Testimone
- Dott.ssa Barbara Barattelli, Collaboratore Amministrativo ASL Rieti Testimone Verbalizzante

- con atto Deliberativo n. 107/CS del 06/02/2024 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, per l'esame della documentazione tecnica ed economica, come di seguito riportato:

- Dr. Maurizio Ombres, Dirigente Medico, in servizio presso la UOC Urologia della ASL di Rieti, in qualità di Presidente;
- Dr. Mario Ciletti, Dirigente Medico, in servizio presso la UOC Urologia della ASL di Rieti, in qualità di Componente;
- Dr. Simone Pagliarino, Dirigente Farmacista, in servizio presso la UOC Politiche del Farmaco, e dei Dispositivi Medici della Asl di Rieti, in qualità di Componente;

### IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti, constatata la presenza di tutti i componenti, da inizio ai lavori in seduta pubblica virtuale per procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei partecipanti ai vari lotti di gara.

La Commissione, preso atto dell'oggetto dell'appalto di cui trattasi e degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, come risultanti dal report scaricato dalla piattaforma telematica, in sede di accettazione dell'incarico dichiarano, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di inconfirabilità (art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001), di conflitto di interesse (art. 42 Cod. dei Contratti) e di astensione (art. 51 Cod. Proc. Civ.), come risulta dalle dichiarazioni agli atti del procedimento.

La Commissione, constatata l'assenza del segretario verbalizzante, stabilisce di attribuire tale funzione al Dr. Simone Pagliarino.

Successivamente la Commissione effettua per i lotti per i quali è prevista l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ovvero i lotti nn. 3, 4 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17.e 22, l'apertura delle buste ed estrazione dei documenti contenuti all'interno delle offerte tecniche prodotte dagli OO.EE. sotto riportati.

| Lotto | DESCRIZIONE LOTTO  | Ragione Sociale      | Registro di Sistema Offerta | CIG        |
|-------|--|----------------------|-----------------------------|------------|
| 3     | CATETERI DUFOUR 3 VIE  | TELEFLEX MEDICAL SRL | PI168034-23                 | A0237A71DB |
| 3     | CATETERI DUFOUR 3 VIE  | Coloplast            | PI170073-23                 | A0237A71DB |
| 4     | CATETERE URETERALE TIPO POLLACK PUNTA APERTA   | TELEFLEX MEDICAL SRL | PI168034-23                 | A0237B3BBF |
| 4     | CATETERE URETERALE TIPO POLLACK PUNTA APERTA   | Coloplast            | PI170073-23                 | A0237B3BBF |
| 4     | CATETERE URETERALE TIPO POLLACK PUNTA APERTA   | ESSEDUE GROUP        | PI170530-23                 | A0237B3BBF |
| 5     | CATETERE TUTORE, PER URETEROCUTANEOSTOMIA, IN POLIURETANO TRASPARENTE                | TELEFLEX MEDICAL SRL | PI168034-23                 | A0237BB25C |
| 7     | CATETERE A PALLONCINO PER IL TRATTAMENTO STENOSI URETRALI RICORRENTI TIPO "OPTILUME" | Deserta              |                             | A0238977E7 |
| 8     | STENT URETERALE 1J PER NEFROSTOMIA   | OLYMPUS ITALIA SRL   | PI165815-23                 | A0238B617E |
| 8     | STENT URETERALE 1J PER NEFROSTOMIA   | TELEFLEX MEDICAL SRL | PI168034-23                 | A0238B617E |
| 8     | STENT URETERALE 1J PER NEFROSTOMIA   | Coloplast            | PI170073-23                 | A0238B617E |
| 8     | STENT URETERALE 1J PER NEFROSTOMIA   | ESSEDUE GROUP        | PI170530-23                 | A0238B617E |
| 9     | STENT 2J IDROFILICO LUNGA PERMANENZA   | OLYMPUS ITALIA SRL   | PI165815-23                 | A0238C3C35 |
| 9     | STENT 2J IDROFILICO LUNGA PERMANENZA   | TELEFLEX MEDICAL SRL | PI168034-23                 | A0238C3C35 |
| 9     | STENT 2J IDROFILICO LUNGA PERMANENZA   | Coloplast            | PI170073-23                 | A0238C3C35 |
| 9     | STENT 2J IDROFILICO LUNGA PERMANENZA   | ESSEDUE GROUP        | PI170530-23                 | A0238C3C35 |


|    |  |                      |             |            |
|----|--|----------------------|-------------|------------|
| 10 | STENT URETERALI A DOPPI J TUMOR STENT  | Coloplast            | PI170073-23 | A0238CA1FF |
| 10 | STENT URETERALI A DOPPI J TUMOR STENT  | ESSEDUE GROUP        | PI170530-23 | A0238CA1FF |
| 11 | STENT URETERALE A DOPPIA DUROMETRIA TIPO "POLARIS LOOP"                                      | ESSEDUE GROUP        | PI170530-23 | A0238D7CB6 |
| 17 | SET PUNZIONE NEFROSTOMIA PERCUTANEA TECNICA "A DUE PASSI"                                    | TELEFLEX MEDICAL SRL | PI168034-23 | A0239041DC |
| 17 | SET PUNZIONE NEFROSTOMIA PERCUTANEA TECNICA "A DUE PASSI"                                    | Coloplast            | PI170073-23 | A0239041DC |
| 17 | SET PUNZIONE NEFROSTOMIA PERCUTANEA TECNICA "A DUE PASSI"                                    | ESSEDUE GROUP        | PI170530-23 | A0239041DC |
| 22 | GUAINA DI ACCESSO URETERALE PER PROCEDURE D'URETEROSCOPIA FLESSIBILE 10/12 12/14 DOPPIO LUME | OLYMPUS ITALIA SRL   | PI165815-23 | A023925D14 |

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica virtuale per procedere con i lavori, senza soluzione di continuità, in seduta riservata.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Seggio di Gara nel modo che segue:


Presidente

Dr. Maurizio Ombres

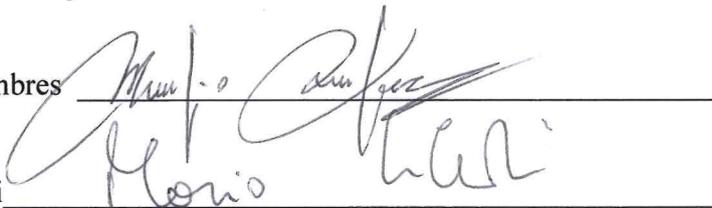


Componente

Dr. Mario Ciletti



Componente con funzione di verbalizzante

Dr. Simone Pagliarino

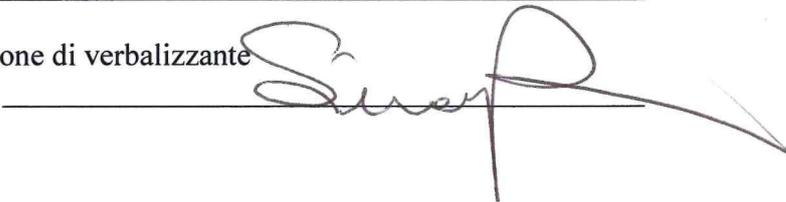

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

Procedura negoziata a mezzo RDO sul MELA (STELLA) - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2023 - per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia urologica da destinare alla U.O.C. Urologia del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 212.235,90 al netto dell'IVA. Numero gara 9398089.

## VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE n. 2

### IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il giorno 13 febbraio 2024, alle ore 14:01 presso l'U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, constatata la presenza di tutti i componenti, da inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione, constatata l'assenza del segretario verbalizzante, stabilisce di attribuire tale funzione al Dr. Simone Pagliarino.

Il Presidente della Commissione prende atto che l'art.12.1.1 del Disciplinare di Gara prevede che <<Per i lotti nn.1, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21 l'appalto sarà aggiudicato, per singolo lotto, in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'artt. 50, comma 4, e 108, comma 3, del Codice, previa verifica della loro rispondenza alle specifiche tecniche indicate nel CSA e nel relativo All.1 "Elenco prodotti in gara". Tale verifica sarà condotta nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice, ove previsto, dalla Commissione giudicatrice servendosi anche della campionatura>>.

La Commissione da atto che con nota del 15/02/2024, il RUP ha proceduto ad inviare le schede tecniche relative ai lotti per i quali è prevista l'aggiudicazione al prezzo più basso (lotti nn.1, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21).

In base a quanto sopra, la Commissione stabilisce di iniziare i propri lavori con i lotti da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, procedendo, pertanto, con la verifica sia della documentazione inviata dal RUP sia della campionatura rimessa dagli OO.EE. per i suddetti lotti.

Le risultanze di quanto sopra sono riportate nel seguente prospetto.

| LOTTI | DESCRIZIONE PRODOTTI  | DITTA                | CONFORME / NON CONFORME ALLE CARATTERISTICHE MINIMALI DI GARA | MOTIVAZIONE   |
|-------|---|----------------------|---|---|
| 1     | CATETERE FOLEY ADULTI IN SILICONE   | TELEFLEX MEDICAL SRL | CONFORME  |   |
|       |   | SP MED SRL           | CONFORME  |   |
|       |   | Coloplast            | CONFORME  |   |
| 2     | CATETERE FOLEY PEDIATRICO IN SILICONE   | TELEFLEX MEDICAL SRL | CONFORME  |   |
|       |   | SP MED SRL           | CONFORME  |   |
|       |   | Coloplast            | CONFORME  |   |
| 12    | FILO GUIDA RIGIDO PER LITOTRISSIA PERCUTANEA  | OLYMPUS ITALIA SRL   | CONFORME  |   |
|       |   | TELEFLEX MEDICAL SRL | NON CONFORME  | la lunghezza è inferiore a 145 cm   |
|       |   | Coloplast            | NON CONFORME  | è presente una sola configurazione di punta   |
|       |   | ESSEDUE GROUP        | CONFORME  |   |
| 13    | FILO GUIDA IBRIDO   | OLYMPUS ITALIA SRL   | CONFORME  |   |
|       |   | TELEFLEX MEDICAL SRL | NON CONFORME  | il corpo della guida non risulta avvolto da una spirale in acciaio rivestito  |
|       |   | Coloplast            | NON CONFORME  | - il corpo della guida non risulta avvolto da una spirale in acciaio rivestito<br>- la punta della guida non è dritta |
|       |   | ESSEDUE GROUP        | CONFORME  |   |
| 14    | CESTELLO RECUPERO CALCOLI IN NITINOL  | OLYMPUS ITALIA SRL   | CONFORME  |   |
|       |   | Coloplast            | CONFORME  |   |
|       |   | ESSEDUE GROUP        | CONFORME  |   |
| 15    | SPIRALE UROLOGICA DI RECUPERO TIPO "STONE CONE"   | ESSEDUE GROUP        | CONFORME  |   |
| 16    | ENDOPROTESI URETERALI A LUNGA PERMANENZA  | ESSEDUE GROUP        | CONFORME  |   |
| 18    | RACCORDO UNIVERSALE PER CATETERE URETERALE  | Coloplast            | CONFORME  |   |
| 19    | EVACUATORE VESCICALE DI ELLIK MONOUSO PER UNA SICURA, RAPIDA IRRIGAZIONE VESCICALE E RIMOZIONE DI FRAMMENTI | Coloplast            | NON CONFORME  | non è presente la valvola di non ritorno integrata per prevenire il reflusso dei frammenti                            |
| 20    | CAMICIA IDROFILA URETEROSCOPIO  | ESSEDUE GROUP        | CONFORME  |   |

Terminata la fase di verifica dei lotti da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso, la Commissione inizia i lavori volti alla valutazione della documentazione tecnica dei lotti da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione procede con la valutazione delle offerte tecniche del lotto n. 3 (e della relativa campionatura prodotta dai concorrenti partecipanti al suddetto lotto) al fine sia di riscontrarne la rispondenza a quanto previsto negli atti di gara sia di attribuirne i punteggi tecnici in base ai criteri premiali previsti negli atti di gara (art.12.2.1 del Disciplinare di gara).

Le risultanze di tali operazioni vengono riportate nel prospetto riepilogativo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale (All.1).

Al termine della valutazione del lotto n.3, la Commissione procede al controllo circa il superamento della soglia di sbarramento, prevista nell'art.12.2.1 del Disciplinare di gara in 36/70, ed alle successive operazioni di riparametrazione dei punteggi tecnici totali, in conformità a quanto previsto nell'art.12.2.1 del Disciplinare di gara, con le risultanze di seguito riportate.


| LOTTO 3              | CATETERI DUFOUR 3 VIE                  |                       |        |                  |
|----------------------|--|-----------------------|--------|------------------|
| DITTE                | Punteggio attribuito dalla Commissione | Soglia di Sbarramento | P. Max | Riparametrazione |
| TELEFLEX MEDICAL SRL | 68,33                                  | 36/70                 | 68,33  | 70,00            |
| Coloplast            | 51,00                                  |                       |        | 52,25            |

Alle ore 18:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata per riconvocarla a data da destinarsi per la continuazione della valutazione delle offerte tecniche.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Seggio di Gara nel modo che segue:

Presidente

Dr. Maurizio Ombres

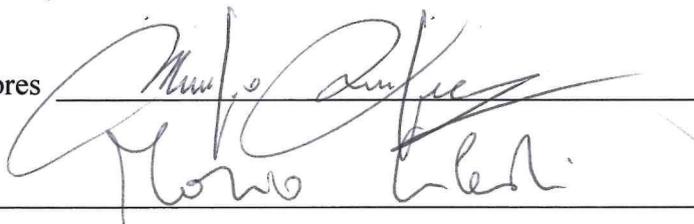


Componente

Dr. Mario Ciletti



Componente con funzione di verbalizzante

Dr. Simone Pagliarino

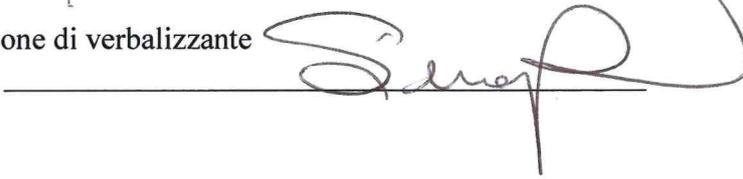

| LOTTO                        |   | 3                 |  |      |      |       |                      |
|------------------------------|---|-------------------|--|------|------|-------|----------------------|
| Ditta                        |   | Coloplast         |  |      |      |       |                      |
| CRITERI QUALITA'             |   | Punteggio massimo | Voto Commissione                             |      |      |       | Punteggio attribuito |
|                              |   |                   | M.O.   | M.C. | S.P. | Media |                      |
| 1                            | <i>Facilità di posizionamento</i>   | 15                | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 15,00                |
| 2                            | <i>Qualità del drenaggio</i>  | 10                | 0,60   | 0,60 | 0,60 | 0,60  | 6,00                 |
| 3                            | <i>Qualità del palloncino e uniformità delle parti congiunte</i>  | 10                | 0,40   | 0,40 | 0,40 | 0,40  | 4,00                 |
| 4                            | <i>Robustezza e resistenza al kinking</i>   | 10                | 0,80   | 0,80 | 0,80 | 0,80  | 8,00                 |
| 5                            | <i>Caratteristica della punta</i>   | 15                | 0,80   | 0,60 | 0,60 | 0,67  | 10,00                |
| 6                            | <i>Atraumaticità e conformazione corretta esente da scabrosità</i>  | 5                 | 0,60   | 0,60 | 0,60 | 0,60  | 3,00                 |
| 7                            | <i>Caratteristiche del confezionamento: trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata</i> | 5                 | Criterio Tabellare (SI/NO):<br>si=Pmax; no=0 |      |      |       | 5,00                 |
| PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO |   |                   |  |      |      |       | 51,00                |

| LOTTO                        |   | 3                    |  |      |      |       |                      |
|------------------------------|---|----------------------|--|------|------|-------|----------------------|
| Ditta                        |   | TELEFLEX MEDICAL SRL |  |      |      |       |                      |
| CRITERI QUALITA'             |   | Punteggio massimo    | Voto Commissione                             |      |      |       | Punteggio attribuito |
|                              |   |                      | M.O.   | M.C. | S.P. | Media |                      |
| 1                            | <i>Facilità di posizionamento</i>   | 15                   | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 15,00                |
| 2                            | <i>Qualità del drenaggio</i>  | 10                   | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 10,00                |
| 3                            | <i>Qualità del palloncino e uniformità delle parti congiunte</i>  | 10                   | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 10,00                |
| 4                            | <i>Robustezza e resistenza al kinking</i>   | 10                   | 1,00   | 0,80 | 1,00 | 0,93  | 9,33                 |
| 5                            | <i>Caratteristica della punta</i>   | 15                   | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 15,00                |
| 6                            | <i>Atraumaticità e conformazione corretta esente da scabrosità</i>  | 5                    | 0,80   | 0,80 | 0,80 | 0,80  | 4,00                 |
| 7                            | <i>Caratteristiche del confezionamento: trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata</i> | 5                    | Criterio Tabellare (SI/NO):<br>si=Pmax; no=0 |      |      |       | 5,00                 |
| PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO |   |                      |  |      |      |       | 68,33                |

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it**  
**C.F. e P.I. 00821180577**

Procedura negoziata a mezzo RDO sul MELA (STELLA) - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2023 - per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia urologica da destinare alla U.O.C. Urologia del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 212.235,90 al netto dell'IVA. Numero gara 9398089.

### **VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE n. 3**

#### **IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

Il giorno 20 febbraio 2024, alle ore 13:00 presso l'U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, constatata la presenza di tutti i componenti, da inizio ai lavori in seduta riservata per continuare i lavori volti alla valutazione delle offerte tecniche.

La Commissione, constatata l'assenza del segretario verbalizzante, stabilisce di attribuire tale funzione al Dr. Simone Pagliarino.

La Commissione procede, pertanto, con la valutazione delle offerte tecniche dei lotti nn. 4, 5, 8, 9 ed 11 (e della relativa campionatura prodotta dai concorrenti partecipanti per i suddetti lotti) al fine sia di riscontrarne la rispondenza a quanto previsto negli atti di gara sia di attribuirne i punteggi tecnici in base ai criteri premiali previsti negli atti di gara (art.12.2.1 del Disciplinare di gara).

In base a quanto sopra, la Commissione riscontra la presenza delle seguenti difformità:

- lotto 8, O.E. ESSEDUE GROUP: la lunghezza del prodotto offerto (70 cm) non corrisponde alla lunghezza riportata nella documentazione di gara ("All. 2.1 al CSA - Elenco prodotti") pari a 90 cm; pertanto, la Commissione stabilisce di non ammettere l'O.E. al prosieguo della gara;
- lotto 8, O.E. OLYMPUS ITALIA SRL: il prodotto non è conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara ("All. 2.1 al CSA - Elenco prodotti") in quanto dotato di punta chiusa nel pigtail in luogo di quella aperta; pertanto, la Commissione stabilisce di non ammettere l'O.E. al prosieguo della gara;
- lotto 10, O.E. Coloplast: il prodotto non è conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara ("All. 2.1 al CSA - Elenco prodotti") in quanto è presente un'unica misura di calibro in luogo delle tre richieste; pertanto, la Commissione stabilisce di non ammettere l'O.E. al prosieguo della gara;
- lotto 10, O.E. ESSEDUE GROUP: il prodotto non è conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara ("All. 2.1 al CSA - Elenco prodotti") in quanto presenta fori posizionati oltre il pigtail ed altresì il corpo centrale non risulta rigido; pertanto, la Commissione stabilisce di non ammettere l'O.E. al prosieguo della gara;



- lotto 17, O.E. Coloplast: il prodotto non è conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara (“All. 2.1 al CSA - Elenco prodotti”) in quanto sprovvisto di sistema di ancoraggio; pertanto, la Commissione stabilisce di non ammettere l’O.E. al prosieguo della gara;
- lotto 17, O.E. ESSEDUE GROUP: il prodotto non è conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara (“All. 2.1 al CSA - Elenco prodotti”) in quanto sprovvisto di sistema di ancoraggio; pertanto, la Commissione stabilisce di non ammettere l’O.E. al prosieguo della gara;
- lotto 17, O.E. TELEFELX MEDICAL SRL: il prodotto non è conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara (“All. 2.1 al CSA - Elenco prodotti”) in quanto sprovvisto di sistema di ancoraggio; pertanto, la Commissione stabilisce di non ammettere l’O.E. al prosieguo della gara;
- lotto 22, O.E. OLYMPUS ITALIA SRL: il prodotto non è conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara (“All. 2.1 al CSA - Elenco prodotti”) in quanto il prodotto non è dotato di doppio lume; pertanto, la Commissione stabilisce di non ammettere l’O.E. al prosieguo della gara;

La Commissione constata altresì, in relazione all’offerta prodotta dall’operatore economico Coloplast per il lotto n.9, che, seppure la società abbia riportato nella scheda tecnica prodotti aventi misure 4.8, 6, 7 e 8 Fr (così come richiesto “All.2.1 al CSA - Elenco prodotti”), solamente i prodotti aventi misura 4.8 Fr sono evidenziati in giallo.

Pertanto, la Commissione stabilisce di ammettere con riserva il suddetto operatore alla fase successiva di gara e di acquisire dallo stesso la conferma che l’offerta rimessa sia relativa anche ai prodotti presenti nella suddetta scheda tecnica aventi misure 6, 7 e 8 Fr.

Le risultanze dei lavori di valutazione effettuati dalla Commissione vengono riportate nel prospetto riepilogativo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale (All.1).

Al termine della valutazione di ciascuno dei sopramenzionati lotti, la Commissione procede al controllo circa il superamento della soglia di sbarramento, prevista nell’art.12.2.1 del Disciplinare di gara in 36/70, ed alle successive operazioni di riparametrazione dei punteggi tecnici totali, in conformità a quanto previsto nell’art.12.2.1 del Disciplinare di gara, con il seguente risultato.


| <b>LOTTO 4</b>       |  | <b>CATETERE URETERALE TIPO POLLACK PUNTA APERTA</b>   |        |                  |  |
|----------------------|--|---|--------|------------------|--|
| DITTE                | Punteggio attribuito dalla Commissione | Soglia di Sbarramento   | P. Max | Riparametrazione |  |
| TELEFLEX MEDICAL SRL | 36,00                                  | 36/70   | 70,00  | 36,00            |  |
| Coloplast            | 70,00                                  |   |        | 70,00            |  |
| ESSEDUE GROUP        | 50,00                                  |   |        | 50,00            |  |
| <b>LOTTO 5</b>       |  | <b>CATETERE TUTORE, PER URETEROCUTANEOSTOMIA, IN POLIURETANO TRASPARENTE</b>                |        |                  |  |
| DITTE                | Punteggio attribuito dalla Commissione | Soglia di Sbarramento   | P. Max | Riparametrazione |  |
| TELEFLEX MEDICAL SRL | 70,00                                  | 36/70   | 70,00  | 70,00            |  |
| <b>LOTTO 7</b>       |  | <b>CATETERE A PALLONCINO PER IL TRATTAMENTO STENOSI URETRALI RICORRENTI TIPO "OPTILUME"</b> |        |                  |  |
| DITTE                | Punteggio attribuito dalla Commissione | Soglia di Sbarramento   | P. Max | Riparametrazione |  |
| DESERTO              |  |   |        |                  |  |

| LOTTO 8              |  | STENT URETERALE 1J PER NEFROSTOMIA   |        |                  |  |
|----------------------|--|--|--------|------------------|--|
| DITTE                | Punteggio attribuito dalla Commissione | Soglia di Sbarramento  | P. Max | Riparametrazione |  |
| OLYMPUS ITALIA SRL   | escluso                                | 36/70  | 70,00  | -                |  |
| TELEFLEX MEDICAL SRL | 50,00                                  |  |        | 50,00            |  |
| Coloplast            | 70,00                                  |  |        | 70,00            |  |
| ESSEDUE GROUP        | escluso                                |  |        | -                |  |
| LOTTO 9              |  | STENT 2J IDROFILICO LUNGA PERMANENZA   |        |                  |  |
| DITTE                | Punteggio attribuito dalla Commissione | Soglia di Sbarramento  | P. Max | Riparametrazione |  |
| OLYMPUS ITALIA SRL   | 52,00                                  | 36/70  | 65,33  | 55,72            |  |
| TELEFLEX MEDICAL SRL | 50,00                                  |  |        | 53,57            |  |
| Coloplast            | 52,00                                  |  |        | 55,72            |  |
| ESSEDUE GROUP        | 65,33                                  |  |        | 70,00            |  |
| LOTTO 10             |  | STENT URETERALI A DOPPI J TUMOR STENT  |        |                  |  |
| DITTE                | Punteggio attribuito dalla Commissione | Soglia di Sbarramento  | P. Max | Riparametrazione |  |
| Coloplast            | escluso                                | 36/70  | -      | -                |  |
| ESSEDUE GROUP        | escluso                                |  |        | -                |  |
| LOTTO 11             |  | STENT URETERALE A DOPPIA DUROMETRIA TIPO "POLARIS LOOP"                                      |        |                  |  |
| DITTE                | Punteggio attribuito dalla Commissione | Soglia di Sbarramento  | P. Max | Riparametrazione |  |
| ESSEDUE GROUP        | 56,00                                  | 36/70  | 56,00  | 70,00            |  |
| LOTTO 17             |  | SET PUNZIONE NEFROSTOMIA PERCUTANEA TECNICA "A DUE PASSI"                                    |        |                  |  |
| DITTE                | Punteggio attribuito dalla Commissione | Soglia di Sbarramento  | P. Max | Riparametrazione |  |
| TELEFLEX MEDICAL SRL | escluso                                | 36/70  | -      | -                |  |
| Coloplast            | escluso                                |  |        | -                |  |
| ESSEDUE GROUP        | escluso                                |  |        | -                |  |
| LOTTO 22             |  | GUAINA DI ACCESSO URETERALE PER PROCEDURE D'URETEROSCOPIA FLESSIBILE 10/12 12/14 DOPPIO LUME |        |                  |  |
| DITTE                | Punteggio attribuito dalla Commissione | Soglia di Sbarramento  | P. Max | Riparametrazione |  |
| OLYMPUS ITALIA SRL   | escluso                                | 36/70  | -      | -                |  |

Alle ore 18:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata per riconvocarla, a data da destinarsi, in seduta pubblica virtuale per l'inserimento a sistema delle risultanze delle valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione e successiva apertura della busta economica degli OO.EE. ammessi a tale fase di gara.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Seggio di Gara nel modo che segue:


Presidente  
Dr. Maurizio Ombres

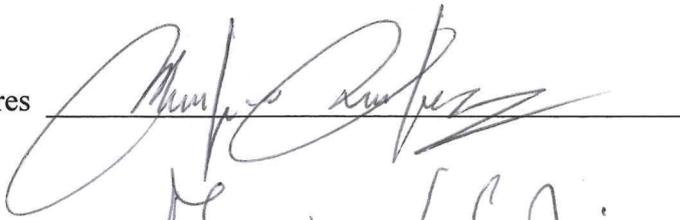A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and difficult to read.

Componente  
Dr. Mario Ciletti

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Mario Ciletti'.

Componente con funzione di verbalizzante  
Dr. Simone Pagliarino

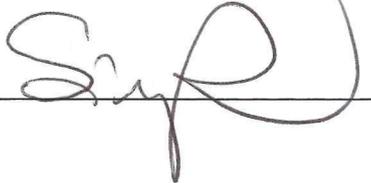A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Simone Pagliarino'.

| LOTTO                        |   | 4                    |  |      |      |       |                      |
|------------------------------|---|----------------------|--|------|------|-------|----------------------|
| Ditta                        |   | TELEFLEX MEDICAL SRL |  |      |      |       |                      |
| CRITERI QUALITA'             |   | Punteggio massimo    | Voto Commissione                             |      |      |       | Punteggio attribuito |
|                              |   |                      | M.O.   | M.C. | S.P. | Media |                      |
| 1                            | <i>Facilità di introduzione del catetere e del filo guida</i>   | 20                   | 0,60   | 0,60 | 0,60 | 0,60  | 12,00                |
| 2                            | <i>Qualità del drenaggio</i>  | 10                   | 0,60   | 0,60 | 0,60 | 0,60  | 6,00                 |
| 3                            | <i>Atraumaticità e conformazione corretta esente da scabrosità</i>  | 10                   | 0,20   | 0,20 | 0,20 | 0,20  | 2,00                 |
| 4                            | <i>Caratteristica del materiale</i>   | 10                   | 0,80   | 0,80 | 0,80 | 0,80  | 8,00                 |
| 5                            | <i>Praticità d'uso e funzionalità</i>   | 15                   | 0,20   | 0,20 | 0,20 | 0,20  | 3,00                 |
| 6                            | <i>Caratteristiche del confezionamento: trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata</i> | 5                    | Criterio Tabellare (SI/NO):<br>si=Pmax; no=0 |      |      |       | 5,00                 |
| PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO |   |                      |  |      |      |       | 36,00                |

| LOTTO                        |   | 4                 |  |      |      |       |                      |
|------------------------------|---|-------------------|--|------|------|-------|----------------------|
| Ditta                        |   | Coloplast         |  |      |      |       |                      |
| CRITERI QUALITA'             |   | Punteggio massimo | Voto Commissione                             |      |      |       | Punteggio attribuito |
|                              |   |                   | M.O.   | M.C. | S.P. | Media |                      |
| 1                            | <i>Facilità di introduzione del catetere e del filo guida</i>   | 20                | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 20,00                |
| 2                            | <i>Qualità del drenaggio</i>  | 10                | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 10,00                |
| 3                            | <i>Atraumaticità e conformazione corretta esente da scabrosità</i>  | 10                | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 10,00                |
| 4                            | <i>Caratteristica del materiale</i>   | 10                | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 10,00                |
| 5                            | <i>Praticità d'uso e funzionalità</i>   | 15                | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 15,00                |
| 6                            | <i>Caratteristiche del confezionamento: trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata</i> | 5                 | Criterio Tabellare (SI/NO):<br>si=Pmax; no=0 |      |      |       | 5,00                 |
| PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO |   |                   |  |      |      |       | 70,00                |

| LOTTO            |  | 4                 |                  |      |      |       |                      |
|------------------|--|-------------------|------------------|------|------|-------|----------------------|
| Ditta            |  | ESSEDUE GROUP     |                  |      |      |       |                      |
| CRITERI QUALITA' |  | Punteggio massimo | Voto Commissione |      |      |       | Punteggio attribuito |
|                  |  |                   | M.O.             | M.C. | S.P. | Media |                      |
| 1                | <i>Facilità di introduzione del catetere e del filo guida</i>      | 20                | 0,80             | 0,80 | 0,80 | 0,80  | 16,00                |
| 2                | <i>Qualità del drenaggio</i>                                       | 10                | 1,00             | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 10,00                |
| 3                | <i>Atraumaticità e conformazione corretta esente da scabrosità</i> | 10                | 0,40             | 0,40 | 0,40 | 0,40  | 4,00                 |
| 4                | <i>Caratteristica del materiale</i>                                | 10                | 0,60             | 0,60 | 0,60 | 0,60  | 6,00                 |

|                                     |   |                             |  |             |             |              |                             |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 5                                   | <i>Praticità d'uso e funzionalità</i>   | <b>15</b>                   | 0,60   | 0,60        | 0,60        | 0,60         | <b>9,00</b>                 |
| 6                                   | <i>Caratteristiche del confezionamento: trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata</i> | <b>5</b>                    | Criterio Tabellare (SI/NO):<br>si=Pmax; no=0 |             |             |              | <b>5,00</b>                 |
| <b>PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO</b> |   |                             |  |             |             |              | <b>50,00</b>                |
| <b>LOTTO</b>                        |   | <b>5</b>                    |  |             |             |              |                             |
| <b>Ditta</b>                        |   | <b>TELEFLEX MEDICAL SRL</b> |  |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             |   | <b>Punteggio massimo</b>    | <b>Voto Commissione</b>                      |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |   |                             | <b>M.O.</b>                                  | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| 1                                   | <i>Ridotta deteriorabilità del catetere (maggiore tempo di funzionalità e durabilità)</i>   | <b>15</b>                   | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>15,00</b>                |
| 2                                   | <i>Capacità drenante</i>  | <b>10</b>                   | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>10,00</b>                |
| 3                                   | <i>Atraumaticità e conformazione corretta esente da scabrosità</i>  | <b>15</b>                   | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>15,00</b>                |
| 4                                   | <i>Adattabilità alla sacca di drenaggio</i>   | <b>5</b>                    | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>5,00</b>                 |
| 5                                   | <i>Scorrevolezza con o senza filo guida</i>   | <b>20</b>                   | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>20,00</b>                |
| 6                                   | <i>Caratteristiche del confezionamento: trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata</i> | <b>5</b>                    | Criterio Tabellare (SI/NO):<br>si=Pmax; no=0 |             |             |              | <b>5,00</b>                 |
| <b>PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO</b> |   |                             |  |             |             |              | <b>70,00</b>                |
| <b>LOTTO</b>                        |   | <b>7</b>                    |  |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             |   | <b>Punteggio massimo</b>    | <b>Voto Commissione</b>                      |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |   |                             | <b>M.O.</b>                                  | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| DESERTO                             |   |                             |  |             |             |              |                             |
| <b>LOTTO</b>                        |   | <b>8</b>                    |  |             |             |              |                             |
| <b>Ditta</b>                        |   | <b>OLYMPUS ITALIA SRL</b>   |  |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             |   | <b>Punteggio massimo</b>    | <b>Voto Commissione</b>                      |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |   |                             | <b>M.O.</b>                                  | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| ESCLUSO                             |   |                             |  |             |             |              |                             |
| <b>LOTTO</b>                        |   | <b>8</b>                    |  |             |             |              |                             |
| <b>Ditta</b>                        |   | <b>TELEFLEX MEDICAL SRL</b> |  |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             |   | <b>Punteggio massimo</b>    | <b>Voto Commissione</b>                      |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |   |                             | <b>M.O.</b>                                  | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| 1                                   | <i>Facilità di introduzione</i>   | <b>10</b>                   | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 2                                   | <i>Atraumaticità della punta</i>  | <b>10</b>                   | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 3                                   | <i>Qualità del materiale</i>  | <b>15</b>                   | 0,60   | 0,60        | 0,60        | 0,60         | <b>9,00</b>                 |

|                                     |   |                           |  |             |             |              |                             |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 4                                   | <i>Qualità del rivestimento</i>   | <b>10</b>                 | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 5                                   | <i>Praticità d'utilizzo: maneggevolezza, sistema di posizionamento e sistema di rimozione</i> | <b>10</b>                 | 0,60   | 0,60        | 0,60        | 0,60         | <b>6,00</b>                 |
| 6                                   | <i>Scorrevolezza nelle vie urinarie</i>   | <b>10</b>                 | 0,60   | 0,60        | 0,60        | 0,60         | <b>6,00</b>                 |
| 7                                   | <i>Presenza di etichette di tracciabilità trasferibili</i>                                    | <b>5</b>                  | Criterio Tabellare (SI/NO):<br>si=Pmax; no=0 |             |             |              | <b>5,00</b>                 |
| <b>PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO</b> |   |                           |  |             |             |              | <b>50,00</b>                |
| <b>LOTTO</b>                        |   | <b>8</b>                  |  |             |             |              |                             |
| <b>Ditta</b>                        |   | <b>Coloplast</b>          |  |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             |   | <b>Punteggio massimo</b>  | <b>Voto Commissione</b>                      |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |   |                           | <b>M.O.</b>                                  | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| 1                                   | <i>Facilità di introduzione</i>   | <b>10</b>                 | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>10,00</b>                |
| 2                                   | <i>Atraumaticità della punta</i>  | <b>10</b>                 | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>10,00</b>                |
| 3                                   | <i>Qualità del materiale</i>  | <b>15</b>                 | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>15,00</b>                |
| 4                                   | <i>Qualità del rivestimento</i>   | <b>10</b>                 | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>10,00</b>                |
| 5                                   | <i>Praticità d'utilizzo: maneggevolezza, sistema di posizionamento e sistema di rimozione</i> | <b>10</b>                 | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>10,00</b>                |
| 6                                   | <i>Scorrevolezza nelle vie urinarie</i>   | <b>10</b>                 | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>10,00</b>                |
| 7                                   | <i>Presenza di etichette di tracciabilità trasferibili</i>                                    | <b>5</b>                  | Criterio Tabellare (SI/NO):<br>si=Pmax; no=0 |             |             |              | <b>5,00</b>                 |
| <b>PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO</b> |   |                           |  |             |             |              | <b>70,00</b>                |
| <b>LOTTO</b>                        |   | <b>8</b>                  |  |             |             |              |                             |
| <b>Ditta</b>                        |   | <b>ESSEDUE GROUP</b>      |  |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             |   | <b>Punteggio massimo</b>  | <b>Voto Commissione</b>                      |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |   |                           | <b>M.O.</b>                                  | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| <b>ESCLUSO</b>                      |   |                           |  |             |             |              |                             |
| <b>LOTTO</b>                        |   | <b>9</b>                  |  |             |             |              |                             |
| <b>Ditta</b>                        |   | <b>OLYMPUS ITALIA SRL</b> |  |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             |   | <b>Punteggio massimo</b>  | <b>Voto Commissione</b>                      |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |   |                           | <b>M.O.</b>                                  | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| 1                                   | <i>Facilità di introduzione</i>   | <b>10</b>                 | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 2                                   | <i>Atraumaticità della punta</i>  | <b>10</b>                 | 0,60   | 0,60        | 0,60        | 0,60         | <b>6,00</b>                 |
| 3                                   | <i>Qualità del materiale</i>  | <b>15</b>                 | 0,60   | 0,60        | 0,60        | 0,60         | <b>9,00</b>                 |
| 4                                   | <i>Qualità del rivestimento</i>   | <b>10</b>                 | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 5                                   | <i>Praticità d'utilizzo: maneggevolezza, sistema di posizionamento e sistema di rimozione</i> | <b>10</b>                 | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |

|                                     |  |           |  |      |      |      |              |
|-------------------------------------|--|-----------|--|------|------|------|--------------|
| 6                                   | <i>Scorrevolezza nelle vie urinarie</i>                    | <b>10</b> | 0,80   | 0,80 | 0,80 | 0,80 | <b>8,00</b>  |
| 7                                   | <i>Presenza di etichette di tracciabilità trasferibili</i> | <b>5</b>  | Criterio Tabellare (SI/NO):<br>si=Pmax; no=0 |      |      |      | <b>5,00</b>  |
| <b>PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO</b> |  |           |  |      |      |      | <b>52,00</b> |

| <b>LOTTO</b>                        |   | <b>9</b>                    |  |             |             |              |                             |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Ditta</b>                        |   | <b>TELEFLEX MEDICAL SRL</b> |  |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             |   | <b>Punteggio massimo</b>    | <b>Voto Commissione</b>                      |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |   |                             | <b>M.O.</b>                                  | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| 1                                   | <i>Facilità di introduzione</i>   | <b>10</b>                   | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 2                                   | <i>Atraumaticità della punta</i>  | <b>10</b>                   | 0,60   | 0,60        | 0,60        | 0,60         | <b>6,00</b>                 |
| 3                                   | <i>Qualità del materiale</i>  | <b>15</b>                   | 0,60   | 0,60        | 0,60        | 0,60         | <b>9,00</b>                 |
| 4                                   | <i>Qualità del rivestimento</i>   | <b>10</b>                   | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 5                                   | <i>Praticità d'utilizzo: maneggevolezza, sistema di posizionamento e sistema di rimozione</i> | <b>10</b>                   | 0,60   | 0,60        | 0,60        | 0,60         | <b>6,00</b>                 |
| 6                                   | <i>Scorrevolezza nelle vie urinarie</i>   | <b>10</b>                   | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 7                                   | <i>Presenza di etichette di tracciabilità trasferibili</i>                                    | <b>5</b>                    | Criterio Tabellare (SI/NO):<br>si=Pmax; no=0 |             |             |              | <b>5,00</b>                 |
| <b>PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO</b> |   |                             |  |             |             |              | <b>50,00</b>                |

| <b>LOTTO</b>                        |   | <b>9</b>                 |  |             |             |              |                             |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Ditta</b>                        |   | <b>Coloplast</b>         |  |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             |   | <b>Punteggio massimo</b> | <b>Voto Commissione</b>                      |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |   |                          | <b>M.O.</b>                                  | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| 1                                   | <i>Facilità di introduzione</i>   | <b>10</b>                | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 2                                   | <i>Atraumaticità della punta</i>  | <b>10</b>                | 0,60   | 0,60        | 0,60        | 0,60         | <b>6,00</b>                 |
| 3                                   | <i>Qualità del materiale</i>  | <b>15</b>                | 0,60   | 0,60        | 0,60        | 0,60         | <b>9,00</b>                 |
| 4                                   | <i>Qualità del rivestimento</i>   | <b>10</b>                | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 5                                   | <i>Praticità d'utilizzo: maneggevolezza, sistema di posizionamento e sistema di rimozione</i> | <b>10</b>                | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 6                                   | <i>Scorrevolezza nelle vie urinarie</i>   | <b>10</b>                | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 7                                   | <i>Presenza di etichette di tracciabilità trasferibili</i>                                    | <b>5</b>                 | Criterio Tabellare (SI/NO):<br>si=Pmax; no=0 |             |             |              | <b>5,00</b>                 |
| <b>PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO</b> |   |                          |  |             |             |              | <b>52,00</b>                |

| <b>LOTTO</b>            |  | <b>9</b>                 |                         |             |             |              |                             |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Ditta</b>            |  | <b>ESSEDUE GROUP</b>     |                         |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b> |  | <b>Punteggio massimo</b> | <b>Voto Commissione</b> |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                         |  |                          | <b>M.O.</b>             | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |

|                                     |   |                          |  |             |             |              |                             |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 1                                   | <i>Facilità di introduzione</i>   | <b>10</b>                | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>10,00</b>                |
| 2                                   | <i>Atraumaticità della punta</i>  | <b>10</b>                | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>10,00</b>                |
| 3                                   | <i>Qualità del materiale</i>  | <b>15</b>                | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>15,00</b>                |
| 4                                   | <i>Qualità del rivestimento</i>   | <b>10</b>                | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 5                                   | <i>Praticità d'utilizzo: maneggevolezza, sistema di posizionamento e sistema di rimozione</i>   | <b>10</b>                | 1,00   | 1,00        | 0,80        | 0,93         | <b>9,33</b>                 |
| 6                                   | <i>Scorrevolezza nelle vie urinarie</i>   | <b>10</b>                | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 7                                   | <i>Presenza di etichette di tracciabilità trasferibili</i>  | <b>5</b>                 | Criterio Tabellare (SI/NO):<br>si=Pmax; no=0 |             |             |              | <b>5,00</b>                 |
| <b>PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO</b> |   |                          |  |             |             |              | <b>65,33</b>                |
| <b>LOTTO</b>                        |   | <b>10</b>                |  |             |             |              |                             |
| <b>Ditta</b>                        |   | <b>Coloplast</b>         |  |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             |   | <b>Punteggio massimo</b> | <b>Voto Commissione</b>                      |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |   |                          | <b>M.O.</b>                                  | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| ESCLUSO                             |   |                          |  |             |             |              |                             |
| <b>LOTTO</b>                        |   | <b>10</b>                |  |             |             |              |                             |
| <b>Ditta</b>                        |   | <b>ESSEDUE GROUP</b>     |  |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             |   | <b>Punteggio massimo</b> | <b>Voto Commissione</b>                      |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |   |                          | <b>M.O.</b>                                  | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| ESCLUSO                             |   |                          |  |             |             |              |                             |
| <b>LOTTO</b>                        |   | <b>11</b>                |  |             |             |              |                             |
| <b>Ditta</b>                        |   | <b>ESSEDUE GROUP</b>     |  |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             |   | <b>Punteggio massimo</b> | <b>Voto Commissione</b>                      |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |   |                          | <b>M.O.</b>                                  | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| 1                                   | <i>Facilità di introduzione</i>   | <b>10</b>                | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 2                                   | <i>Atraumaticità della punta</i>  | <b>10</b>                | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>10,00</b>                |
| 3                                   | <i>Qualità del materiale</i>  | <b>10</b>                | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>10,00</b>                |
| 4                                   | <i>Qualità del rivestimento</i>   | <b>5</b>                 | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>5,00</b>                 |
| 5                                   | <i>Praticità d'utilizzo: maneggevolezza, sistema di posizionamento e sistema di rimozione</i>   | <b>10</b>                | 0,80   | 0,80        | 0,80        | 0,80         | <b>8,00</b>                 |
| 6                                   | <i>Scorrevolezza nelle vie urinarie</i>   | <b>10</b>                | 1,00   | 1,00        | 1,00        | 1,00         | <b>10,00</b>                |
| 7                                   | <i>Presenza di etichette di tracciabilità trasferibili</i>  | <b>5</b>                 | Criterio Tabellare (SI/NO):<br>si=Pmax; no=0 |             |             |              | <b>5,00</b>                 |
| 8                                   | <i>Studi clinici e letteratura: studi clinici di elevata qualità, ad esempio, RCT riportanti outcomes medico chirurgici propri del prodotto offerto</i> | <b>10</b>                | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00         | <b>0,00</b>                 |

|                                     |                             |                         |             |             |              |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| <b>PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO</b> |                             |                         |             |             |              | <b>56,00</b>                |
| <b>LOTTO</b>                        | <b>17</b>                   |                         |             |             |              |                             |
| <b>Ditta</b>                        | <b>TELEFLEX MEDICAL SRL</b> |                         |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             | <b>Punteggio massimo</b>    | <b>Voto Commissione</b> |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |                             | <b>M.O.</b>             | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| ESCLUSO                             |                             |                         |             |             |              |                             |
| <b>LOTTO</b>                        | <b>17</b>                   |                         |             |             |              |                             |
| <b>Ditta</b>                        | <b>Coloplast</b>            |                         |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             | <b>Punteggio massimo</b>    | <b>Voto Commissione</b> |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |                             | <b>M.O.</b>             | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| ESCLUSO                             |                             |                         |             |             |              |                             |
| <b>LOTTO</b>                        | <b>17</b>                   |                         |             |             |              |                             |
| <b>Ditta</b>                        | <b>ESSEDUE GROUP</b>        |                         |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             | <b>Punteggio massimo</b>    | <b>Voto Commissione</b> |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |                             | <b>M.O.</b>             | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| ESCLUSO                             |                             |                         |             |             |              |                             |
| <b>LOTTO</b>                        | <b>22</b>                   |                         |             |             |              |                             |
| <b>Ditta</b>                        | <b>OLYMPUS ITALIA SRL</b>   |                         |             |             |              |                             |
| <b>CRITERI QUALITA'</b>             | <b>Punteggio massimo</b>    | <b>Voto Commissione</b> |             |             |              | <b>Punteggio attribuito</b> |
|                                     |                             | <b>M.O.</b>             | <b>M.C.</b> | <b>S.P.</b> | <b>Media</b> |                             |
| ESCLUSO                             |                             |                         |             |             |              |                             |

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it**  
**C.F. e P.I. 00821180577**

Procedura negoziata a mezzo RDO sul MELA (STELLA) - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2023 - per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia urologica da destinare alla U.O.C. Urologia del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 212.235,90 al netto dell'IVA. Numero gara 9398089.

#### **VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE n. 4**

#### **IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

Il giorno 05 marzo 2024, alle ore 13:35 presso l'U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, constatata la presenza di tutti i componenti, da inizio ai lavori in seduta pubblica virtuale volti all'inserimento su piattaforma STELLA delle risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulle offerte tecniche prodotte dagli OO.EE. ammessi a tale fase e successiva apertura della busta economica.


La Commissione, constatata l'assenza del segretario verbalizzante, stabilisce di attribuire tale funzione al Dr. Simone Pagliarino.

La Commissione prende atto della nota, registro di sistema STELLA n. PI031294-24 del 27/02/2024, nella quale la società Coloplast conferma, per il lotto n.9, che l'offerta rimessa è relativa anche ai prodotti aventi misure 6, 7 e 8 Fr.

In relazione a quanto sopra, la Commissione scioglie la riserva ammettendo l'operatore economico Coloplast al prosieguo della gara.

La Commissione stabilisce pertanto di ammettere alla successiva fase di gara i seguenti OO.EE. per i lotti di seguito riportati:

| <b>LOTTO</b> | <b>DITTE</b>         | <b>VALUTAZIONE</b> |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 3            | TELEFLEX MEDICAL SRL | Ammesso            |
| 3            | Coloplast            | Ammesso            |
| 4            | TELEFLEX MEDICAL SRL | Ammesso            |
| 4            | Coloplast            | Ammesso            |
| 4            | ESSEDUE GROUP        | Ammesso            |
| 5            | TELEFLEX MEDICAL SRL | Ammesso            |
| 8            | OLYMPUS ITALIA SRL   | Escluso            |
| 8            | TELEFLEX MEDICAL SRL | Ammesso            |
| 8            | Coloplast            | Ammesso            |
| 8            | ESSEDUE GROUP        | Escluso            |
| 9            | OLYMPUS ITALIA SRL   | Ammesso            |

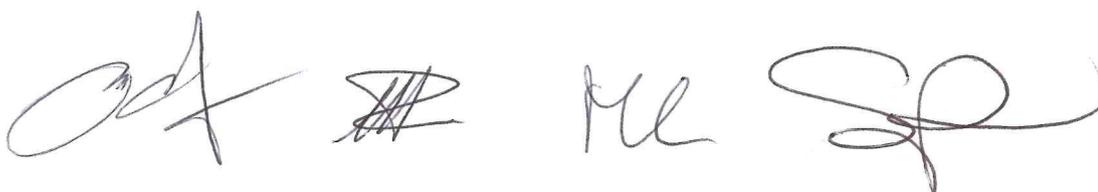

|    |                      |         |
|----|----------------------|---------|
| 9  | TELEFLEX MEDICAL SRL | Ammesso |
| 9  | Coloplast            | Ammesso |
| 9  | ESSEDUE GROUP        | Ammesso |
| 10 | Coloplast            | Escluso |
| 10 | ESSEDUE GROUP        | Escluso |
| 11 | ESSEDUE GROUP        | Ammesso |
| 17 | TELEFLEX MEDICAL SRL | Escluso |
| 17 | Coloplast            | Escluso |
| 17 | ESSEDUE GROUP        | Escluso |
| 22 | OLYMPUS ITALIA SRL   | Escluso |

Terminato l'inserimento su piattaforma STELLA delle risultanze della valutazione tecnica, la Commissione, prima di procedere con l'apertura della busta economica, da atto di quanto segue:

- l'art.13 del Disciplinare di gara prevede che <<Per i lotti da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo (PPB), l'apertura e la valutazione della busta economica sarà competenza del Seggio di gara>>;
- come rappresentato dal RUP, le impostazioni della piattaforma STELLA non permettono di inserire a sistema più di un soggetto abilitato all'apertura della busta economica; pertanto, è necessario scegliere se l'apertura di tutte le buste economiche (relative ai lotti da aggiudicare sia al prezzo più basso sia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa) debba essere effettuata dal Presidente della Commissione Giudicatrice o dal RUP/Presidente del Seggio di Gara.

Stante l'impossibilità su STELLA di poter individuare più di un soggetto abilitato all'apertura delle buste economiche, il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza anche del RUP procede all'apertura di tutte le buste economiche (anche quelle relative ai lotti da aggiudicare al prezzo più basso).

Successivamente, la Commissione procede, per le offerte relative ai lotti da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla valutazione della documentazione ivi contenuta, dando evidenza su piattaforma STELLA del calcolo dei punteggi economici e della definizione delle relative graduatorie.


Gli esiti di tali operazioni vengono riportate nella tabella che segue.

| Lotto | Fornitore            | Stato Offerta           | Rank | Punteggio Totale | Punteggio Tecnico | Punteggio Economico | Ribasso % |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 3     | TELEFLEX MEDICAL SRL | Aggiudicatario proposto | 1    | 100,00           | 70,00             | 30,00               | 27,18     |
| 3     | Coloplast            | II Classificato         | 2    | 78,43            | 52,25             | 26,18               | 23,72     |
| 4     | Coloplast            | Aggiudicatario proposto | 1    | 94,29            | 70,00             | 24,29               | 48,58     |
| 4     | TELEFLEX MEDICAL SRL | II Classificato         | 2    | 66,00            | 36,00             | 30,00               | 60,00     |
| 4     | ESSEDUE GROUP        |                         | 3    | 51,43            | 50,00             | 1,43                | 2,86      |
| 5     | TELEFLEX MEDICAL SRL | Aggiudicatario proposto | 1    | 100,00           | 70,00             | 30,00               | 14,02     |
| 8     | Coloplast            | Aggiudicatario proposto | 1    | 84,16            | 70,00             | 14,16               | 24,68     |
| 8     | TELEFLEX MEDICAL SRL | II Classificato         | 2    | 80,00            | 50,00             | 30,00               | 52,29     |
| 9     | OLYMPUS ITALIA SRL   | Aggiudicatario proposto | 1    | 83,85            | 55,72             | 28,13               | 66,46     |
| 9     | TELEFLEX MEDICAL SRL | II Classificato         | 2    | 83,57            | 53,57             | 30,00               | 70,87     |
| 9     | ESSEDUE GROUP        |                         | 3    | 71,23            | 70,00             | 1,23                | 2,91      |
| 9     | Coloplast            |                         | 4    | 68,17            | 55,72             | 12,45               | 29,40     |
| 11    | ESSEDUE GROUP        | Aggiudicatario proposto | 1    | 100,00           | 70,00             | 30,00               | 11,70     |

Alle ore 15:13 il Presidente dichiara chiusa la seduta, dando mandato al segretario di trasmettere al RUP il fascicolo di gara, contenente tutti i verbali, per i successivi adempimenti di competenza.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Seggio di Gara nel modo che segue:


Presidente  
Dr. Maurizio Ombres

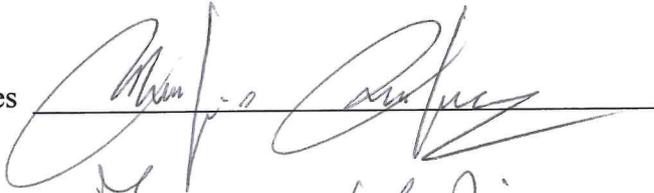

Componente  
Dr. Mario Ciletti



Componente con funzione di verbalizzante  
Dr. Simone Pagliarino

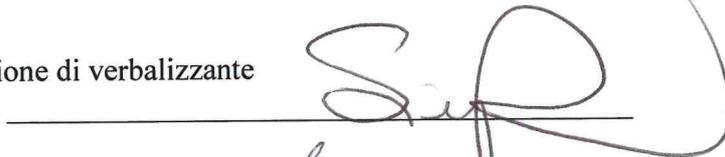

Il RUP  
Dott. Matteo Palmieri

