

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. AQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1437 del 30 LUG. 2018

**Oggetto:** Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Pentax Italia S. r. l. della fornitura e posa in opera di un video broncoscopio da destinare alla U.O.C. di Pneumologia del P. O. di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 21.886,80 IVA inclusa. CIG: ZE8246842D

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Estensore

Dott. Scossa Cristian

Firma

Data

20 LUG. 2018

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma

Data

20 LUG. 2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa PATRIMONIALE 101020504 - AUT. 18.22/2018 PROVV. 310

Data

23/07/2018

Firma

Dott.ssa Barbara Proietti

**Oggetto:** Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Pentax Italia S. r. l. della fornitura e posa in opera di un video broncoscopio da destinare alla U.O.C. di Pneumologia del P. O. di Rieti.  
Importo complessivo pari ad € 21.886,80 IVA inclusa. CIG: ZE8246842D

Pag. 2 di 4

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

### IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

**PREMESSO** che la Dott.ssa Rita Le Donne, in qualità di primario della U.O.C. di Pneumologia del P. O. San Camillo De Lellis di Rieti, ha inoltrata richiesta di un video broncoscopio da destinare alla U.O.C. di Pneumologia del P. O. di Rieti (All. n. 1);

**TENUTO CONTO** che con atto deliberativo n. 1537/D.G. del 22.12.2016 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di staff "Ingegneria Clinica" che comprende il ruolo di D.E.C dei contratti attivi ed da attivare relativi alla fornitura, la gestione e la manutenzione delle tecnologie biomediche aziendali, nonché di supporto alla UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ai fini dell'espletamento delle relative procedure di gara e stipula dei contratti;

**VISTO** che quest'Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature congiuntamente all' aggiornamento del proprio parco elettromedicale ai fini di un corretta risposta diagnostico - terapeutica nei confronti dell' utenza;

**VISTA** la nota protocollo 18047 del 11/04/2018 (All. n 2) trasmessa dall' Ingegneria clinica alla UOC ALBS con la quale si richiede alla direzione Amministrativa l' autorizzazione per procedere all' acquisto;

**DATO ATTO** che la risposta affermativa da parte dell' allora Direttore sanitario è arrivata in data 23/04/2018 come riportato nella nota protocollo sopracitata;

**VISTO** il preventivo (All. n 3) inviato dalla società società Pentax Italia S. r. l. della fornitura e posa in opera di un video broncoscopio da destinare alla U.O.C. di Pneumologia del P. O. di Rieti, che ammonta ad € 21.886,80 IVA inclusa ;

**PRESO ATTO** che quest'Azienda al fine di garantire il normale svolgimento delle attività diagnostiche e terapeutiche, ha affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla società Pentax Italia S. r. l. della fornitura e posa in opera di un video broncoscopio da destinare alla U.O.C. di Pneumologia del P. O. di Rieti;

**DATO ATTO** che il RUP ha ritenuto economicamente vantaggioso il preventivo sopra indicato;

**DATO ATTO** che l'acquisto di tali dispositivi e servizi, di cui alla presente determina viene effettuato con risorse di parte corrente;

**Oggetto:** Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2; lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Pentax Italia S. r. l. della fornitura e posa in opera di un video broncoscopio da destinare alla U.O.C. di Pneumologia del P. O. di Rieti.  
Importo complessivo pari ad € 21.886,80 IVA inclusa. CIG: ZE8246842D

Pag. 3 di 4

~~DATO ATTO~~ che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;


### DETERMINA

1. DI PROCEDERE all' Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Pentax Italia S. r. l. della fornitura e posa in opera di un video broncoscopio da destinare alla U.O.C. di Pneumologia del P. O. di Rieti. Importo complessivo pari ad € 21.886,80 IVA inclusa;
2. DI DARE ATTO che l'onere del presente provvedimento, pari ad € 21.886,80 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 101020501 – attrezzature sanitarie e scientifiche – bilancio anno 2018;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Direttore della U.O.C.  
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
Dott. Luciano Quattrini

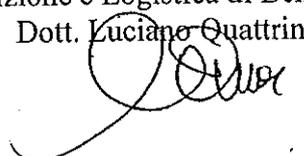

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 30 LUG. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 30 LUG. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

in oggetto  per esteso

30 LUG. 2018

Rieti li 30 LUG. 2018

IL FUNZIONARIO

[Handwritten Signature]

ALL. 1 PAG. 1

## MODULO PER LA RICHIESTA DI ACQUISTO O SOSTITUZIONE DI UNA TECNOLOGIA O APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE IN EMERGENZA

N° di Prot. \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il presente modulo va compilato dal Direttore/Dirigente della UO richiedente o dal Direttore di Dipartimento/P.O./Distretto

Struttura <span style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">OAP Rieti</span>	Unità Operativa <span style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">PNEUMOLOGIA</span>
Richiedente <span style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">RITA LE BONNE</span>	Telefono / Fax <span style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">3683883820/0746278586</span>

### 1. TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA/TECNOLOGIA RICHIESTA

1.1 Denominazione scientifica:

VIDEO BRONCOSCOPIO PENTAX COME DA  
SCHEMA TECNICA ALLEGATA

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

2.1 Specifiche tecniche minime:

VEDI SCHEMA TECNICA ALLEGATA

2.2 Specifiche tecniche delle attrezzature a supporto/completamento dell'apparecchiatura richiesta.  
(Indicare in questo spazio le caratteristiche tecniche di eventuali accessori e/o di hardware/software.)

---

---

---

---


2.3 Integrazione/collegamento con altra strumentazione o sistemi informatici.  
(Specificare l'eventuale infungibilità dell'apparecchio rispetto a strumenti già installati e/o a sistemi esistenti.)

---

---

---

---

ALL 1 PAG. 2

## 3. CARICO DI LAVORO (solo nel caso di sostituzione)

## 3.1 Storico delle prestazioni effettuate

Codice	Descrizione	Periodo (mm/aa)	Ore attività settimanali	N° prestaz. Interne rese in un anno	N° prestaz. Esterne rese in un anno

## 3.2 Prestazioni previste → INIZIO ATTIVITA' CON PERSONALE DEDICATO

Codice	Descrizione	Periodo (mm/aa)	Ore attività settimanali	N° prestaz. Interne rese in un anno	N° prestaz. Esterne rese in un anno

## 3.3 Lista d'attesa

N° giorni di attesa per prestazione: \_\_\_\_\_

## 3.4 Eventuale riutilizzo in azienda dell'apparecchiatura guasta o obsoleta

No    Si    Nuova Destinazione: \_\_\_\_\_

4. MOTIVAZIONI DELLA

4.1 Sostituzione

4.2 Integrazione/Completamento

4.3 Nuova

4.4 Specificare e descrivere le motivazioni dell'urgenza della richiesta:

ATTIVAZIONE PERCORSO POLMONARE RIFERITO  
ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE ONCOLOGICA  
DEL CANCRO DEL POLMONE

5. MODALITÀ PROPOSTA PER L'ACQUISIZIONE

5.1 Acquisto

5.2 Service/Comodato

5.3 Noleggio/Locazione/Leasing

5.5 Donazione

5.4 Sperimentazione, ricerca, didattica

5.6 Altro (specificare)

6. DATI APPARECCHIO DA SOSTITUIRE (Compilare solo in caso di sostituzione)

6.1 Marca \_\_\_\_\_ 6.2 Modello \_\_\_\_\_

6.3 Numero di serie \_\_\_\_\_ 6.4 Numero di inventario \_\_\_\_\_

6.5 Motivazione (allegare eventuale richiesta di fuori uso):

Fuori uso

7. MIGLIORAMENTI TECNICO/FUNZIONALI OTTENIBILI CON L'APPARECCHIATURA RICHIESTA

7.1 Benefici all'utenza

ATTIVAZIONE DI PERCORSO DIAGNOSTICO E FOLLO  
PO DEL PAZIENTE NEOPLASTICO

7.2 Benefici per gli utilizzatori

7.3 Benefici per l'Azienda

BENEFICI LEGATI ALL'INCREMENTO DELLA TIPO  
E COMPLESSITA' DELLE PRESTAZIONI ESEGU  
CON RITORNO BENEFICIALE

OP

per

ALL 1 PAG. 4

## 8. SPECIFICHE PER LA MESSA IN FUNZIONE DELL'APPARECCHIATURA RICHIESTA

8.1 Ubicazione dell'apparecchiatura

Oc P Retti'8.2 Sono necessari lavori di adeguamento/ristrutturazione dei locali? SI  NO 8.3 Sono previsti collegamenti con altre UU.OO. per l'utilizzo della nuova apparecchiatura? SI  NO In caso affermativo, specificare quali UU.OO.: ORL - GASTROENTEROLOGIA- quali collegamenti: LOGISTICI- le professionalità coinvolte: MEDICO - INFERMIERE

Il Direttore UO richiedente

Data:   /  /  Nome e Cognome:  
In stampatelloRITA LE DONNE

Firma:

Rita Leone

Autorizzazione della Direzione Generale


Data:   /  /  Nome e Cognome:  
In stampatelloSi autorizza  
Timbro e Firma:

ALL 1 PAG. 5

**PENTAX**  
**MEDICAL**

PENTAX Italia s.r.l.  
con Unico Socio  
Via Dione Casslo, 15  
20138 Milano - Italy  
Tel. 02.50.99.58.1  
Fax 02.50.399.58.60  
www.pentaxmedical.com

**SCHEDA TECNICA N.4532**  
**EB19-J10 VIDEOBRONCOSCOPIO OPERATIVO PENTAX**

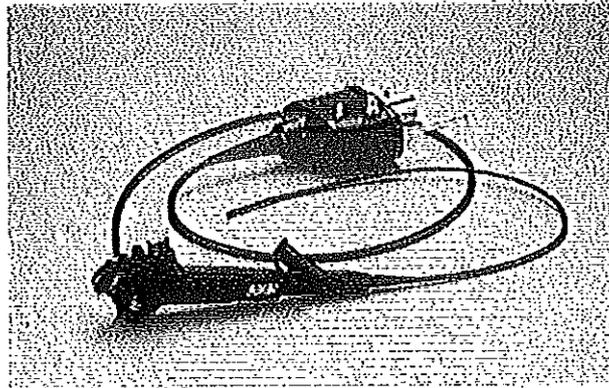

**Distributore Italia**

Pentax Italia, Via Dione Casslo 15- 20138 Milano

**Produttore**

Hoya Corporation, Giappone

**Anno di Immissione In commercio**

2016

**CND:** Z12020802

**RDM:** 1434763

OK  
pen

ALL 1 PAG. 6

# PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l.  
con Unico Socio  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano - Italy  
Tel. 02.50.99.58.1  
fax 02.50.399.58.60  
www.pentaxmedical.com

## Destinazione d'uso

Il videobroncoscopio PENTAX EB19-J10 è stato progettato per la visione, la diagnosi ed il trattamento delle vie aeree e dei polmoni.

## Descrizione


Il sistema PENTAX DEFINA, costituito dal videoprocessore PENTAX Epk-3000 in abbinamento con i videobroncoscopi della serie J10, è un valido supporto per il clinico in quella che oggi rappresenta la principale sfida in pneumologia:

- identificazione e la demarcazione precoce di alterazioni a carico dell'epitelio
- corretta caratterizzazione delle anomalie identificate è essenziale per una efficace terapia

## HD e Illuminazione

Il videobroncoscopio HD PENTAX EB19-J10 fornisce un valido supporto nella valutazione dei dettagli anatomici della mucosa bronchiale e nell'analisi di eventuali lesioni superficiali.

- Tecnologia HD: fornisce immagini chiare e ricche di dettagli
- Eccellente illuminazione: consente un migliore orientamento all'interno del sistema bronchiale e l'identificazione di eventuali lesioni della superficie mucosa

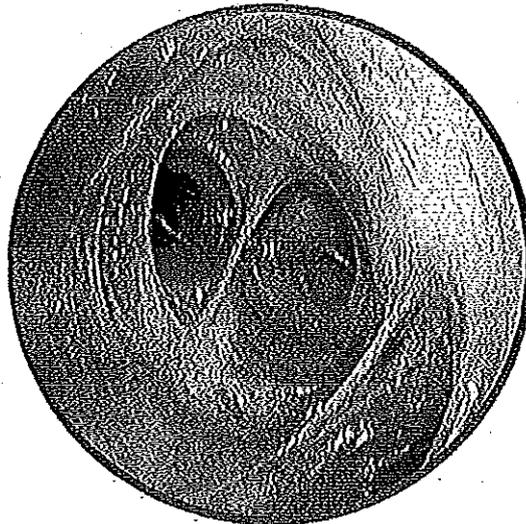

ALL 1 PAG. 7

# PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l.  
con Unico Socio  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano - Italy  
Tel. 02.50.99.58.1  
Fax 02.50.399.58.60  
www.pentaxmedical.com

## Tecnologia I-scan

La tecnologia I-scan, è una tecnica di imaging avanzata, basata sull'utilizzo di algoritmi, che consente la rielaborazione dell'immagine in tempo reale agendo sulla luce riflessa.

- I-scan 1: Supporta il medico nell'individuazione di eventuali lesioni
- I-scan 2: Supporta il medico nella demarcazione e nella caratterizzazione della lesione
- I-scan 3: Supporta il medico nella caratterizzazione della lesione e nella identificazione di regioni sicure in cui effettuare la biopsia



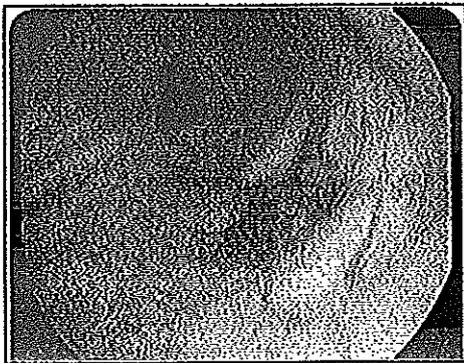



Immagine HD

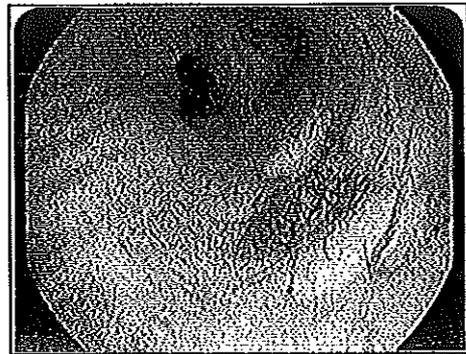

I-scan 1

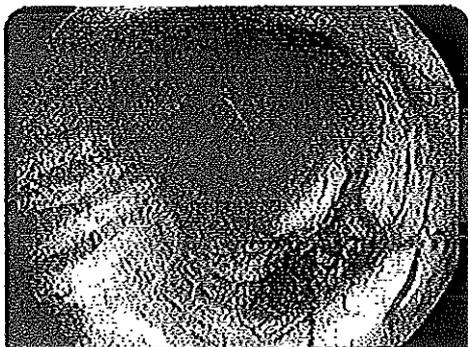

i-scan 2

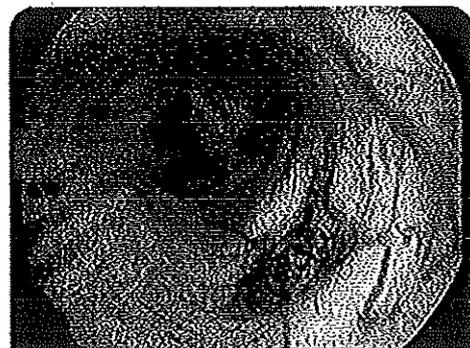

I-scan 3



ALL 1 PAG 8

# PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l.  
con Unico Socio  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano - Italy  
Tel. 02.50.99.58.1  
Fax 02.50.399.58.60  
www.pentaxmedical.com

## Ergonomia e Design

- Elevata flessibilità del tubo di inserzione: conferisce al videobroncoscopio HD PENTAX EB19-J10 un'eccellente manovrabilità
- Flessione del tratto distale fino a 210°: consente di raggiungere agevolmente il lobo superiore destro
- Valvola ridisegnata: consente un più facile inserimento degli accessori attraverso il canale operativo
- Nuovo control body: più leggero ed ergonomico, facilita la gestione dell'EB19-J10 durante la procedura endoscopica

## Sicurezza

Negli ultimi anni la sicurezza è stata argomento di numerosi dibattiti per via delle numerose controversie legali legate alla disinfezione. Ciò ha portato le aziende produttrici a sviluppare soluzioni innovative per la gestione di questo aspetto estremamente delicato:

- Valvole di aspirazione usa e getta: grazie al meccanismo "turn & click" rimangono saldamente fissate alla propria sede evitando sgradevoli contrattempi durante la procedura endoscopica
- Compatibilità con STERRAD: maggiore sicurezza per il paziente grazie all'eliminazione di Micobatteri farmaco-resistenti

## Compatibilità

Il videobroncoscopio HD PENTAX EB19-J10 è compatibile con

- I videoprocessori PENTAX EPK-I7010, EPK-I7000, EPK-I5000, EPK-I, EPK-3000, EPK-1000 ed EPK-100p
- con laser (YAG e a diodi) e con l'elettrochirurgia.



ALL 1 PAG 9

# PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l.  
con Unico Socio  
Via Dione Caslo, 15  
20138 Milano - Italy  
Tel. 02.50.99.58.1  
Fax 02.50.399.58.60  
www.pentaxmedical.com

## Caratteristiche tecniche

Codice	EB19-J10
Amplezza campo di visione	120°
Profondità campo di visione	3-100 mm
Flessibilità distale alto - basso	180/130°
Diametro tratto rigido distale	6.1 mm
Diametro tubo d'inserzione	6.4 mm
Diametro canale operativo	2.8 mm
Lunghezza utile inseribile	600 mm
Lunghezza complessiva	860 mm

### Rispondenza alle normative - classificazione

Prodotto marchiato CE0123  
Direttiva CEI 62-5 - classe I tipo BF  
Direttiva CE 89/336/EEC  
Direttiva CE 93/42/EEC - classe IIa

### Condizioni di stoccaggio

Temperatura ambiente: -20 - 60 °C  
Umidità relativa: 0 - 85%  
Pressione dell'aria: 700 - 1060 hPa

Servizio di assistenza Pentax Italia - Milano

LC 04/16 - Rev. 00

ALL 1 PAG 10


**PENTAX**  
**MEDICAL**

PENTAX Italia con Socio Unico  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano - Italy  
Tel. 02.50.99.68.1  
Fax 02.50.99.68.60  
www.pentaxmedical.it

**PULSANTI MONOUSO per videoendoscopi serie J10**

**CND**  
Z129080

**RDM**  
1490955

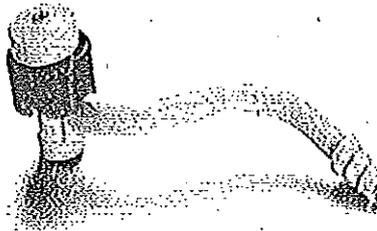


**Articolo Descrizione**

**OF-B205 PULSANTE ASPIRAZIONE monouso per EB e VNL serie J10**

**Utilizzo**

1. Posizionare il pulsante all'interno del suo alloggiamento orientandolo correttamente utilizzando l'apposito indicatore
2. Premere il pulsante per aspirare i fluidi attraverso il canale operativo dell'endoscopio
3. Rimuovere il pulsante ruotandolo in senso orario e tirandolo verso l'alto
4. Smaltire il pulsante monouso

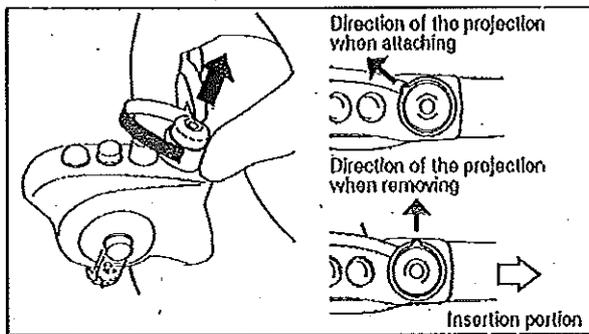

OK per

I pulsanti OF-B205, sterili e confezionati singolarmente, sono venduti in scatole da 10 o 100pz (cod. OF-B205/100)

lg

ALL 7 PAG. 17

PENTAX Italia s.r.l.  
con Unico Socio  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano - Italy  
Tel. 02.50.99.58.1  
Fax 02.50.99.58.60  
www.pentaxmedical.com

Cod. 432600

Spett.le  
AZIENDA U.S.L. RIETI  
VIA DEL TERMINILLO, 42  
02100 RIETI RI

Milano 09/01/2018

**Oggetto: Dichiarazione di esclusività**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli**  
**artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000**

Il sottoscritto Massimo Albertoni, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 26.09.1973 e residente in Sesto San Giovanni (MI) Via.le Italia n. 130, nella qualità di Procuratore della Società PENTAX Italia S.r.l. con Unico Socio, con sede legale e amministrativa in Milano, Via Dione Cassio 15, cod. fiscale e partita IVA 11159150157, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 11159150157 dal 19/02/1996 R.E.A. n. 1440458 dal 25/03/1994, codice attività 51462, ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente in Milano Via Abetone 10


in nome e per conto della stessa sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di affermazioni false e mendaci (Art. 76 del T. U. n. 445 del 28/12/2000),

Dichiara

Che l'apparecchiatura - Codice EB19-J10 Descrizione VIDEOBRONCOSCOPIO OPERATIVO- è distribuito in esclusiva dalla nostra Società ed appartiene all'unica gamma di Videobroncoscopi in commercio dotati delle caratteristiche di compatibilità con i Videoprocessori Pentax modelli EPKi/EPK-5000.

Non sono posti in vendita da altre Ditte prodotti aventi caratteristiche della suddetta Strumentazione.

In fede.

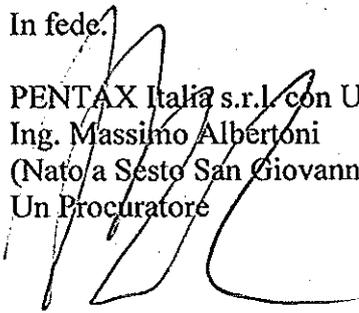  
PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio  
Ing. Massimo Albertoni  
(Nato a Sesto San Giovanni (MI) il 26.09.1973)  
Un Procuratore





ASL RIETI

ALL 2



REGIONE  
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Servizio di Ingegneria Clinica

Prot. 18047

Rieti, 11/04/2018

Direttore Sanitario  
Dott.<sup>SSN</sup> Velia Bruno

e p/c Responsabile UOC Pneumologia  
Dott.<sup>SSA</sup> Rita Le Donne

Dirigente UOC A.B.S.  
Dott. Luciano Quattrini

Direttore Generale  
Dott.<sup>SSA</sup> Marinella D'Innocenzo

Oggetto: richiesta autorizzazione per l'acquisto di un broncoscopio da destinare al Reparto di Pneumologia del PO di Rieti

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, in data 11/04/2018, con il Direttore Generale e alla richiesta inviata dalla Dott.<sup>SSA</sup> Rita Le Donne, si chiede l'autorizzazione per procedere all'acquisto di un broncoscopio da destinare al Reparto di Pneumologia del PO di Rieti.

In allegato alla presente si trasmette:

1. copia della richiesta inviata dalla Dott.ssa Rita Le Donne;
2. caratteristiche tecniche del Videobroncoscopio richiesto e del pulsante funzionale;
3. dichiarazione di esclusività della Società Pentax;
4. preventivo per l'acquisto di un broncoscopio.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica  
Ing. Ermilio Pace

23/04/2018

Toru all'Ing.  
Pace

Coll. Tecnico Ing. Marco Risa

ALL 3 PAG 1

Cod. 432600

Spett.le  
AZIENDA U.S.L. RIETI  
VIA DEL TERMINILLO, 42  
02100 RIETI RI

Milano 27/01/2017

alla c.a. Dr. Giuseppe Chiani

Ns. Rif. 041505/TD/M72

**Oggetto: Offerta per la fornitura di un Videobroncoscopio Pentax**

La presente per sottoporVi la nostra migliore offerta per i prodotti sottoelencati

Codice **EB19-J10** Descrizione **VIDEOBRONCOSCOPIO OPERATIVO**

Quantità offerta pezzi n. 1

Prezzo unitario di listino €. 23.000,00

Sconto 25% (Venticinque%)

Prezzo/unitario offerto €. 17.250,00

Codice CND: Z12020802

N° Repertorio: 1434763

Codice **OF-B205/100** Descrizione **PULSANTE ASPIRAZ.J10(100 PZ MONOUSO**

Quantità offerta pezzi n. 1

Prezzo unitario di listino €. 920,00

Sconto 25% (Venticinque%)

Prezzo/unitario offerto €. 690,00

**Totale fornitura €. 17.940,00 + IVA**

**Condizioni di fornitura:**

Validità offerta: 60 gg

Consegna: 60 gg

Collaudo: a ns carico entro 10 gg. data consegna

Minimo fatturabile: Euro 260,00

Spese di spedizione: a ns carico

Porto: franco Imballo: Gratis

Pagamento: R.D. 60 gg. d.f. f.m.

IVA di legge a Vs. carico: 22%

Garanzia: 12 (dodici) mesi



ALL 3 PAG. 2

*In caso di ordine: riportare il ns riferimento (numero offerta) sopra specificato*

*Fax dove inviare future richieste di offerta ed eventuali ordini: n. 02.50995847*

RingraziandoVi per l'attenzione prestataci, è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio  
Ing. Massimo Albertoni  
(Nato a Sesto San Giovanni (MI) il 26.09.1973)  
Un Procuratore

