

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari
(Decreto Presidente Regione Lazio n.T00043 del 24/05/2023)
Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 26/05/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 691/C.S./2024 del 12/07/2024

STRUTTURA PROPONENTE

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico telecomandato, da destinare alla U.O.C. Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 239.955,00 al netto dell'IVA, indetta con atto deliberativo n. 495/C.S./2023 del 07.11.2023, parzialmente modificata con deliberazione n. 700/CS/2023 del 28/12/2023. Numero gara 9402342 – CIG: A0249B8A84. Presa d'atto e approvazione dei verbali del Seggio di Gara e della Commissione di Gara. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico BIESSE MEDICA S.R.L. Importo complessivo di affidamento pari ad € 210.008,62 (IVA esclusa).

Estensore: Dott.ssa Cammarata Elena

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Teodori Roberta

Data 08/07/2024 Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Il Dirigente: Dott.ssa Teodori Roberta

Data 08/07/2024 Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020501

Autorizzazione: PROV. 361 - AUT. 160.44/2024

Data 10/07/2024 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 12/07/2024

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Angelo Barbato

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 12/07/2024

Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico telecomandato, da destinare alla U.O.C. Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 239.955,00 al netto dell'IVA, indetta con atto deliberativo n. 495/C.S./2023 del 07.11.2023, parzialmente modificata con deliberazione n. 700/CS/2023 del 28/12/2023. Numero gara 9402342 – CIG: A0249B8A84. Presa d'atto e approvazione dei verbali del Seggio di Gara e della Commissione di Gara. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico BIESSE MEDICA S.R.L. Importo complessivo di affidamento pari ad € 210.008,62 (IVA esclusa).

**IL RESPONSABILE DELLA
UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

PREMESSO CHE:

- con atto deliberativo n. 495/C.S./2023 del 07.11.2023 è stata indetta “*procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico telecomandato, da destinare alla U.O.C. Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 239.955,00 al netto dell'IVA. Numero gara 9402342 – CIG: A0249B8A84*”, approvandone i relativi atti di gara;
- con il medesimo atto, sono stati individuati, quale Responsabile Unico del Progetto, la Dott.ssa Roberta Teodori – Responsabile della UOC Acquisizione Logistica di Beni e Servizi e quale Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione della gara, l'Ing. Daniele Della Vedova – Responsabile della U.O.S.D. Ingegneria Clinica;
- il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 16/11/2023 (numero dell'avviso nella GU S: 2023/S 224-705803 del 21/11/2023) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 135 del 22/11/2023, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale individuati;
- gli atti relativi alla procedura sono stati pubblicati sul sito aziendale e sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio con Registro di Sistema n. PI150804-23;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 30/01/2024 ore 12:00;
- con atto deliberativo n. 700/CS/2023 del 28/12/2023, questa Azienda ha proceduto alla modifica parziale degli atti di gara e alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte, in particolare sono state apportate le modifiche ai seguenti atti: Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'Appalto;
- con il medesimo atto:
 - è stato confermato, quale Responsabile Unico del Progetto, la Dott.ssa Roberta Teodori – Responsabile della UOC Acquisizione Logistica di Beni e Servizi;
 - è stato nominato, quale Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione della gara, in sostituzione dell'Ing. Daniele Della Vedova – Responsabile della U.O.S.D. Ingegneria Clinica, il Dott. Stefano Canitano, Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini;
- nel rispetto delle prescrizioni fornite da ANAC con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, l'avviso di rettifica e proroga termini è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea il 29/12/2023 (n. dell'avviso 2304-2024) e pubblicato in GUUE il 03/01/2024;
- sono stati pubblicati gli atti modificati sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio e sul sito aziendale, con proroga della scadenza delle offerte prevista per il giorno 09/02/2024 ore 12.00 e data di apertura delle offerte in seduta pubblica virtuale in data 12/02/2024;
- entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta n. 6 (sei) operatori economici, agli atti del Fasciolo telematico del S.TEL.LA., come da seguente prospetto:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	04785851009	IT12268050155	PI019602-24	07/02/2024 14:40:44
ASSING S.p.A.	06725640582	IT01603091008	PI020226-24	08/02/2024 14:19:46
BIESSE MEDICA	04409721000	IT04409721000	PI020239-24	08/02/2024

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico telecomandato, da destinare alla U.O.C. Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 239.955,00 al netto dell'IVA, indetta con atto deliberativo n. 495/C.S./2023 del 07.11.2023, parzialmente modificata con deliberazione n. 700/CS/2023 del 28/12/2023. Numero gara 9402342 – CIG: A0249B8A84. Presa d'atto e approvazione dei verbali del Seggio di Gara e della Commissione di Gara. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico BIESSE MEDICA S.R.L. Importo complessivo di affidamento pari ad € 210.008,62 (IVA esclusa).

				14:27:38
General Medical Merate S.p.A.	00225500164	IT00225500164	PI020347-24	08/02/2024 15:37:08
TRADE ART 2000 S.P.A.	04607611003	IT04607611003	PI020419-24	08/02/2024 16:01:27
METALTRONICA	02833590587	IT01123731000	PI020639-24	09/02/2024 09:49:03

- con Determinazione Dirigenziale n. 364/2024 del 12/02/2024, è stato nominato il Seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa presieduto dal RUP, come di seguito composto:
 - Dott.ssa Roberta Teodori, Responsabile della U.O.C. ALBS, nella qualità di RUP/Presidente;
 - Dott.ssa Elena Cammarata, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone verbalizzante;
 - Dott.ssa Eleonora Franceschini, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone;
- con deliberazione n. 257/C.S./2024 del 15/03/2024, ai sensi degli art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento delle operazioni di gara concernenti la valutazione delle offerte tecniche e la successiva apertura delle offerte economiche, come di seguito composta:
 - Prof. Vito Cantisani, Direttore U.O.C. Teleradiodiagnostica – ASL Rieti (Presidente);
 - Dott. Marco Savi, TSRM in servizio presso la U.O.C. Diagnostica per Immagini – ASL Rieti (Commissario);
 - Dott. Marco Castrogiovanni, TSRM in servizio presso la U.O.C. Diagnostica per Immagini – ASL Rieti (Commissario);
- in data 05/04/2024, terminati i lavori del seggio di gara, è stato comunicato a ciascun concorrente l'esito della verifica amministrativa;
- in pari data, su indicazione del Presidente della Commissione, è stato comunicato ai concorrenti la data della seduta pubblica virtuale di apertura delle buste tecniche fissata per il giorno 17/04/2024 ore 10:00 e ss.

VISTE le comunicazioni obbligatorie dei componenti del Seggio di Gara, relative all'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, astensione e di conflitti di interesse, agli atti della struttura;

PRESO ATTO dei lavori svolti dal Seggio di Gara come si evince dai verbali redatti dallo stesso, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**);

VISTE le comunicazioni obbligatorie dei componenti della Commissione di Gara, relative all'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, astensione e di conflitti di interesse, agli atti della struttura;

PRESO ATTO dei lavori svolti dalla Commissione di Gara come si evince dai verbali redatti dalla stessa, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 2**);

PRESO ATTO dell'attività di verifica ex art. 110 del D. Lgs. 36/2023, condotta dal RUP ed esitata nei verbali che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 3**);

PRESO ATTO della graduatoria risultante all'esito delle predette attività, di seguito riportata:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico telecomandato, da destinare alla U.O.C. Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 239.955,00 al netto dell'IVA, indetta con atto deliberativo n. 495/C.S./2023 del 07.11.2023, parzialmente modificata con deliberazione n. 700/CS/2023 del 28/12/2023. Numero gara 9402342 – CIG: A0249B8A84. Presa d'atto e approvazione dei verbali del Seggio di Gara e della Commissione di Gara. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico BIESSE MEDICA S.R.L. Importo complessivo di affidamento pari ad € 210.008,62 (IVA esclusa).

Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Base d'asta	Ribasso %
BIESSE MEDICA	1	93,79	90,00	3,79	239955	12,48
TRADE ART 2000 S.P.A.	2	90,63	83,67	6,96	239955	22,90
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	3	88,14	78,14	10,00	239955	32,90
General Medical Merate S.p.A.	4	84,39	79,83	4,56	239955	14,99
METALTRONICA	5	78,65	74,39	4,26	239955	14,00
ASSING S.p.A.	6	75,36	70,22	5,14	239955	16,90

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara *de qua*;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, prendere atto ed approvare i verbali di gara relativi alla procedura in oggetto e, pertanto, aggiudicare la presente procedura di gara - ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, come di seguito riportato:

Oggetto del lotto	CIG	Aggiudicatario	Importo aggiudicazione (IVA esclusa)
TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO	A0249B8A84	BIESSE MEDICA S.R.L.	210.008,62 €

PRESO ATTO dell'esito positivo dei controlli effettuati sul portale dedicato A.N.A.C. FVOE 1.0, nei confronti dell'operatore economico risultato primo in graduatoria;

VISTI gli articoli 84 e 85 del Codice che dispongono la pubblicazione dell'esito della gara, a livello europeo, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - di seguito GUUE e, a livello nazionale, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante;

RITENUTO pertanto, di procedere alla conferma, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023:

- della Dott.ssa Roberta Teodori (Dirigente Amministrativo) responsabile della la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi, nelle funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- del Dott. Stefano Canitano, Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini, nelle funzioni di Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione della gara;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse al presente atto che qui si intendono integralmente richiamate;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico telecomandato, da destinare alla U.O.C. Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 239.955,00 al netto dell'IVA, indetta con atto deliberativo n. 495/C.S./2023 del 07.11.2023, parzialmente modificata con deliberazione n. 700/CS/2023 del 28/12/2023. Numero gara 9402342 – CIG: A0249B8A84. Presa d'atto e approvazione dei verbali del Seggio di Gara e della Commissione di Gara. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico BIESSE MEDICA S.R.L. Importo complessivo di affidamento pari ad € 210.008,62 (IVA esclusa).

2. DI APPROVARE i verbali dei lavori del Seggio di gara e della Commissione di Gara, che allegati al presente atto (all. 1, 2 e 3), ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. DI AGGIUDICARE la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico telecomandato, da destinare alla U.O.C. Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti, indetta con atto deliberativo n. 495/C.S./2023 del 07.11.2023 e parzialmente modificata con deliberazione n. 700/CS/2023 del 28/12/2023, alla ditta BIESSE MEDICA S.R.L. (C.F. 04409721000; P.IVA IT04409721000), come di seguito riportato:

Oggetto del lotto	CIG	Aggiudicatario	Importo aggiudicazione (IVA esclusa)
TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO	A0249B8A84	BIESSE MEDICA S.R.L.	210.008,62 €

4. DI STABILIRE che l'impegno di spesa complessivo del presente appalto, inclusi i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza, è pari a € 210.008,62 oltre IVA;
5. DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 256.210,52 (IVA inclusa 22%), a valere sui fondi aziendali, sul conto di costo n. 101020501 "*attrezzature sanitarie e scientifiche*", esercizio 2024;
6. DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicazione al soggetto interessato;
7. DI PUBBLICARE l'Esito di gara sulla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici e sul sito della ASL di Rieti;
8. DI CONFERMARE, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023:
 - la Dott.ssa Roberta Teodori (Dirigente Amministrativo) responsabile della la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi, nelle funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP);
 - il Dott. Stefano Canitano, Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini, nelle funzioni di Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione della gara;
9. DI DARE ATTO dell'esito positivo dei controlli effettuati sul portale dedicato A.N.A.C. FVOE 1.0, nei confronti degli operatori economici risultati primi in graduatoria;
10. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico telecomandato, da destinare alla U.O.C. Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 239.955,00 al netto dell'IVA, indetta con atto deliberativo n. 495/C.S./2023 del 07.11.2023, parzialmente modificata con deliberazione n. 700/CS/2023 del 28/12/2023. Numero gara 9402342 – CIG: A0249B8A84. Presa d'atto e approvazione dei verbali del Seggio di Gara e della Commissione di Gara. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico BIESSE MEDICA S.R.L. Importo complessivo di affidamento pari ad € 210.008,62 (IVA esclusa).

1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO, DA DESTINARE ALLA U.O.C DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL PO DI RIETI. Numero gara: 9402342

VERBALE N. 1

Il giorno 12/02/2024 alle ore 10:06 presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi dell’ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, si riunisce il Seggio di gara, nominato con determina n. 364 del 12.02.2024, per procedere all’apertura delle buste amministrative relative alla procedura di gara emarginata in oggetto, come di seguito composto:

- Dott.ssa Roberta Teodori, Responsabile della U.O.C. Acquisizione Logistica di Beni e Servizi nella qualità di Responsabile della fase di affidamento/Presidente;
- Dott.ssa Elena Cammarata, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone verbalizzante;
- Dott.ssa Eleonora Franceschini, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone;

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 495/C.S./2023 del 07.11.2023 è stata indetta “procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di un tavolo radiologico telecomandato, da destinare alla U.O.C. Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 239.955,00 al netto dell’IVA. Numero gara 9402342 – CIG: A0249B8A84”, approvandone i relativi atti di gara;
- con il medesimo atto, sono stati individuati, quale Responsabile Unico del Progetto, la Dott.ssa Roberta Teodori – Responsabile della UOC Acquisizione Logistica di Beni e Servizi e quale Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione della gara, l’Ing. Daniele Della Vedova – Responsabile della U.O.S.D. Ingegneria Clinica;
- il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 16/11/2023 (numero dell’avviso nella GU S: 2023/S 224-705803 del 21/11/2023) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 135 del 22/11/2023, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale individuati;
- gli atti relativi alla procedura sono stati pubblicati sul sito aziendale e sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio con Registro di Sistema n. PI150804-23;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 30/01/2024 ore 12:00;
- con atto deliberativo n. 700/CS/2023 del 28/12/2023, questa Azienda ha proceduto alla modifica parziale degli atti di gara e alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte, in particolare sono state apportate le modifiche ai seguenti atti: Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto;



- con il medesimo atto:
 - è stato confermato, quale Responsabile Unico del Progetto, la Dott.ssa Roberta Teodori – Responsabile della UOC Acquisizione Logistica di Beni e Servizi;
 - è stato nominato, quale Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione della gara, in sostituzione dell'Ing. Daniele Della Vedova – Responsabile della U.O.S.D. Ingegneria Clinica, il Dott. Stefano Canitano, Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini;
- nel rispetto delle prescrizioni fornite da ANAC con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, l'avviso di rettifica e proroga termini è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea il 29/12/2023 (n. dell'avviso 2304-2024) e pubblicato in GUUE il 03/01/2024;
- sono stati pubblicati gli atti modificati sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio e sul sito aziendale, con proroga della scadenza delle offerte prevista per il giorno 09/02/2024 ore 12.00 e data di apertura delle offerte in seduta pubblica virtuale in data 12/02/2024.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale

nel giorno e nell'ora predetti, il RUP, Dott.ssa Roberta Teodori, dichiara aperta la seduta pubblica virtuale sulla Piattaforma S.TEL.LA

Il RUP ed i testimoni, preso atto dell'oggetto dell'appalto e degli operatori economici partecipanti alla procedura, come risultanti dalla piattaforma di negoziazione S.TEL.LA., dichiarano ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., l'inesistenza di cause di inconfiribilità (art. 35 bis D. Lgs. n. 165/2011 e ss.mm.ii.) e di conflitto di interessi, ai fini di quanto previsto dagli articoli 16, 93, comma 5 del D.lgs. 36/2023 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 nonché dal Codice di Comportamento aziendale (approvato con Deliberazione n. 658 del 19/12/2023) e dal Piano triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza vigente, come risulta dalle dichiarazioni agli atti.

Il RUP da atto che entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta n. 6 (sei) operatori economici, agli atti del Fasciolo telematico del S.TEL.LA., come da seguente prospetto:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	04785851009	IT12268050155	PI019602-24	07/02/2024 14:40:44
ASSING S.p.A.	06725640582	IT01603091008	PI020226-24	08/02/2024 14:19:46
BIESSE MEDICA	04409721000	IT04409721000	PI020239-24	08/02/2024 14:27:38
General Medical Merate S.p.A.	00225500164	IT00225500164	PI020347-24	08/02/2024 15:37:08
TRADE ART 2000 S.P.A.	04607611003	IT04607611003	PI020419-24	08/02/2024 16:01:27
METALTRONICA	02833590587	IT01123731000	PI020639-24	09/02/2024 09:49:03

Il RUP da atto che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 15.1 del Disciplinare di gara, tutti gli operatori economici concorrenti in gara hanno fatto pervenire entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle offerte, il plico che deve comprendere il CD/DVD non riscrivibile o supporto rimovibile USB contenente le Bioimmagini in formato DICOM, il set informativo e il report di dose di ciascuna immagine (Radiation Dose Structured Report, RDSR) in formato pdf e il CD/DVD non

riscrivibile o supporto rimovibile USB contenente i Video demo in formato mp4, come da documentazione agli atti.

Il RUP da, altresì, atto che l'operatore economico Biesse Medica S.r.l., in data 07/02/2024 ha ritirato il plico consegnato in data 05/02/2024 h.13:00 ed acquisito al protocollo aziendale n. 9735/2024, provvedendo, in pari data, al deposito di altro plico consegnato sempre entro il termine prescritto dal Disciplinare di gara, come da documentazione agli atti.

Il RUP procede quindi all'apertura delle buste amministrative dei concorrenti sopra elencati e al successivo download della documentazione ivi presente.


Conclusa tale attività, il RUP, alle ore 10:27 dichiara chiusa la seduta pubblica virtuale e rinvia a data da destinarsi la seduta riservata per i lavori di esame della documentazione amministrativa contenuta in ciascuna busta.

L.C.S.

Il RUP, Dott.ssa Roberta Teodori



Il testimone verbalizzante, Dott.ssa Elena Cammarata



Il testimone, Dott.ssa Eleonora Franceschini



UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Responsabile: Dott.ssa Roberta Teodori
Tel. 0746-279540 - e-mail: r.teodori@asl.rieti.it

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO, DA DESTINARE ALLA U.O.C DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL PO DI RIETI.

Numero gara: 9402342

VERBALE n. 2

Il giorno **14/02/2024 alle ore 10:00** presso la U.O.C. ALBS della ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, si riunisce, in seduta riservata, il Seggio di Gara della procedura indicata in epigrafe, che dà inizio alla verifica di conformità della documentazione contenuta in ciascuna busta amministrativa presentata dagli operatori economici, nell’ordine di seguito riportato.

1. GENERAL MEDICAL MERATE SPA

La documentazione amministrativa prodotta dalla General Medical Merate spa risulta conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara.

La società partecipa alla gara come impresa singola.

Dichiara di ricorrere al subappalto per la seguente prestazione/i: *eventualmente per lavori impiantistici e di approntamento della nuova sala radiologica, trasporto, formazione, collaudo e assistenza tecnica, in garanzia e post garanzia, dell'apparecchiatura offerta entro il 30,00% o comunque nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni e normative.*

Ha presentato PassOE n. 5063-0552-1944-1309.

Ha correttamente proceduto al pagamento del contributo ANAC.

Ha allegato verbale di sopralluogo, effettuato in data 10/01/2024, ore 10:00.

Ha presentato regolare garanzia provvisoria, ridotta ex art. 9, 7° capoverso, lett. a) del Disciplinare di gara e 106 comma 8 del d. lgs. n. 36/2023.

Ha prodotto certificazione UNI CEI ISO 9001.

Dichiara di applicare al personale dipendente impiegato nell’appalto il CCNL indicato dalla stazione appaltante.

1. BIESSE MEDICA

La documentazione amministrativa prodotta dalla Biesse Medica **NON** risulta **CONFORME** alle prescrizioni del disciplinare di gara in ragione:

- del mancato annullamento del contrassegno della marca da bollo;
- dell’erroneo calcolo dell’importo della garanzia provvisoria prestata, non effettuato sul *valore complessivo dell’appalto*, pari ad € 240.000,00, così come previsto dalla normativa vigente in materia (art. 106 comma 1 d. lgs. n. 36/2023) e dalla lex specialis (art. 9 disciplinare di gara).

La società partecipa alla procedura come impresa singola, rientrando nella categoria delle PMI.

Ha presentato PassOE n. 2884-2137-6583-9951.

Ha correttamente proceduto al pagamento del contributo ANAC.

Ha allegato verbale di sopralluogo, effettuato in data 11/01/2024, ore 12:30.

Ha prodotto certificazione UNI CEI ISO 9001.

Dichiara di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto CCNL equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante recante il seguente codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120: H011.

2. ASSING S.P.A.

La documentazione amministrativa prodotta dalla ASSING S.P.A. **NON** risulta **CONFORME** alle prescrizioni del disciplinare di gara in ragione:

- Del mancato annullamento del contrassegno della marca da bollo;
- dell'erroneo calcolo dell'importo della garanzia provvisoria prestata in quanto viene applicata una riduzione del 20%, non prevista dalla *lex specialis* (art. 9 disciplinare di gara).

La società partecipa alla procedura come impresa singola rientrante nella categoria delle PMI.

Ha presentato PassOE n. 2471-7102-2061-0746

Dichiara di ricorrere al subappalto ammesso nei limiti di quanto disposto dall'art. 119 comma del Codice e secondo quanto previsto dall' art.49 D.L. 77 del 31/05/2021 per la seguente prestazione/i:

Prestazione - attività di logistica, Prestazione - attività di installazione apparecchiature, Prestazione - attività di manutenzione apparecchiature, Prestazione - attività finalizzate all'eventuale adeguamento dei locali d'installazione

Ha correttamente proceduto al pagamento del contributo ANAC.

Ha allegato verbale di sopralluogo, effettuato in data 12/01/2024, ore 10:00.


Ha prodotto certificazione UNI CEI ISO 9001.

Dichiara di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il CCNL indicato dalla stazione appaltante.

Alle ore 11:30 il Seggio il RUP chiude i lavori e rinvia i lavori al giorno 15/02/2024 ore 12:00.

L.C.S.

Il RUP, Dott.ssa Roberta Teodori



Il testimone verbalizzante, Dott.ssa Elena Cammarata



Il testimone, Dott.ssa Eleonora Franceschini



UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Responsabile: Dott.ssa Roberta Teodori
Tel. 0746-279540 - e-mail: r.teodori@asl.rieti.it

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO, DA DESTINARE ALLA U.O.C DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL PO DI RIETI.

Numero gara: 9402342

VERBALE n. 3

Il giorno **15/02/2024 alle ore 12:00** presso la U.O.C. ALBS della ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, si riunisce, in seduta riservata, il Seggio di Gara della procedura indicata in epigrafe, per proseguire i lavori di verifica di conformità della documentazione contenuta nelle buste amministrative dei n. 3 operatori economici rimanenti, nell'ordine di seguito riportato:

1. SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

La documentazione amministrativa prodotta dalla società SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. risulta **NON CONFORME** alle prescrizioni del disciplinare di gara in ragione:

- del mancato annullamento del contrassegno della marca da bollo;
- dell'erroneo calcolo dell'importo della garanzia provvisoria prestata a corredo dell'offerta presentata in quanto: *a*) viene applicata una riduzione del 20%, non prevista dalla lex specialis (art. 9 disciplinare di gara); *b*) non risulta calcolato sul valore complessivo dell'appalto, pari ad € 240.000,00, così come previsto dalla normativa vigente in materia (art. 106 comma 1 d. lgs. n. 36/2023) e dalla lex specialis (art. 9 disciplinare di gara).

La società partecipa alla procedura come impresa singola.

Ha presentato PassOE n. 7865-3338-5957-2331.

Ha correttamente proceduto al pagamento del contributo ANAC.

Ha prodotto certificazione UNI CEI ISO 9001

Ha allegato verbale di sopralluogo, effettuato in data 28/11/2023, ore 11:00.

Dichiara di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto CCNL equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante e, nello specifico, CCNL CHIMICO FARMACEUTICO E AFFINI: INDUSTRIE (codice alfanumerico B011) – per i dirigenti : AZIENDE INDUSTRIALI (codice alfanumerico V012).

Il Seggio di Gara passa successivamente all'esame delle dichiarazioni rese dal suddetto operatore economico in ordine ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 D.lgs. n. 36/2023.

Con riguardo alle dichiarazioni rese in materia di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, il RUP/Presidente del Seggio ritiene che i fatti rappresentati dall'o.e. non rilevano ai fini dell'esclusione di quest'ultimo dalla partecipazione alla presente gara ai sensi del comma 2 del citato articolo 95 in quanto:

- per la cartella di pagamento relativa al periodo di imposta 2009 l'operatore economico,

anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando gli importi previsti (art. 95, comma 2, secondo periodo);

- per l'avviso di liquidazione relativo all'anno di imposta 2015 inerente la tardiva registrazione di un contratto di locazione, la società ha proposto ricorso che è stato accolto con la sentenza n. 4764/2018, impugnata dall'Agenzia delle Entrate di Milano, con esito negativo. La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha, infatti, rigettato il gravame promosso dall'AdE Milano che ha presentato ricorso in Cassazione, ad oggi pendente (art. 4, comma 2, allegato II.10 al Codice).

Con riferimento poi alle dichiarazioni relative all'applicazione di penali e/o contestazioni da parti di altre stazioni appaltanti legate a ritardi nell'installazione delle apparecchiature oggetto di diverse forniture, nella consegna di progetti o nell'esecuzione di servizi di manutenzione, il RUP ritiene che le circostanze dedotte dall'o.e. non incidono sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 36/2023, in quanto:

- gran parte di queste, al di là di ogni valutazione sull'idoneità delle stesse ad incidere o meno sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico, non rilevano sotto un profilo temporale trattandosi di fatti verificatisi in un periodo superiore al triennio. Ai sensi dell'art. 96, comma 10, lett. c), n. 3, infatti, *"le cause di esclusione di cui all'art. 95 rilevano...per tre anni decorrenti...dalla commissione del fatto..."* (v.di fornitura e installazione risonanza magnetica c/o P.o. San Giovanni Bosco di Torino ; fornitura e installazione PET/TC all'ASST Ovest Milanese nell'ambito della convenzione ARCA 2017-142; fornitura in noleggio in favore dell'AO S. Carlo Potenza; fornitura di tomografo c/o ASL della Romagna; fornitura di Ciclotrone MeV c/o Università degli Studi di Messina; fornitura ed installazione sistema PET/TC c/o Policlinico San Martino-IST);
- alcune delle contestazioni di inadempimento non si sono concluse con l'applicazione di penali essendo ancora pendente il contraddittorio tra le parti (v.di installazione di 2 angiografi c/o i presidi ospedalieri di Latina e di Formia) o essendo state definite con atto transattivo che, per definizione contenuta nell'articolo 1965, primo comma, del codice civile, è quel *"... contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"* (v.di fornitura di 2 sistemi PET/CT ditigali c/o IFO);
- nessuna contestazione ha comportato la risoluzione del contratto per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno;
- le sanzioni applicate nelle residue circostanze rappresentate dall'o.e. (v.di servizio di manutenzione apparecchiature elettromedicali c/o ASL Taranto; servizio di assistenza e manutenzione apparecchiature elettromedicali c/o ASL Toscana Centro; servizi integrati di gestione e manutenzione di apparecchiature sanitarie c/o ASL Roma 6), inoltre, si ritengono non comparabili ad una condanna al risarcimento del danno, dovendosi ritenere comparabili le penali che conseguono all'inadempimento di una prestazione sostanziale rispetto al complesso degli impegni assunti dal contraente (cfr. Linee guida ANAC n. 6). Non si ritiene, infatti, che le fattispecie in esame concretizzino una grave negligenza da parte dell'operatore economico o che le stesse siano indice di una persistente carenza professionale, avuto riguardo tanto all'importo delle penali in rapporto al valore del contratto, che appare esiguo trattandosi di penali tra l'1,02% e l'1,80%, quanto alla natura delle inadempienze contestate, per lo più ritardi nell'esecuzione del servizio o comunque attività marginali rispetto all'oggetto principale del contratto.

D'altro canto, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa "...l'applicazione di una penale non costituisce da sola indizio del fatto che l'inadempienza all'origine della stessa è espressiva di una "significativa o persistente carenza" nell'esecuzione di un precedente contratto, non possedendo - per la natura dell'atto irrogativo e per la pregnanza degli elementi costitutivi della relativa fattispecie applicativa - la valenza sintomatica della "risoluzione per inadempimento" o della "condanna al risarcimento del danno". Solo a titolo esemplificativo, basti osservare che, anche quando promana dall'Amministrazione (e non gode quindi delle garanzie proprie della pronuncia giurisdizionale), la decisione risolutoria scaturisce dal contraddittorio con l'appaltatore (art. 103, comma 3, D.Lgs. n. 50 del 2016), atta a conferire alla stessa un peculiare grado di attendibilità, mentre, dal punto di vista dei presupposti legittimanti, essa richiede l'accertamento di un "grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne (sic!) la buona riuscita delle prestazioni", che non ricorre necessariamente nell'ipotesi delle penali (le quali, anzi, assolvono normalmente alla funzione di sanzionare le fattispecie di inadempimento di carattere "residuale", che cioè, rispetto a quelle giustificative della risoluzione, si collocano ad un livello di "gravità" inferiore)" (Cons. di Stato, Sez. III, Sent. 22/12/2020, n. 8236).

- l'operatore economico ha peraltro dichiarato che tutte le penali irrogate sono state regolarmente pagate (alcune anche a seguito di riduzione dell'importo successivamente all'attivazione del contraddittorio tra le parti) precedentemente alla partecipazione alla presente procedura.

Inoltre, il Presidente del Seggio di gara rileva che rispetto ai contratti che l'operatore economico ha in essere con l'Azienda, aventi ad oggetto la fornitura di apparecchiature elettromedicali indispensabili per le prestazioni sanitarie erogate dal presidio ospedaliero e dai servizi territoriali della ASL Rieti, non si registrano inadempienze oggetto di contestazione né l'applicazione di penali. Per quanto sopra, pertanto, il Seggio di gara/RUP ritiene che le circostanze rappresentate dall'o.e. di cui sopra non sono tali da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità della Società nella esecuzione delle prestazioni di cui al contratto oggetto della presente procedura.

Il Seggio di gara/RUP, inoltre, procede, in separato verbale - che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (ALL. 1) -, ad esaminare ulteriori dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dall'operatore economico SIEMENS HEALTHCARE SRL, per la verifica dei requisiti di ordine generale ex artt. 95 del D.Lgs. 36/2023, disponendone la secretazione al fine di garantire la tutela dei dati personali giudiziari nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal Codice della privacy così come riformato dal d.lgs. n. 101/2018.

2. TRADE ART 2000 S.P.A

La documentazione amministrativa prodotta dalla società TRADE ART 2000 S.P.A. risulta **NON CONFORME** alle prescrizioni del disciplinare di gara in ragione del mancato annullamento del contrassegno della marca da bollo;

La società partecipa alla procedura come impresa singola, rientrando nella categoria delle PMI.

Ha presentato PassOE n. 1496-5946-6740-3318.

Ha correttamente proceduto al pagamento del contributo ANAC.

Ha allegato verbale di sopralluogo, effettuato in data 09/01/2024, ore 11:00.

Ha prodotto certificazione UNI CEI ISO 9001.

Dichiara di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto CCNL equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante recante il seguente codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16

quater del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120: H011.

Allega dichiarazione relativa al mancato assoggettamento alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15.

3. METALTRONICA SPA

La documentazione amministrativa prodotta dalla società METALTRONICA risulta **NON CONFORME** alle prescrizioni del disciplinare di gara in ragione dell'erroneo calcolo dell'importo della garanzia provvisoria prestata a corredo dell'offerta in quanto non basato sul valore complessivo dell'appalto, pari ad € 240.000,00, così come previsto dalla normativa vigente in materia (art. 106 comma 1 d. lgs. n. 36/2023) e dalla lex specialis (art. 9 disciplinare di gara).

La società partecipa alla procedura come impresa singola, rientrante nella categoria delle PMI.

Ha presentato PassOE n. 2385-1169-4512-8591.

Ha prodotto certificazione UNI CEI ISO 9001.

Ha correttamente proceduto al pagamento del contributo ANAC.

Ha allegato verbale di sopralluogo, effettuato in data 22/01/2024, ore 10:30.

Dichiara di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto CCNL equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante e, nello specifico, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate a UNIONMECCANICA CONFAPI.

A questo punto, tenuto conto delle risultanze delle attività di verifica della documentazione amministrativa proposta dai 6 concorrenti in gara, il RUP/Presidente del Seggio di gara dispone per l'ammissione e per l'ammissione con riserva come segue:

- 1) AMMETTE le seguenti ditte:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA
GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	00225500164	IT00225500164

- 2) AMMETTE CON RISERVA le seguenti ditte per le relative specifiche motivazioni rese nel presente verbale e nel verbale redatto in data 14/02/2024:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA
ASSING S.p.A.	06725640582	IT01603091008
BIESSE MEDICA	04409721000	IT04409721000
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	04785851009	IT12268050155
TRADE ART 2000 S.P.A.	04607611003	IT04607611003
METALTRONICA	02833590587	IT01123731000

Di seguito, quindi, il RUP/Presidente del Seggio di gara dispone l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice nei confronti delle ditte indicate al punto 2 di cui sopra.

Alle ore 14:00 il RUP chiude i lavori, riservandosi di procedere all'invio, tramite il Portale S.TEL.LA., delle richieste di integrazione documentale e rinvia a data da destinarsi per il prosieguo dei lavori per l'adozione dei provvedimenti di definitiva ammissione/esclusione dalla gara.




L.C.S.


Il RUP, Dott.ssa Roberta Teodori

Handwritten signature of Roberta Teodori in cursive script, written over a horizontal line.

Il testimone verbalizzante, Dott.ssa Elena Cammarata

Handwritten signature of Elena Cammarata in cursive script, written over a horizontal line.

Il testimone, Dott.ssa Eleonora Franceschini

Handwritten signature of Eleonora Franceschini in cursive script, written over a horizontal line.

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Responsabile: Dott.ssa Roberta Teodori
Tel. 0746-279540 - e-mail: r.teodori@asl.rieti.it

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO, DA DESTINARE ALLA U.O.C DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL PO DI RIETI.

Numero gara: 9402342

VERBALE n. 4

Il giorno 20/03/2024 alle ore 11:00 presso la U.O.C. ALBS della ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, si riunisce, in seduta riservata, il Seggio di Gara della procedura indicata in epigrafe, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 364 del 12.02.2024 e composto come di seguito:

- Dott.ssa Roberta Teodori, Responsabile della U.O.C. Acquisizione Logistica di Beni e Servizi nella qualità di Responsabile della fase di affidamento/Presidente;
- Dott.ssa Elena Cammarata, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone verbalizzante;
- Dott.ssa Eleonora Franceschini, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone.

Il Presidente/ RUP, preliminarmente, da atto:

- di aver attivato il soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice, procedendo all’invio, tramite il Portale S.TEL.LA., delle richieste di integrazione documentale, come da seguente prospetto di riepilogo, assegnando a ciascun concorrente termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa richiesta, ovvero, termine sino al 04/03/2024, cadendo il decimo giorno successivo (03/03/2024) in giorno festivo:

Nr. Registro di Sistema Richiesta ex art. 101 del Codice	Ragione Sociale	Data invio
PI029029-24	ASSING S.p.A.	22/02/2024
PI029031-24	BIESSE MEDICA	22/02/2024
PI029040-24	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	22/02/2024
PI029042-24	TRADE ART 2000 S.P.A.	22/02/2024
PI029036-24	METALTRONICA	22/02/2024

Il Seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione pervenuta a seguito dell’attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., rilevando l’intervenuto riscontro alla richiesta di sanatoria della documentazione amministrativa presentata nonché l’esaustività della stessa rispetto a tutti gli operatori economici nei confronti dei quali è stato attivato il sub-procedimento di che trattasi.

Il Seggio di gara procede quindi ad un controllo riepilogativo della verifica amministrativa effettuata. A seguito di questo ulteriore esame, il Presidente rileva la necessità di un maggiore approfondimento rispetto alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione dall'operatore economico Siemens Healthcare S.r.l. con riferimento ai requisiti di ordine generale ex art. 95 del D.lgs. 36/2023, dalle quali emerge che la Società è destinataria dell'applicazione di diverse penali legate a differenti rapporti intercorsi con altre stazioni appaltanti.

Il Presidente, in particolare, ritiene necessario acquisire le seguenti precisazioni:

- con riguardo alle contestazioni sollevate, in data 14.06.2023, dalla Asl di Latina per il ritardo nella consegna dei progetti esecutivi legati alla fornitura di n. 2 angiografi presso il P.O. di Latina e Formia: i tempi di consegna prescritti dal contratto, entro i quali l'operatore economico avrebbe dovuto adempiere nonché se è stata o meno irrogata la penale;
- in relazione alla fornitura del Ciclotrone MeV oggetto del contratto stipulato con l'Università degli Studi di Messina: specifica dell'inadempimento contestato e i termini entro i quali, da contratto, l'operatore economico avrebbe dovuto adempiere;
- con riferimento al contratto con la ASL di Taranto per il servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di talune apparecchiature Siemens Healthcare Srl: i tempi entro i quali, da contratto, doveva essere eseguito il suddetto servizio.


A questo punto, il RUP/Presidente del Seggio di gara, riservando ogni valutazione in ordine all'esclusione dalla gara di tale o.e., dispone l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice nei confronti della Società Siemens, anche al fine di garantire a quest'ultima il contraddittorio previsto dall'art. 5 del Disciplinare di gara.

Alle ore 12:30 il RUP chiude i lavori, riservandosi di procedere all'invio, tramite il Portale S.TEL.LA., della richiesta di chiarimenti di cui sopra e rinvia a data da destinarsi per il prosieguo dei lavori per l'adozione dei provvedimenti di definitiva ammissione/esclusione dalla gara.

L.C.S.


Il RUP /Presidente

Dott.ssa Roberta Teodori



Il testimone verbalizzante

Dott.ssa Elena Cammarata



Il testimone

Dott.ssa Eleonora Franceschini



UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Responsabile: Dott.ssa Roberta Teodori
Tel. 0746-279540 - e-mail: r.teodori@asl.rieti.it

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO, DA DESTINARE ALLA U.O.C DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL PO DI RIETI.

Numero gara: 9402342

VERBALE n. 5

Il giorno 04/04/2024 alle ore 14:15 presso la U.O.C. ALBS della ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, si riunisce, in seduta riservata, il Seggio di Gara della procedura indicata in epigrafe, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 364 del 12.02.2024.

Il Presidente/ RUP, preliminarmente, da atto:

- di aver attivato la richiesta di chiarimenti nei confronti dell'o.e. Siemens Healthcare S.r.l., procedendo all'invio, tramite il Portale S.TEL.LA., come da seguente prospetto di riepilogo, assegnando termine sino al 04/04/2024 ore 14:00.

Nr. Registro di Sistema Richiesta ex art. 101 del Codice	Ragione Sociale	Data invio
PI050354-24	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	27/03/2024

Il Seggio di gara procede quindi all'esame della documentazione pervenuta. All'esito, il RUP/Presidente del Seggio di gara ritiene di confermare quanto rilevato nella seduta riservata del 15/02/2024 e precisare quanto segue:

- con riguardo alle contestazioni sollevate dalla Asl di Latina per il ritardo nella consegna dei progetti esecutivi legati alla fornitura di n. 2 angiografi presso il P.O. di Latina e Formia e con riferimento al contratto con la ASL di Taranto per il servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di talune apparecchiature Siemens Healthcare Srl: le sanzioni applicate/contestate si ritengono non comparabili ad una condanna al risarcimento del danno ex art. 98, comma 3, lett. c) del Codice, in quanto attinenti a fattispecie che a parere di questo Seggio di gara/RUP non concretizzano una grave negligenza da parte dell'operatore economico avuto riguardo all'appalto oggetto della presente procedura di gara, né appaiono indice di una persistente carenza professionale, in ragione tanto dell'importo delle penali irrogate in rapporto al valore del contratto, che appare esiguo trattandosi di penali di circa l'1,80/1,90%, quanto alla natura delle inadempienze contestate, nel primo caso relative ai lavori e nel secondo caso inerenti un ritardo di 18 giorni nell'espletamento del servizio di manutenzione. Peraltro, con riferimento alla penale irrogata dall'ASL di Taranto, l'o.e. ha emesso relativa nota di credito, invece, rispetto alle contestazioni mosse dall'ASL Latina, il procedimento di irrogazione della penale non risulta concluso.
- in relazione alla fornitura del Ciclotrone MeV oggetto del contratto stipulato con l'Università degli Studi di Messina: trattasi di fatti che non appaiono rilevare innanzitutto sotto un profilo temporale ai sensi dell'art. 96, comma 10, lett. c), n. 3 del Codice. In ogni caso, le contestate inadempienze

non si ritengono tali da concretizzare una grave negligenza da parte dell'operatore economico, né si ritengono sintomatiche di una persistente carenza professionale. Come emerge dal certificato di collaudo, trasmesso dalla Società in riscontro alla richiesta di chiarimenti del 27/03/2024, il contestato inadempimento attiene sostanzialmente alla mancata esecuzione di parte delle lavorazioni a carico dell'impresa mandante (fallita nel 2019) (pag. 4) che, in ogni caso, sono risultate di "piccole entità, marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori" (pag. 4) mentre, quelle eseguite, sono risultate effettuate a "regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, senza pregiudizi alla stabilità e funzionalità dell'opera" (pag. 9). Inoltre, sempre dal medesimo documento si evince che, nell'ambito del contratto, non sono state mosse contestazioni da parte della stazione appaltante per le forniture ed installazione di apparecchiature, attrezzature ed arredi (eseguite dall'impresa capogruppo Siemens S.p.a.). Si ritiene quindi che tali fatti non mettono in dubbio l'affidabilità ed integrità dell'o.e. tenuto conto altresì dell'oggetto dell'appalto della presente procedura di gara relativo alla sola fornitura di una apparecchiatura elettromedicale. Il RUP conclude quindi per l'affidabilità ed integrità dell'operatore economico, considerato del resto che trattasi di Società con la quale l'Azienda ha in essere diversi contratti aventi ad oggetto la fornitura di apparecchiature elettromedicali indispensabili per le prestazioni sanitarie erogate dal presidio ospedaliero e dai servizi territoriali della ASL Rieti, rispetto alle quali non si registrano inadempimenti oggetto di contestazione, né l'applicazione di penali.

Per quanto sopra, di seguito lo stato di ammissione/esclusione dei concorrenti alla presente procedura:


Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Stato
ASSING S.p.A.	06725640582	IT01603091008	Ammesso
BIESSE MEDICA	04409721000	IT04409721000	Ammesso
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	04785851009	IT12268050155	Ammesso
TRADE ART 2000 S.P.A.	04607611003	IT04607611003	Ammesso
METALTRONICA	02833590587	IT01123731000	Ammesso
GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	00225500164	IT00225500164	Ammesso

A questo punto, il Presidente/RUP, alle ore 15:15, dichiara terminati i lavori del seggio di gara e dispone di procedere con la COMUNICAZIONE/AVVISO ai concorrenti, tramite piattaforma, delle predette risultanze della fase di verifica della documentazione amministrativa.

L.C.S.

Il RUP /Presidente

Dott.ssa Roberta Teodori



Il testimone verbalizzante

Dott.ssa Elena Cammarata



Il testimone

Dott.ssa Eleonora Franceschini




Firmato digitalmente da:

TEODORI ROBERTA

Firmato il 08/07/2024 13:39

Seriale Certificato: 1399814

Valido dal 03/05/2022 al 03/05/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO, DA DESTINARE ALLA U.O.C DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL PO DI RIETI. Numero gara: 9402342. CIG: A0249B8A84

VERBALE COMMISSIONE n. 1
(seduta pubblica virtuale)

Il giorno **17 aprile 2024**, alle ore 10:40 presso la U.O.C. ALBS della ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti

Premesso che:

- con atto deliberativo n. 495/C.S./2023 del 07.11.2023 è stata indetta “*procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di un tavolo radiologico telecomandato, da destinare alla U.O.C. Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 239.955,00 al netto dell’IVA. Numero gara 9402342 – CIG: A0249B8A84*”, approvandone i relativi atti di gara;
- con il medesimo atto, sono stati individuati, quale Responsabile Unico del Progetto, la Dott.ssa Roberta Teodori – Responsabile della UOC Acquisizione Logistica di Beni e Servizi e quale Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione della gara, l’Ing. Daniele Della Vedova – Responsabile della U.O.S.D. Ingegneria Clinica;
- con atto deliberativo n. 700/CS/2023 del 28/12/2023, questa Azienda ha proceduto alla modifica parziale degli atti di gara e alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte, la cui scadenza è stata fissata al giorno 09/02/2024 ore 12.00 con data di apertura delle offerte in seduta pubblica virtuale in data 12/02/2024;
- con il medesimo atto:
 - è stato confermato, quale Responsabile Unico del Progetto, la Dott.ssa Roberta Teodori – Responsabile della UOC Acquisizione Logistica di Beni e Servizi;
 - è stato nominato, quale Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione della gara, in sostituzione dell’Ing. Daniele Della Vedova – Responsabile della U.O.S.D. Ingegneria Clinica, il Dott. Stefano Canitano, Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini;
- l’affidamento verrà disposto con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 108 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
- la procedura è stata pubblicata sul sistema regionale S.TEL.LA., con registro di sistema n. PI150804-23;
- entro il termine di scadenza sopra indicato hanno presentato offerta numero 6 (sei) operatori economici, agli atti del Fasciolo telematico S.TEL.LA., di seguito riportati: SIEMENS



HEALTHCARE S.R.L., ASSING S.p.A., BIESSE MEDICA, General Medical Merate S.p.A.,
TRADE ART 2000 S.P.A. e METALTRONICA;

- con determina dirigenziale n. 364/2024 del 12/02/2024 è stato nominato il Seggio di Gara per l'esame della documentazione amministrativa, composto come di seguito:
 - Dott.ssa Roberta Teodori, Responsabile della U.O.C. ALBS, nella qualità di RUP/Presidente;
 - Dott.ssa Elena Cammarata, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone verbalizzante;
 - Dott.ssa Eleonora Franceschini, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone;
- con deliberazione n. 257/C.S./2024 del 15/03/2024, ai sensi degli art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice all'espletamento delle operazioni di gara concernenti la valutazione delle offerte tecniche e la successiva apertura delle offerte economiche, come di seguito composta:
 - Prof. Vito Cantisani (Presidente);
 - TSRM Dr. Marco Savi (Commissario);
 - TSRM Dott. Marco Castrogiovanni (Commissario);
- in data 05/04/2024, terminati i lavori del seggio di gara, è stato comunicato a ciascun concorrente l'esito della verifica amministrativa;
- in data 05/04/2024, su indicazione del Presidente della Commissione, è stato comunicato ai concorrenti la data della seduta pubblica virtuale di apertura delle buste tecniche fissata il giorno 17/04/2024 ore 10:00 e ss..

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale,

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

nel giorno e nell'ora predetti, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione nonché della dott.ssa Elena Cammarata, collaboratore amministrativo categoria D, in servizio presso la UOC ALBS, nelle funzioni e con i compiti di segretario verbalizzante senza diritto di voto, procede al collegamento alla Piattaforma di *e-Procurement* S.TEL.LA.

La commissione ed il segretario, preso atto dell'oggetto dell'appalto e degli operatori economici partecipanti alla procedura, come risultanti dalla piattaforma di negoziazione S.TEL.LA., dichiarano ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., l'inesistenza di cause di inconferibilità (art. 35 bis D. Lgs. n. 165/2011 e ss.mm.ii.) e di conflitto di interessi, ai fini di quanto previsto dagli articoli 16, 93, comma 5 del D.lgs. 36/2023 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 nonché dal Codice di Comportamento aziendale (approvato con Deliberazione n. 658 del 19/12/2023) e dal Piano triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza vigente, come risulta dalle dichiarazioni agli atti.

A questo punto, il Presidente, alle ore 10.45, apre la seduta pubblica virtuale e di seguito procede con l'apertura telematica delle BUSTE/OFFERTE TECNICHE dei concorrenti in gara, secondo l'ordine progressivo di caricamento delle offerte, come da seguente riepilogo che si riporta, dandone comunicazione ai concorrenti collegati da remoto tramite la *chat* della Piattaforma.



	Fornitore	Codice Fiscale	Partita IVA	Data / ora ricezione	Registro Di Sistema - Offerta
1	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	04785851009	IT12268050155	07/02/2024 14:40:44	PI019602-24
2	ASSING S.p.A.	06725640582	IT01603091008	08/02/2024 14:19:45	PI020226-24
3	BIESSE MEDICA	04409721000	IT04409721000	08/02/2024 14:27:38	PI020239-24
4	General Medical Merate S.p.A.	00225500164	IT00225500164	08/02/2024 15:37:08	PI020347-24
5	TRADE ART 2000 S.P.A.	04607611003	IT04607611003	08/02/2024 16:01:27	PI020419-24
6	METALTRONICA	02833590587	IT01123731000	09/02/2024 09:49:03	PI020639-24

Di seguito, conclusa l'apertura delle buste tecniche, la cui valutazione verrà effettuata in seduta riservata, la Commissione procede con l'apertura delle buste contenenti i CD/DVD non riscrivibili o il supporto rimovibile USB, dandone sempre comunicazione tramite la chat della piattaforma ai concorrenti collegati da remoto.

All'esito, il Presidente da atto, sempre tramite chat della piattaforma, di aver concluso anche l'apertura delle suddette buste contenenti i CD/DVD non riscrivibili o il supporto rimovibile USB, la cui valutazione verrà eseguita in seduta riservata, di averne verificato la visibilità e che tutti i dispositivi forniti sono risultati visionabili.

Terminate tali attività, il Presidente chiude, quindi, la seduta pubblica virtuale alle ore 12:13, rinviando per il prosieguo dei lavori a data da destinarsi.

L.C.S.

Il Presidente, Prof. Vito Cantisani

Il Componente, TSRM Dr. Marco Savi

Il Componente, TSRM Dott. Marco Castrogiovanni

Il segretario verbalizzante, Dott.ssa Elena Cammarata

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO, DA DESTINARE ALLA U.O.C DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL PO DI RIETI. Numero gara: 9402342. CIG: A0249B8A84

VERBALE COMMISSIONE n. 2
(seduta riservata)

Il giorno **23 maggio 2024**, alle ore 09:30 presso il P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, si riunisce la Commissione giudicatrice per la verifica e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti.

Il Presidente svolge altresì i compiti di segretario verbalizzante.

Visto e richiamato il verbale del giorno 17 aprile 2024, il Presidente dichiara procedersi alle operazioni di esame e valutazione delle offerte secondo l’ordine progressivo di caricamento delle stesse.

Alle ore 12:30 sono risultate esaminate e valutate le prime tre offerte tecniche presentate rispettivamente da SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., ASSING S.p.A. e BIESSE MEDICA, come da **schede di valutazione denominate per operatore economico**, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso.


Alla predetta ora, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata rinviando per il prosieguo dei lavori a data da destinarsi.

L.C.S.

Il Presidente, Prof. Vito Cantisani

Il Componente, TSRM Dr. Marco Savi

Il Componente, TSRM Dott. Marco Castrogiovanni

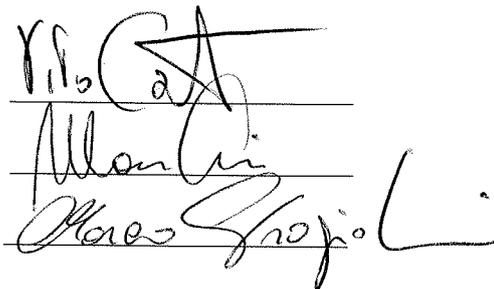

OPERATORE ECONOMICO: SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

CRITERI QUALITA'		Requisito minimo	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
				Cantisani Vito	Savi Marco	Castrogiovanni Marco	
1	CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE						
GENERATORE AD ALTA FREQUENZA CON ESPOSIZIONE AUTOMATICA							
1.1	Frequenza di erogazione		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			0,44
1.2	Potenza	80 kw	2	$Pi=((Vi-80)/(Vmax-80))*Pmax$			0
1.3	Frequenza acquisizione in radioscopia pulsata, con campo 30x30 cm e matrice 1024x1024. (Se ≥ 15 imm/s P=1; se ≥ 25 imm/s P=2).		2				2,00
STATIVO PORTATUBO							
1.4	Capace di effettuare proiezioni oblique. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
1.5	Velocità di spostamento longitudinale dello stativo (cm/s)		2	$Pi=((Vi-2)/(Vmax-2))*Pmax$			1,55
1.6	Soluzioni tecnologiche atte ad evitare urti accidentali con il paziente e/o gli operatori durante le operazioni di movimentazione. (descrivere)		3	1,00	1,00	1,00	3,00
1.7	Dotazione di interfaccia touchscreen sul collimatore. (Se si=Pmax; se no=0)		2				0,00
1.8	Possibilità di inclinazione dello stativo portatubo anche alle estremità del tavolo, con centraggio automatico. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
1.9	Distanza fuoco - film	150 cm	2	$Pi=((Vi-150)/(Vmax-150))*Pmax$			0
SORGENTE RADIOGENA AD ANODO ROTANTE							
1.10	Capacità termica anodica (KHU)	400 KHU	2	$Pi=((Vi-400)/(Vmax-400))*Pmax$			1,16
1.11	Dissipazione termica anodica (KHU/min)	100 KHU/min	2	$Pi=((Vi-100)/(Vmax-100))*Pmax$			2
TAVOLO TELECOMANDATO PORTAPAZIENTE							
1.12	Minima altezza da terra (cm) <i>Vmin altezza minima</i>	70 cm	3	$Pi=((70-Vi)/(70-Vmin))*Pmax$			2,06
1.13	Copertura paziente senza riposizionamento del paziente (cm)		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			2
1.14	Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento in qualsiasi movimentazione (kg)	200 Kg	3	$Pi=((Vi-200)/(Vmax-200))*Pmax$			3
1.15	Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100 kV) migliorativo. (Se si=Pmax; se no=0)	0,5 mmAl@100 kV \pm 0,05	3				0,00
1.16	Gestione del paziente dalla posizione supina fino alla ortostatica con posizioni intermedie (descrivere)		3	0,80	1,00	1,00	2,80
DETECTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL							
1.17	Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a=2,5 MGy) a 2 lp/mm (IEC 62220 -1) (%)		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			1,83
1.18	Sistema di formazione dell'immagine con: griglia di tipo removibile e dotata di sistema di parcheggio quando non in uso. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
SOFTWARE DI POST-ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI							
1.19	Tomosintesi (descrivere)		3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Dual energy (descrivere)		2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	DSA (descrivere)		2	1,00	1,00	1,00	2,00
GENERALI							

OPERATORE ECONOMICO: SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

CRITERI QUALITA'		Requisito minimo	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
				Cantisani Vito	Savi Marco	Castrogiovanni Marco	
1.22	Sistemi di contenimento e gestione della dose al paziente e operatore. (descrivere) <i>Il punteggio verrà attribuito in funzione della capacità dei sistemi di contenere e gestire la dose per pazienti e operatori</i>		3	1,00	1,00	1,00	3,00
1.23	Durata della garanzia	24 mesi	1	$P_i = ((V_i - 24) / (V_{max} - 24)) * P_{max}$			0,17
2	VIDEO DEMO						
2.1	Sistemi di miglioramento e ottimizzazione delle biommagini In acquisizione e post elaborazione. (Esame CD/DVD)		3	1,00	1,00	1,00	3,00
2.2	Sistemi di contenimento e gestione della dose al paziente e operatore. (Esame CD/DVD)		3	0,80	0,80	1,00	2,60
2.3	Accessibilità per operatori e pazienti in condizioni di uso clinico (anche dai due lati lunghi), sistemi di Sicurezza accessibilità al sottotavolo per sanificazione. (Esame CD/DVD)		3	0,40	0,40	0,40	1,20
2.4	Gestione del workflow degli esami (accettazione paziente, esecuzione esame, archiviazione esame, Interfaccia utente...). (Esame CD/DVD)		3	1,00	1,00	1,00	3,00
2.5	Console di comando per il controllo delle movimentazioni dell'apparecchiatura e delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle immagini ed ergonomia della console. (Esame CD/DVD)		3	0,80	0,80	1,00	2,60
3	QUALITÀ BIOIMMAGINI						
3.1	Paziente adulto: Colonna cervicale, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,80	0,80	2,00
3.2	Paziente adulto: Colonna lombo sacrale, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,80	1,00	2,17
3.3	Paziente adulto: Torace, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	1,00	0,80	0,80	2,17
3.4	Paziente adulto: Spalla paziente ortostasi proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	1,00	0,80	2,17
3.5	Paziente adulto: addome paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,80	0,80	2,00
3.6	Paziente adulto: radioscopia della deglutizione durante ingestione di mezzo di contrasto radiopaco, proiezione laterolaterale. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,60	0,80	1,83
3.7	Paziente pediatrico: Colonna in toto, paziente ortostasi proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,80	0,80	2,00
3.8	Paziente pediatrico: Polso. proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,80	1,00	2,17
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE			90	TOTALE			64,91

OPERATORE ECONOMICO: BIESSE MEDICA

CRITERI QUALITA'		Requisito minimo	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
				Cantisani Vito	Savi Marco	Castrogiovanni Marco	
1.22	Sistemi di contenimento e gestione della dose al paziente e operatore. (descrivere) <i>Il punteggio verrà attribuito in funzione della capacità dei sistemi di contenere e gestire la dose per pazienti e operatori</i>		3	1,00	1,00	1,00	3,00
1.23	Durata della garanzia	24 mesi	1	$P_i = ((V_i - 24) / (V_{max} - 24)) * P_{max}$			0,50
2	VIDEO DEMO						
2.1	Sistemi di miglioramento e ottimizzazione delle biommagini In acquisizione e post elaborazione. (Esame CD/DVD)		3	1,00	1,00	1,00	3,00
2.2	Sistemi di contenimento e gestione della dose al paziente e operatore. (Esame CD/DVD)		3	1,00	0,80	1,00	2,80
2.3	Accessibilità per operatori e pazienti in condizioni di uso clinico (anche dai due lati lunghi), sistemi di Sicurezza accessibilità al sottotavolo per sanificazione. (Esame CD/DVD)		3	1,00	1,00	1,00	3,00
2.4	Gestione del workflow degli esami (accettazione paziente, esecuzione esame, archiviazione esame, Interfaccia utente...). (Esame CD/DVD)		3	1,00	1,00	1,00	3,00
2.5	Console di comando per il controllo delle movimentazioni dell'apparecchiatura e delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle immagini ed ergonomia della console. (Esame CD/DVD)		3	0,80	1,00	1,00	2,80
3	QUALITÀ BIOIMMAGINI						
3.1	Paziente adulto: Colonna cervicale, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	1,00	1,00	1,00	2,50
3.2	Paziente adulto: Colonna lombo sacrale, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	1,00	0,80	0,80	2,17
3.3	Paziente adulto: Torace, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	1,00	0,80	2,17
3.4	Paziente adulto: Spalla paziente ortostasi proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,80	1,00	2,17
3.5	Paziente adulto: addome paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,80	1,00	2,17
3.6	Paziente adulto: radioscopia della deglutizione durante ingestione di mezzo di contrasto radiopaco, proiezione laterolaterale. (Esame CD/DVD)		2,5	1,00	1,00	1,00	2,50
3.7	Paziente pediatrico: Colonna in toto, paziente ortostasi proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	1,00	1,00	2,33
3.8	Paziente pediatrico: Polso. proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	1,00	0,80	2,17
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE			90	TOTALE			74,76





OPERATORE ECONOMICO: BIESSE MEDICA

CRITERI QUALITA'	Requisito minimo	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
			Cantisani Vito	Savi Marco	Castrogiovanni Marco		
1	CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE						
GENERATORE AD ALTA FREQUENZA CON ESPOSIZIONE AUTOMATICA							
1.1	Frequenza di erogazione		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			2
1.2	Potenza	80 kw	2	$Pi=((Vi-80)/(Vmax-80))*Pmax$			0
1.3	Frequenza acquisizione in radioscopia pulsata, con campo 30x30 cm e matrice 1024x1024. (Se ≥ 15 imm/s P=1; se ≥ 25 imm/s P=2).		2				1,00
STATIVO PORTATUBO							
1.4	Capace di effettuare proiezioni oblique. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
1.5	Velocità di spostamento longitudinale dello stativo (cm/s)		2	$Pi=((Vi-2)/(Vmax-2))*Pmax$			1,11
1.6	Soluzioni tecnologiche atte ad evitare urti accidentali con il paziente e/o gli operatori durante le operazioni di movimentazione. (descrivere)		3	1,00	1,00	1,00	3,00
1.7	Dotazione di interfaccia touchscreen sul collimatore. (Se si=Pmax; se no=0)		2				0,00
1.8	Possibilità di inclinazione dello stativo portatubo anche alle estremità del tavolo, con centraggio automatico. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
1.9	Distanza fuoco - film	150 cm	2	$Pi=((Vi-150)/(Vmax-150))*Pmax$			2
SORGENTE RADIOGENA AD ANODO ROTANTE							
1.10	Capacità termica anodica (KHU)	400 KHU	2	$Pi=((Vi-400)/(Vmax-400))*Pmax$			2
1.11	Dissipazione termica anodica (KHU/min)	100 KHU/min	2	$Pi=((Vi-100)/(Vmax-100))*Pmax$			1,71
TAVOLO TELECOMANDATO PORTAPAZIENTE							
1.12	Minima altezza da terra (cm) <i>Vmin altezza minima</i>	70 cm	3	$Pi=((70-Vi)/(70-Vmin))*Pmax$			2,34
1.13	Copertura paziente senza riposizionamento del paziente (cm)		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			1,52
1.14	Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento in qualsiasi movimentazione (kg)	200 Kg	3	$Pi=((Vi-200)/(Vmax-200))*Pmax$			0,81
1.15	Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100 kV) migliorativo. (Se si=Pmax; se no=0)	0,5 mmAl@100 kV \pm 0.05	3				0,00
1.16	Gestione del paziente dalla posizione supina fino alla ortostatica con posizioni intermedie (descrivere)		3	1,00	1,00	1,00	3,00
DETECTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL							
1.17	Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a=2,5 MGy) a 2 Ip/mm (IEC 62220 -1) (%)		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			2
1.18	Sistema di formazione dell'immagine con: griglia di tipo removibile e dotata di sistema di parcheggio quando non in uso. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
SOFTWARE DI POST-ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI							
1.19	Tomosintesi (descrivere)		3	1,00	1,00	1,00	3,00
1.20	Dual energy (descrivere)		2	1,00	1,00	1,00	2,00
1.21	DSA (descrivere)		2	1,00	1,00	1,00	2,00
GENERALI							

OPERATORE ECONOMICO: ASSING S.p.A.

CRITERI QUALITA'		Requisito minimo	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
				Cantisani Vito	Savi Marco	Castrogiovanni Marco	
1.22	Sistemi di contenimento e gestione della dose al paziente e operatore. (descrivere) <i>Il punteggio verrà attribuito in funzione della capacità dei sistemi di contenere e gestire la dose per pazienti e operatori</i>		3	0,80	0,60	0,60	2,00
1.23	Durata della garanzia	24 mesi	1	$P_i = ((V_i - 24) / (V_{max} - 24)) * P_{max}$			0,00
2	VIDEO DEMO						
2.1	Sistemi di miglioramento e ottimizzazione delle biomagini In acquisizione e post elaborazione. (Esame CD/DVD)		3	0,80	0,60	0,80	2,20
2.2	Sistemi di contenimento e gestione della dose al paziente e operatore. (Esame CD/DVD)		3	0,60	0,80	0,40	1,80
2.3	Accessibilità per operatori e pazienti in condizioni di uso clinico (anche dai due lati lunghi), sistemi di Sicurezza accessibilità al sottotavolo per sanificazione. (Esame CD/DVD)		3	0,40	0,40	0,40	1,20
2.4	Gestione del workflow degli esami (accettazione paziente, esecuzione esame, archiviazione esame, Interfaccia utente...). (Esame CD/DVD)		3	0,60	0,60	0,40	1,60
2.5	Console di comando per il controllo delle movimentazioni dell'apparecchiatura e delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle immagini ed ergonomia della console. (Esame CD/DVD)		3	0,40	0,60	0,40	1,40
3	QUALITÀ BIOIMMAGINI						
3.1	Paziente adulto: Colonna cervicale, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,40	0,60	1,33
3.2	Paziente adulto: Colonna lombo sacrale, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,40	0,80	0,60	1,50
3.3	Paziente adulto: Torace, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,40	0,40	1,17
3.4	Paziente adulto: Spalla paziente ortostasi proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,60	0,40	1,50
3.5	Paziente adulto: addome paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,60	0,40	1,33
3.6	Paziente adulto: radioscopia della deglutizione durante ingestione di mezzo di contrasto radiopaco, proiezione laterolaterale. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,40	0,40	1,33
3.7	Paziente pediatrico: Colonna in toto, paziente ortostasi proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,40	0,40	1,17
3.8	Paziente pediatrico: Polso. proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,40	0,40	1,17
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE			90	TOTALE			58,33

Lu

VC

mf

OPERATORE ECONOMICO: ASSING S.p.A.

CRITERI QUALITA'	Requisito minimo	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
			Cantisani Vito	Savi Marco	Castrogiovanni Marco		
1	CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE						
GENERATORE AD ALTA FREQUENZA CON ESPOSIZIONE AUTOMATICA							
1.1	Frequenza di erogazione		2	$P_i = (V_i/V_{max}) * P_{max}$			0,67
1.2	Potenza	80 kw	2	$P_i = ((V_i - 80)/(V_{max} - 80)) * P_{max}$			0
1.3	Frequenza acquisizione in radioscopia pulsata, con campo 30x30 cm e matrice 1024x1024. (Se ≥ 15 imm/s P=1; se ≥ 25 imm/s P=2).		2				1,00
STATIVO PORTATUBO							
1.4	Capace di effettuare proiezioni oblique. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
1.5	Velocità di spostamento longitudinale dello stativo (cm/s)		2	$P_i = ((V_i - 2)/(V_{max} - 2)) * P_{max}$			1,44
1.6	Soluzioni tecnologiche atte ad evitare urti accidentali con il paziente e/o gli operatori durante le operazioni di movimentazione. (descrivere)		3	1,00	0,80	0,80	2,60
1.7	Dotazione di interfaccia touchscreen sul collimatore. (Se si=Pmax; se no=0)		2				2,00
1.8	Possibilità di inclinazione dello stativo portatubo anche alle estremità del tavolo, con centraggio automatico. (Se si=Pmax; se no=0)		3				0,00
1.9	Distanza fuoco - film	150 cm	2	$P_i = ((V_i - 150)/(V_{max} - 150)) * P_{max}$			2
SORGENTE RADIOGENA AD ANODO ROTANTE							
1.10	Capacità termica anodica (KHU)	400 KHU	2	$P_i = ((V_i - 400)/(V_{max} - 400)) * P_{max}$			2
1.11	Dissipazione termica anodica (KHU/min)	100 KHU/min	2	$P_i = ((V_i - 100)/(V_{max} - 100)) * P_{max}$			1,71
TAVOLO TELECOMANDATO PORTAPAZIENTE							
1.12	Minima altezza da terra (cm) <i>V_{min} altezza minima</i>	70 cm	3	$P_i = ((70 - V_i)/(70 - V_{min})) * P_{max}$			2,34
1.13	Copertura paziente senza riposizionamento del paziente (cm)		2	$P_i = (V_i/V_{max}) * P_{max}$			1,54
1.14	Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento in qualsiasi movimentazione (kg)	200 Kg	3	$P_i = ((V_i - 200)/(V_{max} - 200)) * P_{max}$			3
1.15	Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100 kV) migliorativo. (Se si=Pmax; se no=0)	0,5 mmAl@100 kV \pm 0,05	3				3,00
1.16	Gestione del paziente dalla posizione supina fino alla ortostatica con posizioni intermedie (descrivere)		3	0,60	0,60	0,60	1,80
DETECTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL							
1.17	Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a=2,5 MGy) a 2 Ip/mm (IEC 62220 -1) (%)		2	$P_i = (V_i/V_{max}) * P_{max}$			2
1.18	Sistema di formazione dell'immagine con: griglia di tipo removibile e dotata di sistema di parcheggio quando non in uso. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
SOFTWARE DI POST-ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI							
1.19	Tomosintesi (descrivere)		3	0,60	0,60	0,80	2,00
1.20	Dual energy (descrivere)		2	0,60	0,60	0,60	1,20
1.21	DSA (descrivere)		2	0,60	0,80	0,60	1,33
GENERALI							

Al

MJ

VC

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO, DA DESTINARE ALLA U.O.C DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL PO DI RIETI. Numero gara: 9402342. CIG: A0249B8A84

VERBALE COMMISSIONE n. 3
(seduta riservata)

Il giorno **27 maggio 2024**, alle ore 09:30 presso il P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, si riunisce la Commissione giudicatrice per il prosieguo della verifica e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti.

Il Presidente svolge altresì i compiti di segretario verbalizzante.

Visti e richiamati i verbali del 17 aprile 2024 e del 23 maggio 2024, il Presidente dichiara procedersi alle operazioni di esame e valutazione delle offerte non esaminate nella precedente seduta.

Alle ore 12:30 sono risultate esaminate e valutate le restanti tre offerte tecniche presentate rispettivamente da General Medical Merate S.p.A., TRADE ART 2000 S.P.A. e METALTRONICA, come da **schede di valutazione denominate per operatore economico**, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso.


Alla predetta ora, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata rinviando per il prosieguo dei lavori a data da destinarsi.

L.C.S.

Il Presidente, Prof. Vito Cantisani

Il Componente, TSRM Dr. Marco Savi

Il Componente, TSRM Dott. Marco Castrogiovanni

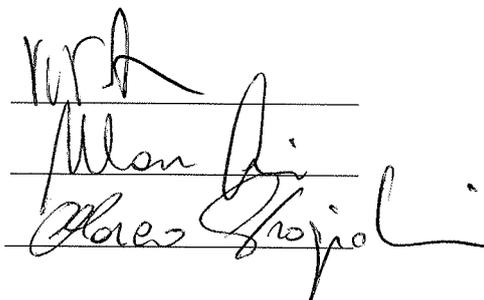

OPERATORE ECONOMICO: General Medical Merate S.p.A.


CRITERI QUALITA'		Requisito minimo	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
				Cantisani Vito	Savi Marco	Castrogiovanni Marco	
1.22	Sistemi di contenimento e gestione della dose al paziente e operatore. (descrivere) <i>Il punteggio verrà attribuito in funzione della capacità dei sistemi di contenere e gestire la dose per pazienti e operatori</i>		3	0,80	0,60	0,80	2,20
1.23	Durata della garanzia	24 mesi	1	$P_i = ((V_i - 24) / (V_{max} - 24)) * P_{max}$			0,50
2	VIDEO DEMO						
2.1	Sistemi di miglioramento e ottimizzazione delle biommagini In acquisizione e post elaborazione. (Esame CD/DVD)		3	0,80	0,60	0,60	2,00
2.2	Sistemi di contenimento e gestione della dose al paziente e operatore. (Esame CD/DVD)		3	0,60	0,60	0,60	1,80
2.3	Accessibilità per operatori e pazienti in condizioni di uso clinico (anche dai due lati lunghi), sistemi di Sicurezza accessibilità al sottotavolo per sanificazione. (Esame CD/DVD)		3	0,60	0,40	0,40	1,40
2.4	Gestione del workflow degli esami (accettazione paziente, esecuzione esame, archiviazione esame, Interfaccia utente...). (Esame CD/DVD)		3	0,80	0,60	0,60	2,00
2.5	Console di comando per il controllo delle movimentazioni dell'apparecchiatura e delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle immagini ed ergonomia della console. (Esame CD/DVD)		3	0,60	0,60	0,60	1,80
3	QUALITÀ BIOIMMAGINI						
3.1	Paziente adulto: Colonna cervicale, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,60	0,60	1,50
3.2	Paziente adulto: Colonna lombo sacrale, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,60	0,60	1,50
3.3	Paziente adulto: Torace, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,40	0,40	1,33
3.4	Paziente adulto: Spalla paziente ortostasi proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,60	0,60	1,50
3.5	Paziente adulto: addome paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,40	0,60	1,33
3.6	Paziente adulto: radioscopia della deglutizione durante ingestione di mezzo di contrasto radiopaco, proiezione laterolaterale. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,40	0,60	1,33
3.7	Paziente pediatrico: Colonna in toto, paziente ortostasi proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,60	0,60	1,50
3.8	Paziente pediatrico: Polso. proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,60	0,60	1,50
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE			90	TOTALE			66,31

OPERATORE ECONOMICO: General Medical Merate S.p.A.

CRITERI QUALITA'		Requisito minimo	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
				Cantisani Vito	Savi Marco	Castrogiovanni Marco	
1	CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE						
GENERATORE AD ALTA FREQUENZA CON ESPOSIZIONE AUTOMATICA							
1.1	Frequenza di erogazione		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			2
1.2	Potenza	80 kw	2	$Pi=((Vi-80)/(Vmax-80))*Pmax$			0
1.3	Frequenza acquisizione in radioscopia pulsata, con campo 30x30 cm e matrice 1024x1024. (Se ≥ 15 imm/s P=1; se ≥ 25 imm/s P=2).		2				1,00
STATIVO PORTATUBO							
1.4	Capace di effettuare proiezioni oblique. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
1.5	Velocità di spostamento longitudinale dello stativo (cm/s)		2	$Pi=((Vi-2)/(Vmax-2))*Pmax$			1,44
1.6	Soluzioni tecnologiche atte ad evitare urti accidentali con il paziente e/o gli operatori durante le operazioni di movimentazione. (descrivere)		3	1,00	0,80	0,80	2,60
1.7	Dotazione di interfaccia touchscreen sul collimatore. (Se si=Pmax; se no=0)		2				2,00
1.8	Possibilità di inclinazione dello stativo portatubo anche alle estremità del tavolo, con centraggio automatico. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
1.9	Distanza fuoco - film	150 cm	2	$Pi=((Vi-150)/(Vmax-150))*Pmax$			1,2
SORGENTE RADIOGENA AD ANODO ROTANTE							
1.10	Capacità termica anodica (KHU)	400 KHU	2	$Pi=((Vi-400)/(Vmax-400))*Pmax$			2
1.11	Dissipazione termica anodica (KHU/min)	100 KHU/min	2	$Pi=((Vi-100)/(Vmax-100))*Pmax$			1,71
TAVOLO TELECOMANDATO PORTAPAZIENTE							
1.12	Minima altezza da terra (cm) <i>Vmin altezza minima</i>	70 cm	3	$Pi=((70-Vi)/(70-Vmin))*Pmax$			2,06
1.13	Copertura paziente senza riposizionamento del paziente (cm)		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			1,92
1.14	Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento in qualsiasi movimentazione (kg)	200 Kg	3	$Pi=((Vi-200)/(Vmax-200))*Pmax$			1,98
1.15	Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100 kV) migliorativo. (Se si=Pmax; se no=0)	0,5 mmAl@100 kV \pm 0,05	3				3,00
1.16	Gestione del paziente dalla posizione supina fino alla ortostatica con posizioni intermedie (descrivere)		3	0,80	0,60	0,80	2,20
DETECTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL							
1.17	Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a=2,5 MGy) a 2 Ip/mm (IEC 62220 -1) (%)		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			2
1.18	Sistema di formazione dell'immagine con: griglia di tipo removibile e dotata di sistema di parcheggio quando non in uso. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
SOFTWARE DI POST-ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI							
1.19	Tomosintesi (descrivere)		3	1,00	1,00	1,00	3,00
1.20	Dual energy (descrivere)		2	1,00	1,00	1,00	2,00
1.21	DSA (descrivere)		2	1,00	1,00	1,00	2,00
GENERALI							

OPERATORE ECONOMICO: TRADE ART 2000 S.P.A.

CRITERI QUALITA'		Requisito minimo	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
				Cantisani Vito	Savi Marco	Castrogiovanni Marco	
1	CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE						
GENERATORE AD ALTA FREQUENZA CON ESPOSIZIONE AUTOMATICA							
1.1	Frequenza di erogazione		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			0,28
1.2	Potenza	80 kw	2	$Pi=((Vi-80)/(Vmax-80))*Pmax$			0
1.3	Frequenza acquisizione in radioscopia pulsata, con campo 30x30 cm e matrice 1024x1024. (Se ≥ 15 imm/s P=1; se ≥ 25 imm/s P=2).		2				1,00
STATIVO PORTATUBO							
1.4	Capace di effettuare proiezioni oblique. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
1.5	Velocità di spostamento longitudinale dello stativo (cm/s)		2	$Pi=((Vi-2)/(Vmax-2))*Pmax$			2
1.6	Soluzioni tecnologiche atte ad evitare urti accidentali con il paziente e/o gli operatori durante le operazioni di movimentazione. (descrivere)		3	1,00	0,80	0,80	2,60
1.7	Dotazione di interfaccia touchscreen sul collimatore. (Se si=Pmax; se no=0)		2				2,00
1.8	Possibilità di inclinazione dello stativo portatubo anche alle estremità del tavolo, con centraggio automatico. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
1.9	Distanza fuoco - film	150 cm	2	$Pi=((Vi-150)/(Vmax-150))*Pmax$			1,2
SORGENTE RADIOGENA AD ANODO ROTANTE							
1.10	Capacità termica anodica (KHU)	400 KHU	2	$Pi=((Vi-400)/(Vmax-400))*Pmax$			0,55
1.11	Dissipazione termica anodica (KHU/min)	100 KHU/min	2	$Pi=((Vi-100)/(Vmax-100))*Pmax$			0,71
TAVOLO TELECOMANDATO PORTAPAZIENTE							
1.12	Minima altezza da terra (cm) <i>Vmin altezza minima</i>	70 cm	3	$Pi=((70-Vi)/(70-Vmin))*Pmax$			1,31
1.13	Copertura paziente senza riposizionamento del paziente (cm)		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			1,49
1.14	Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento in qualsiasi movimentazione (kg)	200 Kg	3	$Pi=((Vi-200)/(Vmax-200))*Pmax$			2,52
1.15	Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100 kV) migliorativo. (Se si=Pmax; se no=0)	0,5 mmAl@100 kV \pm 0,05	3				3,00
1.16	Gestione del paziente dalla posizione supina fino alla ortostatica con posizioni intermedie (descrivere)		3	1,00	0,80	0,80	2,60
DETECTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL							
1.17	Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a=2,5 MGy) a 2 Ip/mm (IEC 62220 -1) (%)		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			1,91
1.18	Sistema di formazione dell'immagine con: griglia di tipo removibile e dotata di sistema di parcheggio quando non in uso. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
SOFTWARE DI POST-ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI							
1.19	Tomosintesi (descrivere)		3	1,00	0,80	0,80	2,60
1.20	Dual energy (descrivere)		2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	DSA (descrivere)		2	1,00	0,80	0,80	1,73
GENERALI							

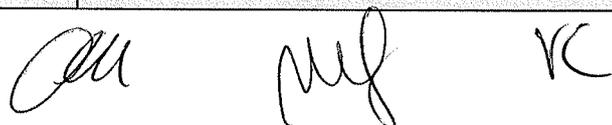

OPERATORE ECONOMICO: TRADE ART 2000 S.P.A.

CRITERI QUALITA'	Requisito minimo	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			Cantisani Vito	Savi Marco	Castrogiovanni Marco	
1.22 Sistemi di contenimento e gestione della dose al paziente e operatore. (descrivere) <i>Il punteggio verrà attribuito in funzione della capacità dei sistemi di contenere e gestire la dose per pazienti e operatori</i>		3	1,00	0,80	0,80	2,60
1.23 Durata della garanzia	24 mesi	1	$P_i = ((V_i - 24) / (V_{max} - 24)) * P_{max}$			0,00
2	VIDEO DEMO					
2.1 Sistemi di miglioramento e ottimizzazione delle immagini In acquisizione e post elaborazione. (Esame CD/DVD)		3	1,00	0,80	0,80	2,60
2.2 Sistemi di contenimento e gestione della dose al paziente e operatore. (Esame CD/DVD)		3	1,00	0,60	0,80	2,40
2.3 Accessibilità per operatori e pazienti in condizioni di uso clinico (anche dai due lati lunghi), sistemi di Sicurezza accessibilità al sottotavolo per sanificazione. (Esame CD/DVD)		3	1,00	0,80	0,80	2,60
2.4 Gestione del workflow degli esami (accettazione paziente, esecuzione esame, archiviazione esame, Interfaccia utente...). (Esame CD/DVD)		3	0,80	0,80	0,80	2,40
2.5 Console di comando per il controllo delle movimentazioni dell'apparecchiatura e delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle immagini ed ergonomia della console. (Esame CD/DVD)		3	1,00	0,80	0,60	2,40
3	QUALITÀ BIOIMMAGINI					
3.1 Paziente adulto: Colonna cervicale, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	1,00	0,80	0,80	2,17
3.2 Paziente adulto: Colonna lombo sacrale, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	1,00	0,80	2,17
3.3 Paziente adulto: Torace, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	1,00	1,00	0,80	2,33
3.4 Paziente adulto: Spalla paziente ortostasi proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	1,00	0,80	1,00	2,33
3.5 Paziente adulto: addome paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	1,00	0,80	0,80	2,17
3.6 Paziente adulto: radioscopia della deglutizione durante ingestione di mezzo di contrasto radiopaco, proiezione laterolaterale. (Esame CD/DVD)		2,5	1,00	0,80	0,80	2,17
3.7 Paziente pediatrico: Colonna in toto, paziente ortostasi proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	1,00	1,00	0,80	2,33
3.8 Paziente pediatrico: Polso. proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	1,00	0,80	1,00	2,33
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		90	TOTALE			69,50

OPERATORE ECONOMICO: METALTRONICA

CRITERI QUALITA'		Requisito minimo	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
				Cantisani Vito	Savi Marco	Castrogiovanni Marco	
1	CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE						
GENERATORE AD ALTA FREQUENZA CON ESPOSIZIONE AUTOMATICA							
1.1	Frequenza di erogazione		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			0,11
1.2	Potenza	80 kw	2	$Pi=((Vi-80)/(Vmax-80))*Pmax$			0
1.3	Frequenza acquisizione in radioscopia pulsata, con campo 30x30 cm e matrice 1024x1024. (Se ≥ 15 imm/s P=1; se ≥ 25 imm/s P=2).		2				1,00
STATIVO PORTATUBO							
1.4	Capace di effettuare proiezioni oblique. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
1.5	Velocità di spostamento longitudinale dello stativo (cm/s)		2	$Pi=((Vi-2)/(Vmax-2))*Pmax$			1,33
1.6	Soluzioni tecnologiche atte ad evitare urti accidentali con il paziente e/o gli operatori durante le operazioni di movimentazione. (descrivere)		3	0,60	0,80	0,60	2,00
1.7	Dotazione di interfaccia touchscreen sul collimatore. (Se si=Pmax; se no=0)		2				0,00
1.8	Possibilità di inclinazione dello stativo portatubo anche alle estremità del tavolo, con centraggio automatico. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
1.9	Distanza fuoco - film	150 cm	2	$Pi=((Vi-150)/(Vmax-150))*Pmax$			1,2
SORGENTE RADIOGENA AD ANODO ROTANTE							
1.10	Capacità termica anodica (KHU)	400 KHU	2	$Pi=((Vi-400)/(Vmax-400))*Pmax$			2
1.11	Dissipazione termica anodica (KHU/min)	100 KHU/min	2	$Pi=((Vi-100)/(Vmax-100))*Pmax$			1,71
TAVOLO TELECOMANDATO PORTAPAZIENTE							
1.12	Minima altezza da terra (cm) <i>Vmin altezza minima</i>	70 cm	3	$Pi=((70-Vi)/(70-Vmin))*Pmax$			3
1.13	Copertura paziente senza riposizionamento del paziente (cm)		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			1,83
1.14	Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento in qualsiasi movimentazione (kg)	200 Kg	3	$Pi=((Vi-200)/(Vmax-200))*Pmax$			0,9
1.15	Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAL@100 kV) migliorativo. (Se si=Pmax; se no=0)	0,5 mmAL@100 kV \pm 0.05	3				3,00
1.16	Gestione del paziente dalla posizione supina fino alla ortostatica con posizioni intermedie (descrivere)		3	0,80	0,80	0,80	2,40
DETECTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL							
1.17	Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a=2,5 MGy) a 2 Ip/mm (IEC 62220 -1) (%)		2	$Pi=(Vi/Vmax)*Pmax$			1,91
1.18	Sistema di formazione dell'immagine con: griglia di tipo removibile e dotata di sistema di parcheggio quando non in uso. (Se si=Pmax; se no=0)		3				3,00
SOFTWARE DI POST-ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI							
1.19	Tomosintesi (descrivere)		3	0,80	0,80	0,80	2,40
1.20	Dual energy (descrivere)		2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	DSA (descrivere)		2	0,80	0,60	0,60	1,33
GENERALI							

Am mef VC

OPERATORE ECONOMICO: METALTRONICA

CRITERI QUALITA'		Requisito minimo	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
				Cantisani Vito	Savi Marco	Castrogiovanni Marco	
1.22	Sistemi di contenimento e gestione della dose al paziente e operatore. (descrivere) <i>Il punteggio verrà attribuito in funzione della capacità dei sistemi di contenere e gestire la dose per pazienti e operatori</i>		3	0,80	0,80	0,60	2,20
1.23	Durata della garanzia	24 mesi	1	$P_i = ((V_i - 24) / (V_{max} - 24)) * P_{max}$			1,00
2	VIDEO DEMO						
2.1	Sistemi di miglioramento e ottimizzazione delle immagini in acquisizione e post elaborazione. (Esame CD/DVD)		3	0,60	0,80	0,60	2,00
2.2	Sistemi di contenimento e gestione della dose al paziente e operatore. (Esame CD/DVD)		3	0,80	0,60	0,60	2,00
2.3	Accessibilità per operatori e pazienti in condizioni di uso clinico (anche dai due lati lunghi), sistemi di Sicurezza accessibilità al sottotavolo per sanificazione. (Esame CD/DVD)		3	0,60	0,80	0,60	2,00
2.4	Gestione del workflow degli esami (accettazione paziente, esecuzione esame, archiviazione esame, Interfaccia utente...). (Esame CD/DVD)		3	0,80	0,80	0,60	2,20
2.5	Console di comando per il controllo delle movimentazioni dell'apparecchiatura e delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle immagini ed ergonomia della console. (Esame CD/DVD)		3	0,60	0,40	0,60	1,60
3	QUALITÀ BIOIMMAGINI						
3.1	Paziente adulto: Colonna cervicale, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,60	0,80	1,83
3.2	Paziente adulto: Colonna lombo sacrale, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,80	0,60	1,83
3.3	Paziente adulto: Torace, paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,80	0,80	1,83
3.4	Paziente adulto: Spalla paziente ortostasi proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,60	0,60	1,50
3.5	Paziente adulto: addome paziente supino proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,80	0,60	1,83
3.6	Paziente adulto: radioscopia della deglutizione durante ingestione di mezzo di contrasto radiopaco, proiezione laterolaterale. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,60	0,80	1,83
3.7	Paziente pediatrico: Colonna in toto, paziente ortostasi proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,60	0,60	0,40	1,33
3.8	Paziente pediatrico: Polso. proiezione antero posteriore. (Esame CD/DVD)		2,5	0,80	0,40	0,80	1,67
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE			90	TOTALE			61,79

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO, DA DESTINARE ALLA U.O.C DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL PO DI RIETI. Numero gara: 9402342. CIG: A0249B8A84

VERBALE COMMISSIONE n. 4
(seduta riservata – seduta pubblica – seduta riservata)

Il giorno **03 giugno 2024**, alle ore 15:00, presso la U.O.C. ALBS della ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori.

Il Presidente partecipa in presenza, mentre, i due Commissari, TSRM Dr. Marco Savi e TSRM Dott. Marco Castrogiovanni, partecipano da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.

Presente la Dott.ssa Elena Cammarata, con i compiti di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Visti e richiamati i verbali del 17 aprile 2024, del 23 e del 27 maggio 2024, il Presidente procede con il caricamento sulla Piattaforma S.TEL.LA. del punteggio tecnico attribuito a ciascun operatore economico.

Conclusa tale operazione, alle ore 15:15 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica e procede con la formalizzazione dei punteggi tecnici ante riparametrazione (conformemente a quanto risultante dalle schede di valutazione agli atti e allegati ai verbali del 23 e del 27 maggio summenzionati) e quelli post riparametrazione (come calcolati dal Sistema su Piattaforma).

Di seguito, quindi, l’elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase della gara, di esame delle offerte economiche, con evidenziazione dei relativi punteggi tecnici post riparametrazione, come da riepilogo esportato dalla Piattaforma.

Fornitore	Punteggio Tecnico post riparametrazione
BIESSE MEDICA	90,00
TRADE ART 2000 S.P.A.	83,67
General Medical Merate S.p.A.	79,83
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	78,14
METALTRONICA	74,39
ASSING S.p.A.	70,22

Al termine della predetta comunicazione, il Presidente, quindi, dichiara procedersi all’apertura telematica massiva delle buste/offerte economiche dandone informazione tramite chat ai concorrenti collegati.



Alle ore 15:27, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica virtuale rinviando a seduta riservata l'esame delle buste economiche, dandone informazione agli utenti collegati tramite chat di sistema. Senza soluzione di continuità, la Commissione procede in seduta riservata con l'esame delle buste economiche.

In ordine all'offerta economica presentata dalla Biesse Medica, risultata I in graduatoria, come da prospetto di seguito riportato, la Commissione rileva che la stessa indica alla voce "costi della manodopera" un importo inferiore rispetto ai costi stimati dalla stazione appaltante negli atti di gara. Con riguardo alle altre offerte economiche, la Commissione non rileva anomalie.

Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Base d'asta	Ribasso %
BIESSE MEDICA	I Classificato	1	93,79	90,00	3,79	239955	12,48
TRADE ART 2000 S.P.A.	II Classificato	2	90,63	83,67	6,96	239955	22,90
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.		3	88,14	78,14	10,00	239955	32,90
General Medical Merate S.p.A.		4	84,39	79,83	4,56	239955	14,99
METALTRONICA		5	78,65	74,39	4,26	239955	14,00
ASSING S.p.A.		6	75,36	70,22	5,14	239955	16,90

Per quanto sopra, il Presidente, rimette gli atti della Commissione di gara al RUP per le determinazioni di competenza.

Alle ore 16:00, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata e conclusi i lavori della Commissione giudicatrice.

L.C.S.

Il Presidente, Prof. Vito Cantisani

Il Componente, TSRM Dr. Marco Savi

Il Componente, TSRM Dott. Marco Castrogiovanni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE,
DOTT.SSA ELENA DAMMARATA



Firmato digitalmente da:
TEODORI ROBERTA
Firmato il 08/07/2024 13:40
Seriale Certificato: 1399814
Valido dal 03/05/2022 al 03/05/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO, DA DESTINARE ALLA U.O.C DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL PO DI RIETI. Numero gara: 9402342. CIG: A0249B8A84

VERBALE RUP
(seduta riservata)

Il giorno **05 giugno 2024**, alle ore **12:00**, presso la U.O.C. ALBS dell’ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, il RUP della procedura di gara in epigrafe, Dott.ssa Roberta Teodori, si riunisce in seduta riservata con il segretario verbalizzante, Dott.ssa Elena Cammarata, la quale consegna al RUP i verbali dei lavori espletati dalla Commissione di Gara.

Il RUP, esaminati i lavori della Commissione giudicatrice, prende atto che nella seduta conclusiva del 03/06/2024 la stessa Commissione tecnica ha rilevato quanto segue:

«In ordine all’offerta economica presentata dalla Biesse Medica, risultata I in graduatoria, come da prospetto di seguito riportato, la Commissione rileva che la stessa indica alla voce “costi della manodopera” un importo inferiore rispetto ai costi stimati dalla stazione appaltante negli atti di gara. Con riguardo alle altre offerte economiche, la Commissione non rileva anomalie», ed ha rimesso gli atti al RUP per le determinazioni di competenza.

Pertanto, il RUP,

VISTI i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici:

- 108, comma 9 ai sensi del quale *“Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”;*
- 41, comma 14, per cui *“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono incorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”;*
- 110, commi 2, 3 e 4, secondo cui *“2. In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. 3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi: a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l’originalità*

dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 4. Non sono ammesse giustificazioni: a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente”;

- art. 11, comma 4, per cui *“Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110”.*

VISTE, altresì, le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e, in particolare:

- art. 3, rubricato “OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, per cui i costi di manodopera per il servizio di cablaggio, installazione, manutenzione ed assistenza dell'apparecchiatura oggetto di appalto e per il servizio di smontaggio dell'apparecchiatura esistente, compresi nella base d'asta e non soggetti a ribasso (salvo quanto previsto dalla normativa vigente), sono stimati dalla stazione appaltante in complessivi € 3.900,40. Tale costo presunto è calcolato tenendo conto dei parametri di riferimento del CCNL – Metalmeccanico Industria, fascia C2 (per il servizio di manutenzione e per il servizio di smontaggio, ritiro e smaltimento dell'apparecchiatura esistente) e fascia C3 (per il servizio di cablaggio ed installazione dell'apparecchiatura);
- art. 16, rubricato “OFFERTA ECONOMICA” secondo il quale *“Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, il concorrente deve quantificare i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro nonché i costi di manodopera per il servizio di cablaggio, installazione, manutenzione ed assistenza dell'apparecchiatura oggetto dell'appalto e per il servizio di smontaggio, ritiro e smaltimento dell'apparecchiatura esistente”;*
- art. 22, rubricato “VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE” per cui *“La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa”.*

TENUTO CONTO che:

- i costi della manodopera indicati dall'operatore economico BIESSE MEDICA nell'offerta economica risultano inferiori rispetto a quelli stimati da questa stazione appaltante negli atti di gara;
- inoltre, la suddetta ditta ha dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, ovvero il CCNL Terziario ConfCommercio.

DISPONE di attivare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023, nei confronti della BIESSE MEDICA, la richiesta delle giustificazioni relative a quanto dalla medesima dichiarato in ordine ai costi della manodopera nonché la richiesta di trasmettere documentazione a comprova dell'equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL che la ditta intende applicare al personale che sarà impegnato nell'appalto, essendo contratto diverso rispetto a quello indicato nel bando di gara.

Il RUP alle ore 13.00 chiude la seduta rinviando a data da destinarsi per la chiusura dei lavori.

L.C.S.

Il RUP, Dott.ssa Roberta Teodori

Il segretario verbalizzante, Dott.ssa Elena Cammarata



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3, DEL CODICE, VOLTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE DESTINATI ALLA U.O.C CHIRURGIA VASCOLARE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI. Numero gara: 9354604

VERBALE RUP
(seduta riservata)

Il giorno **17 giugno 2024 alle ore 10:00**, presso l'U.O.C. ALBS dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, il RUP della procedura di gara in epigrafe, Dott.ssa Roberta Teodori, si riunisce in seduta riservata con il segretario verbalizzante, Dott.ssa Elena Cammarata, per la verifica dell'offerta economica sospetta di anomalia e la chiusura dei lavori.

Visto e richiamato il verbale del RUP del 06 giugno 2024, il RUP, da atto:

- di aver attivato in data 06/06/2024 la procedura di verifica dell'anomalia ex art. 110 del Codice nei confronti della Biesse Medica, procedendo all'invio tramite il Portale S.TEL.LA. (registro di sistema n. PI101589-24), con termine di riscontro fissato in giorni 10 dalla ricezione.
- che l'operatore economico interpellato, in data 14/06/2024, ha dato riscontro alla richiesta di spiegazioni (registro di sistema n. PI107308-24).

Il RUP procede quindi ad esaminare la documentazione pervenuta. All'esito, ritiene le giustificazioni fornite esaustive. L'operatore economico ha dato evidenza che per un mero refuso in sede di compilazione del *form* dedicato all'offerta economica, il costo della manodopera ed il costo della sicurezza aziendale sono stati invertiti. Pertanto, il costo della manodopera indicato dall'operatore economico deve essere inteso pari ad € 3.800,00 (in luogo di € 45,00), mentre il costo della sicurezza pari ad € 45,00 (in luogo di € 3.800,00).

Il RUP da atto, anzitutto, che la questione non è risolvibile nei termini di un mero errore materiale, riconoscibile *ictu oculi* e quindi emendabile direttamente dalla stazione appaltante, anche se, nel caso di specie, dall'esame del documento contenente l'offerta economica emergono elementi che facciano dubitare della corrispondenza di quanto indicato all'effettiva volontà del dichiarante. Quanto sopra si evince dal fatto che questa stazione appaltante ha stimato negli atti di gara i costi della manodopera in € 3.900,40 mentre gli oneri per la sicurezza da interferenze in € 45,00, ossia in misura sostanzialmente corrispondente agli importi dichiarati dall'operatore economico nel *form* dell'offerta, pur se a campi invertiti.

Come affermato da uniforme giurisprudenza in materia, "Tuttavia, sebbene non si tratti di errore materiale riconoscibile ed emendabile (...), la attendibilità del costo della manodopera previsto nell'offerta deve essere, in ogni caso, accertata nella sede propria del procedimento di verifica della congruità dell'offerta". L'art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici non prevede, infatti, per l'ipotesi di errata o incongrua indicazione del costo della manodopera, l'immediata esclusione dell'offerta (prevedendo tale grave conseguenza unicamente per il caso della omessa indicazione: in

termini Cons. Stato, V, 30 giugno 2020, n. 4140), ma impone la verifica della congruità ai sensi dell'art. 110 e solo se la verifica risultasse negativa l'offerta potrebbe essere esclusa (cfr Consiglio di Stato, sez. V, 16.08.2022 n. 7141).

Invero, il principio generale del contraddittorio consente al concorrente di *"...modificare le giustificazioni, sempre che resti ferma l'entità dell'offerta economica, in ossequio alla regola di immutabilità dell'offerta..."* (Cons. Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 171).

Sul punto anche Tar Campania Napoli, Sez. V, sentenza n. 6475 del 23/11/2023: *"l'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50 del 2016 impone l'esclusione dalla procedura di gara soltanto in caso di mancata indicazione nell'offerta economica di qualsivoglia costo di mano d'opera (omettendo il relativo adempimento posto a carico del concorrente), ma non anche allorquando si contesti la sottostima o inadeguatezza o anche l'omessa indicazione delle peculiari voci che compongono il costo della manodopera, necessarie per rendere, secondo una ragionevole previsione, l'offerta sostenibile. Se così non fosse, errori irrilevanti ed inesattezze che non incidono sulla complessiva credibilità finirebbero per comportare egualmente l'esclusione dell'impresa dalla gara, in tal modo vanificando il principio generale in forza del quale l'eventuale e successivo giudizio sull'anomalia dell'offerta presuppone una valutazione globale e sintetica sulla complessiva affidabilità della stessa (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 4047 del 2020; TAR Emilia - Romagna, Bologna, sez. II, n. 624 del 2020; Cons. St., sez. V, n. 6334 del 2020)"*.

Per consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, il giudizio sull'anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso anche alla stregua di compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica, con il limite della radicale modificazione della composizione dell'offerta, che ne alteri l'equilibrio economico.

"Nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è consentito pervenire ad un giudizio di congruità senza modificare l'offerta, tuttavia modificando le giustificazioni (fornendo giustificazioni basate su dati, di fatto o normativi, sopravvenuti; correggendo precedenti errori di calcolo; attuando compensazioni tra sottostime e sovrastime), purché l'offerta risulti complessivamente affidabile nel suo complesso al momento dell'aggiudicazione" (Cons. Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 171).

Non risulta, dunque, ravvisabile nel caso di specie una modifica dell'offerta economica, atteso che i chiarimenti e la documentazione forniti dalla Biesse Medica non integrano alcuna variazione dell'offerta economica complessiva, limitandosi a correggere l'errore di inversione commesso nella predisposizione della stessa.

Ciò posto, tenuto conto che in ogni caso i costi della manodopera dichiarati dall'operatore economico, per come meglio precisati, sono lievemente inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara, il RUP verifica la congruità degli stessi tenuto conto che, ai sensi dell'art. 41, comma 14, secondo periodo del Codice *"Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*.

Esaminate le giustificazioni rese al riguardo dalla Biesse Medica, il RUP rileva la congruità dei prezzi della manodopera tenuto conto della complessiva organizzazione di cui dispone l'Impresa nel rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Infine, il RUP rileva che l'operatore economico ha fornito sufficiente prova dell'equivalenza delle tutele giuridiche ed economiche del CCNL indicato ("Terziario Confcommercio") differente a quello individuato da questa stazione appaltante.

Alla luce di quanto sopra rilevato, il RUP ritiene quindi che l'offerta della concorrente Biesse Medica ha superato positivamente le operazioni di verifica di congruità di cui all'art. 110 del codice.


Pertanto, il RUP recepisce la graduatoria esitata dai lavori della Commissione nella seduta del 03.06.2024, come da prospetto che segue (graduatoria finale):

Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Base d'asta	Ribasso %
BIESSE MEDICA	I Classificato	1	93,79	90,00	3,79	239955	12,48
TRADE ART 2000 S.P.A.	II Classificato	2	90,63	83,67	6,96	239955	22,90
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.		3	88,14	78,14	10,00	239955	32,90
General Medical Merate S.p.A.		4	84,39	79,83	4,56	239955	14,99
METALTRONICA		5	78,65	74,39	4,26	239955	14,00
ASSING S.p.A.		6	75,36	70,22	5,14	239955	16,90

Alle ore 11:15, il RUP dichiara chiusi i lavori.

L.C.S.

Il RUP, Dott.ssa Roberta Teodori



Il segretario verbalizzante, Dott.ssa Elena Cammarata



Firmato digitalmente da:

TEODORI ROBERTA

Firmato il 08/07/2024 13:41

Seriale Certificato: 1399814

Valido dal 03/05/2022 al 03/05/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari
(Decreto Presidente Regione Lazio n.T00043 del 24/05/2023)
Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 26/05/2023

n. 691/C.S./2024 del 12/07/2024

ALLEGATO DELLA DELIBERAZIONE AGLI ATTI

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO, DA DESTINARE ALLA U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL P.O. DI RIETI, PER UN IMPORTO A BASE DI GARA PARI AD € 239.955,00 AL NETTO DELL'IVA, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 495/C.S./2023 DEL 07.11.2023, PARZIALMENTE MODIFICATA CON DELIBERAZIONE N. 700/CS/2023 DEL 28/12/2023. NUMERO GARA 9402342 - CIG: A0249B8A84. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE DI GARA. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO BIESSE MEDICA S.R.L. IMPORTO COMPLESSIVO DI AFFIDAMENTO PARI AD € 210.008,62 (IVA ESCLUSA).

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge dal 12/07/2024

La presente Deliberazione viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi (ai sensi dell'art. 31 L.R. 31/10/1996 n. 45) nel sito web ASL RIETI – sezione Albo Pretorio (ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33)

in oggetto per esteso

dal 12/07/2024 e fino al 27/07/2024

e contestualmente resa disponibile al Collegio Sindacale.

Rieti lì 12/07/2024

Il Responsabile
U.O.S.D. Affari Generali e Legali

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui agli artt. 3 bis

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

e 71 del D.Lgs 82/2005 e si compone del numero di pagine indicato nel piè di pagina più il presente allegato.